

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR - GO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2026

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

A empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61**, com sede na AV HENRIQUE MANSANO, 1581 JD ALPES, CEP 86.079-450 LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. CESAR RAFAEL CARREGA, RG n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF n.º 055.015.959-23.

Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações estabelecidas no edital e que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.



Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) dias.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Garantia: Conforme o edital.

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1582-2 - C/C: 42.441-2

Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos:

CESAR RAFAEL CARREGA

CPF: 055.015.959-23, RG: 9177472-0 SESP-PR

Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350

E-MAIL: starmedical.licita@gmail.com

57.498.660/0001-61
91099706-86
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1581
B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450
LONDRINA - PR

CESAR
RAFAEL
CARREGA: 05
501595923

Assinado de
forma digital por
CESAR RAFAEL
CARREGA: 05501
595923

LONDRINA, 15 DE JULHO DE 2026

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR
ESTADO DE GOIAS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2026

PROPOSTA REAJUSTADA					
LOTE	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
06	05	MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS (BRANCO/AZUL CLARO): ALTURA DO ASSENTO 360°: 53CM/63CM (COM PROLONGADOR); DIMENSÕES DO ENCOSTO: 390MMX226MM; DIMENSÕES DO ASSENTO: 342 MM (DIÂMETRO); DISTÂNCIA MÁXIMA DOS RODÍZIOS: 590 MM; TAMANHO DO ARCO DE SUSTENTAÇÃO: 420 MM.	RENAFLEX / MOCHO	320,08	1.600,40
10	10	BOMBA DE INFUSÃO COM BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS: TELA TOUCH DE 3,5" DE ALTA RESOLUÇÃO: VISUALIZAÇÃO CLARA DE TODOS OS PARÂMETROS, REDUZINDO A FADIGA OCULAR E ERROS DE LEITURA; BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS INTEGRADA: ORGANIZA A ROTINA ASSISTENCIAL E GARANTE QUE OS LIMITES DE DOSAGEM SEJAM RESPEITADOS CONFORME OS PROTOCOLOS DA UNIDADE; 7 MODOS DE INFUSÃO PROFISSIONAIS: VERSATILIDADE TOTAL PARA PROTOCOLOS DE TAXA, TEMPO, PESO CORPORAL, SEQUENCIAL, GRADIENTE E MICROINFUSÃO; COMPATIBILIDADE COM EQUIPO UNIVERSAL: REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS E FACILIDADE NA GESTÃO DE INSUMOS; SEGURANÇA NA TRANSFUSÃO: EQUIPAMENTO ROBUSTO E VALIDADO PARA HEMODERIVADOS, ESSENCIAL PARA SETORES DE ALTA COMPLEXIDADE; INTERFACE: TELA TOUCH TFT LCD 3,5 POLEGADAS; RECURSOS ESPECIAIS: MODO NOTURNO, ILUMINAÇÃO INTERNA E BOLUS AUTOMÁTICO/MANUAL; BATERIA DE ALTA PERFORMANCE: ATÉ 5 HORAS DE AUTONOMIA (COM OPCIONAL DE ATÉ 10 HORAS PARA TRANSPORTES LONGOS); SENSOR DE GOTEJAMENTO: PRECISÃO EXTRA NO MONITORAMENTO DE FLUXO; APLICAÇÕES: MEDICAÇÃO, NUTRIÇÃO PARENTERAL E TRANSFUSÃO DE SANGUE.	CONTEC / SP 750	1980,00	19.800,00
12	150	MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO	G TECH / PORTATIL	107,71	16.156,50
23	10	INALADOR/NEBULIZADOR HOSPITALAR: INALADOR HOSPITALAR COM 4 SAÍDAS COM SUPORTE/PEDESTAL E 5 RODÍZIOS COM TRAVAS. FREQUÊNCIA: 60 HZ; FUSÍVEL: 3 A - AÇÃO RÁPIDA - 2CM; PROTEÇÃO TÉRMICA; COMPRESSOR: PISTÃO OSCILANTE (ISENTO DE ÓLEO); POTÊNCIA NOMINAL TOTAL: 150W OU 1/5CV; PRESSÃO MÁXIMA: ≥ 30 PSI; ESTABILIDADE MECÂNICA: FIXO COM PÉS DE BORRACHA OU ATRAVÉS DA BASE COM 5 RODÍZIOS; ACESSÓRIO OPCIONAL: PEDESTAL PARA TRANSPORTE; MOTOR: COMPACTO MONOFÁSICO; TEMPO DE NEBULIZAÇÃO: EM TORNO DE 15 MIN. (*PARA 5 ML); TIPO DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I; GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: PARTE APLICADA DE TIPO B; GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: IPXO; TENSÃO: 110/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO (PLUGUE 3 PINOS). SUPORTE PARA 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO.	MRM / INALOVIDA	1286,99	12.869,90
28	01	LARINGOSCÓPIO: ESPECIFICAÇÕES: CANAL-GUIA PARA NAVEGAÇÃO PRECISA DO TUBO ATÉ O CENTRO DAS CORDAS VOCAIS; INDICADO PARA TOT (TAMANHO DO TUBO) DE 7,0 A 8,5 MM; SISTEMA ANTIEMBAÇAMENTO PARA VISUALIZAÇÃO CLARA; CONEXÃO COM ENDOSCÁMERAS PARA REGISTRO E MONITORAMENTO PRECISOS; OCULAR PARA ALINHAMENTO PERFEITO DURANTE O PROCEDIMENTO; INCLUSÃO DE PILHA ALCALINA PADRÃO PARA ENERGIA CONFIÁVEL; EMBALAGEM TIPO BLISTER SELADA, CONTENDO 01 UNIDADE.	MD / LARINGOSCOPIO	1584,00	1.584,00
31	05	ESFIGMOMANOMETRO - ADULTO: CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO MANUAL DO TIPO ANERÓIDE; MANÔMETRO ANALÓGICO; BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO; CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO INDICADA PARA A BRAÇADEIRA: 18 A 35 CM; DIMENSÃO FÍSICA DA BRAÇADEIRA: 14,5 CM X 52 CM; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; DIVISÃO DE ESCALA DE 2 MMHG; ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL DE ±3 MMHG; INDICADO PARA USO PROFISSIONAL	PREMIUM / ADULTO	64,35	321,75
33	03	ESFIGMOMANÔMETRO - PEDIÁTRICO: PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: ESTAMPA EXCLUSIVA: DESIGN LÚDICO PARA UM AMBIENTE MAIS ACOLHEDOR; NYLON ANTIALÉRGICO: MATERIAL SEGURO E CONFORTÁVEL PARA A PELE SENSÍVEL DAS CRIANÇAS; ALTA PRECISÃO: MANÔMETRO CONFIÁVEL PARA MEDIÇÕES EXATAS; DURABILIDADE: EQUIPAMENTO RESISTENTE, PROJETADO PARA USO CONTÍNUO; ACOMPANHA BOLSA EXCLUSIVA: FACILITA O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; COR: ESTAMPA LÚDICA; MATERIAL: NYLON 300; TAMANHO: INFANTIL; MEDIDA DA BRAÇADEIRA: 28 CM X 9,5 CM; TAMANHO DO MANGUITO: 8,0 CM X 15,0 CM; ABRANGÊNCIA DA CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 CM A 23 CM.	PREMIUM / INFANTIL	64,35	193,05
VALOR DA PROPOSTA: cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos			VLR TOTAL PROPOSTA		52.525,60

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme

estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de, o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

Validade da Proposta: Conforme edital.
Prazo de Entrega: Conforme edital.
Prazo de Pagamento: Conforme edital.
Prazo de Garantia: Conforme o edital

ASSINATURA:	CARIMBO:	ASSINATURA DIGITAL:
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS H:57498660000161 Assinado de forma digital por STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS H:57498660000161	57.498.660/0001-61 91099706-86 STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. AV. HENRIQUE MANSANO, 1581 B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450 LONDRINA - PR	CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923 Assinado de forma digital por CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923

Dados da Empresa Nacional	
Razão Social MEDMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES LTDA- ME	CNPJ 07.760.277/0001-61
Nome Fantasia medmax	
Endereço na Internet WWW.MEDMAXNET.COM.BR	SAC 41910170
Endereço Completo Avenida CAUAXI Nº 293 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAVIL CEP: 06.454-020	Cidade/UF BARUERI/SP
Responsável Técnico SAVIO MARTINS COELHO	Responsável Legal IVONE ESTEVES

Dados do Cadastro		
Cadastro Nº 8.02989-7 (KH07Y84Y1HML)	Data do Cadastro 17/04/2006	Situação Ativa
Nº do Processo <u>25351.080918/2006-79</u>	Cadastro 8 - Produtos para Saúde (Correlatos)	
Atividades / Classes		
Armazenar		
• Correlatos		
Distribuir		
• Correlatos		
Expedir		
• Correlatos		
Importar		
• Correlatos		
		Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	06.105.362/0001-23	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.02.753-1
Nome do Dispositivo Médico	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Esfigmomanometro		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80275310022		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.316086/2009-75</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C009899 - Endereço: 81 LIUZHAI LUODONG SOUTH STREET YONGZHONG 325000 WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	30/11/2009		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Esfigmo BR-20D _Rev14_240622.pdf	0394797/23-0 - 19/04/2023 - 02:44
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Esfigmo H200_rev09_050922.pdf	0394797/23-0 - 19/04/2023 - 02:44

Modelo Produto Médico
BR-20D
H200 MESA/PAREDE
H200 RODIZIO

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MEDMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES LTDA- ME		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07.760.277/0001-61	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.02.989-7
Nome do Dispositivo Médico	BOMBA DE INFUSÃO		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Bomba de Infusao		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80298970203		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.347104/2022-40</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C004418 - Endereço: #112 QINHUANG WEST STR., E&T DEVELOPMENT ZONE, QINHUANGDAO, HEBEI PROVINCE, CHINA - 066004		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	III - ALTO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	31/10/2022		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	31/10/2032		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	SP750 MANUAL BOMBA DE INFUSÃO.pdf	0993495/23-1 - 19/09/2023 - 10:17

Modelo Produto Médico

BOMBA DE INFUSÃO SP750

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	06.105.362/0001-23	Autorização	8.02.753-1
Produto	Aparelho de Pressão Digital G-Tech Modelo BSP11		

Modelo Produto Médico
BSP11

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IM_BPSP11_REV07_060820.pdf	0532502/21-3 - 09/02/2021 - 03:08

Nome Técnico	Monitor de Pressao Arterial Nao Invasivo
Registro	80275310064
Processo	25351.073865/2017-03
Fabricante Legal	FABRICANTE: JOYTECH HEALTHCARE CO.,LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar	

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	95.433.397/0001-11	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.00.702-1
Nome do Dispositivo Médico	LARINGOSCÓPIOS MD		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Laringoscópio		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80070210014		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.742491/2009-91</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: MEDICAL DEVICES PVT LTD. - PAQUISTÃO - CNPJ / Código Único: C011491 - Endereço: WAZIRABAD ROAD, UGOKI, SIALKOT, 51310		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	30/11/2010		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Laringoscópio Fibra Óptica MD.pdf	0329666/25-8 - 11/03/2025 - 03:25
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Laringoscópio Convencional MD.pdf	0329666/25-8 - 11/03/2025 - 03:25

Modelo Produto Médico

Laringoscópio Macintosh Polio Convencional MD
Laringoscópio Macintosh RAV/RFIV Convencional MD
Laringoscópio Miller Convencional MD
Laringoscópio Miller Maxlite Fibra Óptica MD
Laringoscópio Oxford Convencional MD
Laringoscópio Robertshaw Convencional MD
Laringoscópio Seward Fibra Óptica MD
Laringoscópio Wisconsin Fibra Óptica MD
Laringoscópio Flexi-Tip (McCoy) Convencional MD
Laringoscópio Flexi-Tip Fibra Óptica MD
« 1 2 3 »
10 25 50

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MRM HOSPITALAR LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	20.920.517/0001-06	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.12.935-7
Nome do Dispositivo Médico	NEBULIZADOR		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Nebulizador		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	81293579002		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.846277/2023-27</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: MRM HOSPITALAR LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 20.920.517/0001-06 - Endereço: R ARARUAMA SN QUADRA 56 LOTE 26 SALA 01 VILA ALZIRA 74913190		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	14/02/2024		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MRM_Manual Nebulizador_INALOVIDA_Rev.01 15.05.2023.pdf	0667974/24-5 - 20/05/2024 - 11:35

Modelo Produto Médico
MRM 200C

MRM-200

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 19/08/2024 | Edição: 159 | Seção: 1 | Página: 196

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.946, DE 14 DE AGOSTO DE 2024

O GERENTE-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder às empresas constantes no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 4 (quatro) anos a partir de sua publicação, conforme art. 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 850, de 20 de março de 2024.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

Fabricante: Abbott Diabetes Care Inc.

Endereço: 1360 South Loop Road, Alameda, California, 94502, Estados Unidos da América

Solicitante: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. CNPJ: 56.998.701/0001-16

Autorização de Funcionamento: 8.01.465-O Expediente: 1368900/23-2

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Abbott Medical

Endereço: 5050 Nathan Lane North, Plymouth, Minnesota, 55442, Estados Unidos da América

Solicitante: St. Jude Medical Brasil Ltda CNPJ: 00.986.846/0001-42

Autorização de Funcionamento: 1.03.323-4 Expediente: 0004363/24-8

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico da classe III e IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Abigo Medical AB

Endereço: Vapenvägen 1, 69633, Askersund, Orebro, Suécia

Solicitante: Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda CNPJ: 54.858.014/0001-70

Autorização de Funcionamento: 1.02.240-O Expediente: 0155012/24-0

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico da classe III.



Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

Endereço: Nº. 210 Zhenzhong Road, West Lake District, Hangzhou, 310030, China

Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda CNPJ: 04.718.143/0001-94

Autorização de Funcionamento: 8.01.025-1 Expediente: 0155031/24-4

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Aomori Olympus Co., Ltd.

Endereço: 2-248-1 Okkonoki, Kuroishi-Shi, Aomori, 036-0357, Japão

Solicitante: Olympus Optical do Brasil Ltda CNPJ: 04.937.243/0001-01

Autorização de Funcionamento: 8.01.246-3 Expediente: 0149370/24-5

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico das classes III e IV e Equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Aroa Biosurgery Ltd.

Endereço: 2 Kingsford Smith Place - Airport Oaks - 2022 - Auckland, Nova Zelândia

Solicitante: Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares LTDA CNPJ: 04.967.408/0001-98

Autorização de Funcionamento: 8.01.175-8 Expediente: 0195232/24-1

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico da classe IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Arthrex Inc.

Endereço: 1370 Creekside Boulevard, Naples, FL, 34108-1945, Estados Unidos da América

Solicitante: Arthrex do Brasil Importação e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda CNPJ: 18.272.616/0001-87

Autorização de Funcionamento: 8.09.785-6 Expediente: 1480693/23-5

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico das classes III e IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Avent, Inc.



Endereço: 6620 S. Memorial Place, Suite 100, Tucson, Arizona, 85756, Estados Unidos da América

Solicitante: CEI Comércio Exportação Importação de Material Médico Ltda CNPJ: 40.175.705/0001-64

Autorização de Funcionamento: 1.02.344-0 Expediente: 0213642/24-7

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Balt USA, LLC.

Endereço: 29 Parker, Irvine - California, 92618, Estados Unidos da América

Solicitante: Balt Brasil Produtos Médicos Ltda. CNPJ: 12.236.355/0002-44

Autorização de Funcionamento: 8.19.362-1 Expediente: 1466795/23-9

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico das classes III e IV e equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Cam Bioceramics B.V.

Endereço: Zernikedreef 6, 2333 CL. Leiden - Holanda

Solicitante: JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. CNPJ: 00.489.050/0001-84

Autorização de Funcionamento: 1.03.444-2 Expediente: 0259959/24-3

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico da classe IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Carl Zeiss Meditec AG

Endereço: Max-Dohrn-Strasse 8-10, 10589, Berlim, Alemanha

Solicitante: Carl Zeiss do Brasil Ltda. CNPJ: 33.131.079/0001-49

Autorização de Funcionamento: 1.03.320-3 Expediente: 0168496/24-1

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico das classes III e IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Cell Marque Corporation

Endereço: 6600 Sierra College Boulevard, Rocklin, California, 95677, Estados Unidos da América

Solicitante: Inopat Importação e Exportação Ltda CNPJ: 07.440.995/0001-50

Autorização de Funcionamento: 8.03.584-3 Expediente: 1455659/23-1

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:



Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Cell Marque Corporation

Endereço: 6600 Sierra College Blvd, Rocklin, Califórnia, 95677, Estados Unidos da América

Solicitante: Roche Diagnóstica Brasil Ltda CNPJ: 30.280.358/0001-86

Autorização de Funcionamento: 1.02.874-1 Expediente: 1405297/23-9

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Coloplast Manufacturing France S.A.S

Endereço: 9, Avenue Edmond Rostand, CS 70218, 24206 - Sarlat La Canéda Cedex, França

Solicitante: Coloplast do Brasil Ltda CNPJ: 02.794.555/0003-40

Autorização de Funcionamento: 1.04.303-1 Expediente: 0202379/24-8

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Contec Medical Systems Co., Ltd.

Endereço: 112 Qinhuang West Str., E&T Development Zone, Qinhuangdao, 066004 Hebei Province, China

Solicitante: Medmax Comércio de Equipamentos Médicos e Similares Ltda CNPJ: 07.760.277/0001-61

Autorização de Funcionamento: 8.02.989-7 Expediente: 0035047/24-1

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: E.M.S Electro Medical Systems S.A.

Endereço: Route de Champ-Colin 2, Nyon, 1260, Suíça

Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda CNPJ: 04.718.143/0001-94

Autorização de Funcionamento: 8.01.025-1 Expediente: 0130979/24-4

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.



Fabricante: Elekta Limited

Endereço: Linac House, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9RR, Reino Unido

Solicitante: Elekta Medical Systems Comércio e Serviços para Radioterapia Ltda CNPJ: 09.528.196/0001-66

Autorização de Funcionamento: 8.05.693-2 Expediente: 0373736/24-0

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Erbe Elektromedizin GmbH

Endereço: Waldhornlestrasse 17, 72072 Tubingen, Alemanha

Solicitante: Erbe do Brasil Equipamentos Cirúrgicos e Endoscópicos Ltda. CNPJ: 27.709.659/0001-78

Autorização de Funcionamento: 8.16.124-1 Expediente: 0149190/24-7

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Establishment Labs S.A.

Endereço: Coyol Free Zone & Busines Park Buiding, O Street, Buiding B-25, Alajuela, 20113, Costa Rica



Solicitante: Establishment Labs Brasil Produtos para Saúde Ltda CNPJ: 08.290.164/0001-02

Autorização de Funcionamento: 8.05.883-9 Expediente: 0413116/24-7

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico das classes III e IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Ethicon Endo-Surgery, S.A. de C.V., Planta II

Endereço: Calle Durango, n. 2751, Colonia Lote Bravo, Ciudad Juarez, 32575, Chihuahua, México

Solicitante: Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. CNPJ: 54.516.661/0001-01

Autorização de Funcionamento: 8.01.459-0 Expediente: 0119369/24-9

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico da classe III e equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Empresa: Euro Parts Brasil Indústria e Comércio Instrumental Cirúrgico Ltda. CNPJ: 13.440.884/0001-47

Endereço: Rua Aratibá (Cond. C. Ind. Limeira), 212, Centro Industrial de Limeira - CIL, Limeira, São Paulo, Brasil CEP: 13481-208

Autorização de Funcionamento: 8.18.242-1 Expediente: 1474141/23-4

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Gambro Industries SAS

Endereço: 7 Avenue Lionel Terray, BP 126, Meyzieu, 69883, França

Solicitante: Baxter Hospitalar Ltda CNPJ: 49.351.786/0001-80

Autorização de Funcionamento: 8.01.452-4 Expediente: 0141269/24-3

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico das classes III e IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Getein Biotech, Inc.

Endereço: No.9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, Jiangsu, 211505, China

Solicitante: Wama Produtos para Laboratórios Ltda. CNPJ: 66.000.787/0001-08

Autorização de Funcionamento: 1.03.100-3 Expediente: 0208747/24-9

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Produtos para diagnóstico de uso in vitro das classes III e IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Greatbatch Medical

Endereço: 2300 Berkshire Lane North, Minneapolis, MN, 55441, Estados Unidos da América

Solicitante: St. Jude Medical Brasil Ltda CNPJ: 00.986.846/0001-42

Autorização de Funcionamento: 1.03.323-4 Expediente: 0131384/24-4

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico da classe IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: HansBiomed Corp.

Endereço: 64, Yuseong-Daero 1628 Beon-Gil, Yuseong-Gu, Daejeon 34054, Coréia do Sul

Solicitante: Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME CNPJ: 04.967.408/0001-98

Autorização de Funcionamento: 8.01.175-8 Expediente: 1368890/23-7

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico das classes III e IV.



Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: HMD Biomedical Inc.

Endereço: Nº. 181, Minsheng St., Xinpu Township, Hsinchu County, 30548, Taiwan

Solicitante: Industria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO CNPJ: 01.541.283/0003-03

Autorização de Funcionamento: 8.12.188-7 Expediente: 0089079/24-8

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Produtos para Diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Empresa: Joline GmbH. & Co. Kg

Endereço: Neue Rottenburger Strasse 50 - Hechingen, 72379, Alemanha

Solicitante: HTS - Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda. CNPJ: 66.437.831/0001-33

Autorização de Funcionamento: 1.02.896-8 Expediente: 0106798/24-3

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico das classes III e IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Karex Industries Sdn, Bhd

Endereço: Ptd 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, 82000, Malásia

Solicitante: Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda. CNPJ: 59.557.124/0001-15

Autorização de Funcionamento: 8.07.749-O Expediente: 0208510/24-9

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde

Materiais de uso médico das classes III

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Laboratoires Urgo

Endereço: 2 Avenue de Strasbourg, Parc Excellence 2000, Chevigny Saint Sauveur, 21800, França

Solicitante: LM Farma Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 57.532.343/0001-14

Autorização de Funcionamento: 8.02.469-1 Expediente: 0168659/24-7

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Mallinckrodt Medical

Endereço: Cornamaddy, Athlone, Co. Westmeath, N37 E656, Irlanda



Solicitante: Auto Suture do Brasil Ltda CNPJ: 01.645.409/0001-28

Autorização de Funcionamento: 1.03.490-0 Expediente: 1323067/23-0

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico da classe IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Medtronic Minimed

Endereço: 18000 Devonshire Street, Northridge, California, 91325, Estados Unidos da América

Solicitante: Auto Suture do Brasil Ltda. CNPJ: 01.645.409/0001-28

Autorização de Funcionamento: 1.03.391-9 Expediente: 008911324-1

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Medtronic Sofamor Danek Deggendorf GmbH

Endereço: Ulrichsbergerstrasse 17, Deggendorf, Bavaria, 94469, Alemanha

Solicitante: Auto Suture do Brasil Ltda. CNPJ: 01.645.409/0001-28

Autorização de Funcionamento: 1.03.490-0 Expediente: 1323465/23-5

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico das classes III e IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Mesoestetic Pharma Group S.L.

Endereço: Carrer de la Tecnologia, 25, Viladecans, Barcelona, 08840, Espanha

Solicitante: JPG - Produtos Funcionais e Nutricionais Ltda. CNPJ: 21.051.983/0001-65

Autorização de Funcionamento: 8.13.978-2 Expediente: 0095610/24-3

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Materiais de uso médico das classes III e IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: MetaSystems Probes GmbH

Endereço: 1. Industriestrasse 7, Altlussheim, Baden-Württemberg, 68804, Alemanha

Solicitante: MIP Sondas Brasil Eireli CNPJ: 34.637.458/0001-78

Autorização de Funcionamento: 8.21.420-8 Expediente: 0130732/24-9

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.



Fabricante: MIS Implants Technologies Ltd.
Endereço: P.O. box 7, Bar Lev Industrial Park, 2015600, Israel
Solicitante: Dentsply Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 31.116.239/0001-55
Autorização de Funcionamento: 8.01.968-8 Expediente: 1474257/23-2
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: NovaBone Products, LLC.
Endereço: 13510 NW US Highway 441, Alachua, Flórida, 32615, Estados Unidos da América
Solicitante: Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. CNPJ: 04.967.408/0001-98
Autorização de Funcionamento: 8.01.175-8 Expediente: 0223169/24-2
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe IV.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: NovaBone Products LLC
Endereço: 13510 NW US Highway 441, Alachua, Flórida - 32615, Estados Unidos da América
Solicitante: Medartis Importação e Exportação Ltda. CNPJ: 07.021.336/0001-80
Autorização de Funcionamento: 8.02.718-1 Expediente: 0051584/24-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe IV.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.



Fabricante: Resorba Medical GmbH
Endereço: Am Flachmoor 16, 90475 Nuremberg, Alemanha
Solicitante: Osis Medical Comércio Importação e Exportação S.A. CNPJ: 10.910.549/0001-77
Autorização de Funcionamento: 8.06.253-9 Expediente: 0045291/24-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de Uso Médico das Classes III e IV.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Schölly Fiberoptic GmbH
Endereço: Robert-Bosch-Str. 1-3, Denzlingen, Baden-Württemnberg, 79211, Alemanha
Solicitante: Carl Zeiss do Brasil Ltda. CNPJ: 33.131.079/0001-49
Autorização de Funcionamento: 1.03.320-3 Expediente: 0039286/24-0

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: SD Biosensor, Inc.

Endereço: 74, Osongsaengmyeong 4-Ro, Osong-Eup. Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, Coréia do Sul

Solicitante: Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda. CNPJ: 06.105.362/0001-23

Autorização de Funcinamento: 8.02.753-1 Expediente: 0125103/24-7

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Produtos para diagnóstico de uso in vitro das classes III e IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Sejoy Biomedical Co., Ltd.

Endereço: Area C, Building 2, No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, Zhejiang, 311100, China

Solicitante: Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. CNPJ: 04.967.408/0001-98

Autorização de Funcionamento: 8.01.175-8 Expediente: 1467623/23-7

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Smith & Nephew, Inc - Orthopaedic Division

Endereço: 1450 Brooks Road, Memphis, Tennessee, 38116, Estados Unidos da América

Solicitante: Smith & Nephew Comércio de Produtos Médicos Ltda. CNPJ: 13.656.820/0001-88

Autorização de Funcionamento: 8.08.040-5 Expediente: 0039366/24-3

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico das classes III e IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Smith & Nephew Orthopedics (Beijing) Co., Ltd.

Endereço: No. 98 Kechuang Dong Liu Street, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing, 101111, China

Solicitante: Smith & Nephew Comércio de Produtos Médicos Ltda CNPJ: 13.656.820/0001-88

Autorização de Funcionamento: 8.08.040-5 Expediente: 0095351/24-8

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico das classes III e IV.



Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: St. Jude Medical
Endereço: One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN - 55117, Estados Unidos da América
Solicitante: St. Jude Medical Brasil Ltda CNPJ: 00.986.846/0001-42
Autorização de Funcionamento: 1.03.323-4 Expediente: 0142197/24-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: STAT Dx Life S.L.
Endereço: Baldiri Reixac 4, Barcelona, 08028, Espanha
Solicitante: QIAGEN Biotecnologia Brasil Ltda CNPJ: 01.334.250/0001-20
Autorização de Funcionamento: 1.03.222-5 Expediente: 1421844/23-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Produtos para Diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Surgical Specialties Corporation Mexico, S. de R.L. de C.V.
Endereço: Corredor Tijuana - Rosarito 2000, nº 24702-B Ejido Francisco Villa, Tijuana, Baja California, 22235, México
Solicitante: CML- Centro Médico Logístico Ltda. CNPJ: 23.378.089/0001-20
Autorização de Funcionamento: 8.13.465-O Expediente: 0155107/24-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV.



Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited
Endereço: 789/139 Moo1, Pinthong Industrial Estate, Nongkham, Sriracha, Chonburi, 20110, Tailândia
Solicitante: Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda CNPJ: 04.967.408/0001-98
Autorização de Funcionamento: 8.01.175-8 Expediente: 1455683/23-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Unimed Medical Supplies, Inc.

Endereço: No.8 Building, Nangang 3rd Park, Tangtou, Shiyan, Shenzhen, 518108, China

Solicitante: Domo Salute Consultoria Regulatória Ltda. CNPJ: 26.263.959/0001-03

Autorização de Funcionamento: 8.14.647-5 Expediente: 1466869/23-2

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Vascutek Limited

Endereço: Newmains Avenue, Inchinnan, PA4 9RR, Reino Unido

Solicitante: Jotec do Brasil Importação e Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda. CNPJ: 21.996.505/0001-28

Autorização de Funcionamento: 8.13.982-5 Expediente: 0130781/24-0

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Materiais de uso médico da classe IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Zoll Medical Corporation

Endereço: 269 Mill Road - Chelmsford, MA 01824-4105, Estados Unidos da América

Solicitante: Indumed Comércio Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda. CNPJ: 01.985.366/0001-20

Autorização de Funcionamento: 1.04.299-9 Expediente: 0209055/24-3

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Equipamentos de uso médico da classe IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



RESOLUÇÃO-RE Nº 2.946, DE 14 DE AGOSTO DE 2024

O GERENTE-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder às empresas constantes no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 4 (quatro) anos a partir de sua publicação, conforme art. 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 850, de 20 de março de 2024.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

Fabricante: Abbott Diabetes Care Inc.
Endereço: 1360 South Loop Road, Alameda, California, 94502, Estados Unidos da América
Solicitante: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. CNPJ: 56.998.701/0001-16
Autorização de Funcionamento: 8.01.465-0 Expediente: 1368900/23-2
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Abbott Medical
Endereço: 5050 Nathan Lane North, Plymouth, Minnesota, 55442, Estados Unidos da América
Solicitante: St. Jude Medical Brasil Ltda CNPJ: 00.986.846/0001-42
Autorização de Funcionamento: 1.03.323-4 Expediente: 0004363/24-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III e IV.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Abigo Medical AB
Endereço: Vapenvägen 1, 69633, Askersund, Orebro, Suécia
Solicitante: Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda CNPJ: 54.858.014/0001-70
Autorização de Funcionamento: 1.02.240-0 Expediente: 0155012/24-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
Endereço: Nº. 210 Zhenzhong Road, West Lake District, Hangzhou, 310030, China
Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda CNPJ: 04.718.143/0001-94
Autorização de Funcionamento: 8.01.025-1 Expediente: 0155031/24-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Aomori Olympus Co., Ltd.
Endereço: 2-248-1 Okkonoki, Kuroishi-Shi, Aomori, 036-0357, Japão
Solicitante: Olympus Optical do Brasil Ltda CNPJ: 04.937.243/0001-01
Autorização de Funcionamento: 8.01.246-3 Expediente: 0149370/24-5
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV e Equipamentos de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Aroa Biosurgery Ltd.
Endereço: 2 Kingsford Smith Place - Airport Oaks - 2022 - Auckland, Nova Zelândia
Solicitante: Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares LTDA CNPJ: 04.967.408/0001-98
Autorização de Funcionamento: 8.01.175-8 Expediente: 0195232/24-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe IV.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Arthrex Inc.
Endereço: 1370 Creekside Boulevard, Naples, FL, 34108-1945, Estados Unidos da América
Solicitante: Arthrex do Brasil Importação e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda CNPJ: 18.272.616/0001-87
Autorização de Funcionamento: 8.09.785-6 Expediente: 1480693/23-5
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Avent, Inc.
Endereço: 6620 S. Memorial Place, Suite 100, Tucson, Arizona, 85756, Estados Unidos da América
Solicitante: CEI Comércio Exportação Importação de Material Médico Ltda CNPJ: 40.175.705/0001-64
Autorização de Funcionamento: 1.02.344-0 Expediente: 0213642/24-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Balt USA, LLC.
Endereço: 29 Parker, Irvine - California, 92618, Estados Unidos da América
Solicitante: Balt Brasil Produtos Médicos Ltda. CNPJ: 12.236.355/0002-44
Autorização de Funcionamento: 8.19.362-1 Expediente: 1466795/23-9
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV e equipamentos de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Cam Bioceramics B.V.
Endereço: Zernikedreef 6, 2333 CL. Leiden - Holanda
Solicitante: JGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. CNPJ: 00.489.050/0001-84
Autorização de Funcionamento: 1.03.444-2 Expediente: 0259959/24-3
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe IV.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Carl Zeiss Meditec AG
Endereço: Max-Dohrn-Strasse 8-10, 10589, Berlim, Alemanha
Solicitante: Carl Zeiss do Brasil Ltda. CNPJ: 33.131.079/0001-49
Autorização de Funcionamento: 1.03.320-3 Expediente: 0168496/24-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Cell Marque Corporation
Endereço: 6600 Sierra College Boulevard, Rocklin, California, 95677, Estados Unidos da América
Solicitante: Inopat Importação e Exportação Ltda CNPJ: 07.440.995/0001-50
Autorização de Funcionamento: 8.03.584-3 Expediente: 1455659/23-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Cell Marque Corporation
Endereço: 6600 Sierra College Blvd, Rocklin, Califórnia, 95677, Estados Unidos da América
Solicitante: Roche Diagnóstica Brasil Ltda CNPJ: 30.280.358/0001-86
Autorização de Funcionamento: 1.02.874-1 Expediente: 1405297/23-9
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Coloplast Manufacturing France S.A.S
Endereço: 9, Avenue Edmond Rostand, CS 70218, 24206 - Sarlat La Canéda Cedex, França
Solicitante: Coloplast do Brasil Ltda CNPJ: 02.794.555/0003-40
Autorização de Funcionamento: 1.04.303-1 Expediente: 0202379/24-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Contec Medical Systems Co., Ltd.
Endereço: 112 Qinhuang West Str., E&T Development Zone, Qinhuangdao, 066004 Hebei Province, China
Solicitante: Medmax Comércio de Equipamentos Médicos e Similares Ltda CNPJ: 07.760.277/0001-61
Autorização de Funcionamento: 8.02.989-7 Expediente: 0035047/24-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: E.M.S Electro Medical Systems S.A.
Endereço: Route de Champ-Colin 2, Nyon, 1260, Suíça
Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda CNPJ: 04.718.143/0001-94
Autorização de Funcionamento: 8.01.025-1 Expediente: 0130979/24-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Elekta Limited
Endereço: Linac House, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9RR, Reino Unido
Solicitante: Elekta Medical Systems Comércio e Serviços para Radioterapia Ltda CNPJ: 09.528.196/0001-66
Autorização de Funcionamento: 8.05.693-2 Expediente: 0373736/24-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Erbe Elektromedizin GmbH
Endereço: Waldhornlestrasse 17, 72072 Tubingen, Alemanha
Solicitante: Erbe do Brasil Equipamentos Cirúrgicos e Endoscópicos Ltda. CNPJ: 27.709.659/0001-78
Autorização de Funcionamento: 8.16.124-1 Expediente: 0149190/24-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Establishment Labs S.A.
Endereço: Coyoil Free Zone & Busines Park Buiding, 0 Street, Buiding B-25, Alajuela, 20113, Costa Rica
Solicitante: Establishment Labs Brasil Produtos para Saúde Ltda CNPJ: 08.290.164/0001-02
Autorização de Funcionamento: 8.05.883-9 Expediente: 0413116/24-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Ethicon Endo-Surgery, S.A. de C.V., Planta II
Endereço: Calle Durango, n. 2751, Colonia Lote Bravo, Ciudad Juarez, 32575, Chihuahua, México
Solicitante: Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. CNPJ: 54.516.661/0001-01
Autorização de Funcionamento: 8.01.459-0 Expediente: 0119369/24-9
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III e equipamentos de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Empresa: Euro Parts Brasil Indústria e Comércio Instrumental Cirúrgico Ltda. CNPJ: 13.440.884/0001-47
Endereço: Rua Aratibá (Cond. C. Ind. Limeira), 212, Centro Industrial de Limeira - CIL, Limeira, São Paulo, Brasil CEP: 13481-208
Autorização de Funcionamento: 8.18.242-1 Expediente: 1474141/23-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Gambro Industries SAS
Endereço: 7 Avenue Lionel Terray, BP 126, Meyzieu, 69883, França
Solicitante: Baxter Hospitalar Ltda CNPJ: 49.351.786/0001-80





CADEIRA MOCHO GIRATÓRIO COM RODÍZIOS



Especificações:

Sistema de elevação do assento acionados por uma alavanca lateral

Revestimento:

Cor do revestimento:

Tipo de revestimento: couro ecológico;

Detalhamento do assento:

Espuma laminada de alta densidade redonda;

Diâmetro 38 cm x espessura 8 cm;

Detalhamento do encosto:

Espuma laminada de alta densidade redonda;

Largura 40 cm x espessura 4 cm x altura 25 cm;

Componentes da base giratória:

Flange em aço preta;

Pistão a gás preto, permite regulação da altura;

Estrela em aço com capa preta;

Rodízios em nylon;

Base possui raio externo de 28,5 cm, raio útil de 28 cm;

Parafusos philips para montagem;

Dimensões e peso montado:

Altura do assento referente ao piso, mínima 46,5 cm, máxima 57 cm;

Peso líquido aproximado: 7,5 kg;

Peso bruto aproximado: 8 kg;

Peso suportado: 120Kg

Componentes inclusos:

01 assento mocho;

01 encosto mocho;

01 suporte de encosto com capa preto;

01 flange em aço preta;

01 pistão com capa preta;

01 estrela em aço com capa preta;

05 rodízios nylon preto;

Parafusos para montagem philips;

Manual de montagem.

Garantia: 12 meses.



APARELHO DE PRESSÃO TIPO ANERÓIDE PREMIUM



Descrição:

- Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente;
- Braçadeira em material antialérgico flexível;
- Fecho em presilha metálica ou fecho em velcro;
- Pêra com válvula em metal reforçado;
- Manômetro, com visor graduado de 0 a 300 mm/hg;
- Divisão da escala em 2mmHg;
- Caixa de metal altamente resistente com presilha de metal;
- Mangueiras em borracha (Bolsa de ar), com conectores, em PVC;
- Pêra insufladora de ar em borracha (látex free), com válvula de controle de ar, em metal cromado, permitindo a retenção e o esvaziamento de ar;
- Tamanho:
 - º Neonatal – 07-13cm
 - º Infantil – 10-18cm
 - º Adulto – 18-35cm
 - º Obeso – 35-51 cm
- Isento de mercúrio;
- Manual de instrução e garantia.
- Garantia 24 meses.

BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL

CONTEC – SP 750



DESCRIÇÃO:

Controle de infusão de alta precisão, compatível com a maioria dos conjuntos de IV. Lembrando do início de infusão e exibição de tempo residual.

Limiar de Alarme de bolha de ar e a pressão pode ser ajustada e o volume do alarme também é ajustável.

Que acompanham IV-defina o grampo impede a livre passagem de líquido se a bomba porta se abrir acidentalmente.

A.B.S--Anti BOLUS sistema impede que um momento de injeção a alta dose de obstrução súbita desaparecer.

Válvula de corte de fluxo automático durante alarmes. (Exceto para "near end", "KVO" e "Low Battery" alarmes).

Caixas de alumínio compactos e robustos.

Chinês e Inglês são opcionais.

Porta USB é conveniente para o pessoal técnico para atualizar o software.

O suporte versátil permite a montagem da bomba de infusão na pole em muitas direções, o que pode economizar espaço.

Especificações:

- Manual do usuário
- Cabo de alimentação
- Sistema: Peristáltico Linear
- Compatível com equipos universais próprios para bomba de infusão, a base de silicone
- Desvio da vazão com equipo padrão de silicone: $\pm 5\%$ vazão após calibração (*);
- Taxa de infusão: 1-699ml / h, incremento: 1 ml / h;
- Volume total: 1-9999ml /h, incremento: 1 ml / h;
- Pressão de oclusão: 100 kPa~300kPa;
- KVO: abaixo de 5ml/h KVO de 1ml/h e acima de 5ml/h KVO de 5ml/h
- Bolus: Fixo em 699 ml/h;
- Detector de bolhas de ar: ultrassom;
- Display LCD de 3,5 polegadas;
- ALARME: por oclusão, infusão perto do fim, bolhas de ar, porta aberta, falha do motor, finalizando perfusão, aviso de infusão, estado KVO, bateria fraca, falta de energia, falha de pressão, falha na porta e falta de comunicação;
- Para de infundir automaticamente durante o alarme (exceto para os alarmes: Próximo do fim e bateria fraca);
- Fonte de alimentação: AC 100 ~ 240 V, 50 /60 Hz
- Bateria: Lítio recarregável autonomia de aproximadamente 5 horas;
- Peso: 2kg;
- Dimensão: 143,6 mm (C) × 151,8 mm (L) × 195,3 mm (A)

ANVISA: 80298970203

Aparelho de Pressão Digital Automático de Pulso G-Tech BSP11



O novo Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço G-TECH Home BSP11 é uma solução completa para medição da pressão arterial. Além das medições tradicionais de pressão arterial e frequência cardíaca, possui uma série de outros benefícios, como: Memória para 120 resultados, indicador de arritmia cardíaca, indicador gráfico de nível de hipertensão e o cálculo da média automática das três últimas medições. Todas essas funções permitem um acompanhamento completo dos níveis de pressão arterial, sempre contando com a qualidade e segurança da marca G-TECH, que oferece uma garantia de 5 anos, assegurando tranquilidade por um período estendido.

CARACTERÍSTICAS:

- Medição de Pressão Arterial e Frequência Cardíaca
 - Detecção de Arritmia Cardíaca
 - Indicador Gráfico de Nível de Hipertensão
 - Média Automática das 3 últimas Medições
 - 120 Memórias com Hora e Data
 - Totalmente automático
 - Medição no braço
 - 5 Anos de garantia
 - Bolsa para transporte e pilhas incluídos
- Anvisa nº 80275310064

LARINGOSCÓPIO

MARCA: MD



Laringoscópio MD Macintosh Curva e Reta

A lâmina convencional para laringoscópio da MD é utilizado em conjunto com o Cabo para exames na laringe. Possui diversos tamanhos para uso que varia do infantil para adulto.

Características do produto:

- Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem;
- Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão;
- As arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão;
- Esterilizável e autoclavável.

Lâminas:

- 1 CABO PARA LARINGOSCÓPIO MÉDIO.
-
- 1 CABO PARA LARINGOSCÓPIO PEQUENO.
-
- 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM 0 COM LÂMPADA.
-
- 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM 1 COM LÂMPADA.
-
- 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM 2 COM LÂMPADA.
-
- 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM 3 COM LÂMPADA.
-
- 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM 4 COM LÂMPADA .
-
- 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM 5 COM LÂMPADA.
-
- 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM 00 COM LÂMPADA
- 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM 0 COM LÂMPADA
- 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM 1 COM LÂMPADA.
- 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM 2 COM LÂMPADA.
- 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM 3 COM LÂMPADA.
- 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETATAM 4 COM LÂMPADA .

Garantia: 12 meses.

MANUAL DO USUÁRIO



INALOVIDA

MRM-200 / MRM-200C

Rev.01

Maior/2023



MRM HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 20.920.517/0001-06

Endereço: Rua Araruama, Quadra 56 Lote 26, Sala 01, Aparecida de Goiânia / GO

CEP: 74.913-190 - Telefone: (62) 3549-8054

Sumário

INTRODUÇÃO	3
APRESENTAÇÃO	4
INDICAÇÃO MÉDICA DESTINADA	4
POPULAÇÃO DE PACIENTES DESTINADA	4
PERFIL DO USUARIO	5
PARTE DO CORPO OU TECIDO NO QUAL SE APLICA OU INTERAGE	5
PERFIL DO USUÁRIO (OPERADOR DESTINADO)	5
PRINCIPIO DE OPERAÇÃO	6
DESEMPENHO ESSENCIAL	6
CONTRAINDICAÇÕES	7
ADVERTÊNCIAS	8
SIMBOLOS UTILIZADOS	12
MODELOS E ESPECIFICAÇÕES	14
ACESSORIOS	14
INALOVIDA EM DETALHES	14
DESCRIÇÃO TÉCNICA	15
TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E UTILIZAÇÃO	15
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	16
DESEMBALAGEM	17
INSTALAÇÃO	18
CONECTANDO O FLUXÔMETRO	18

CONECTANDO A MASCARA DE NEBULIZAÇÃO	19
CONDIÇÕES DE USO	21
ACIONANDO OS FREIOS.....	24
ACESSÓRIOS INCLUSOS.....	25
OPCIONAIS	25
MANUTENÇÃO	26
SUBSTITUINDO OS FUSÍVEIS	27
CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO	28
LIMPEZA E DESINFECÇÃO	28
ESTERILIZAÇÃO – (SOMENTE PARA AS MASCARAS DE NEBULIZAÇÃO).....	29
PROBLEMAS E SOLUÇÕES	31
CONSIDERAÇÕES PARA PROJETO ECO RESPONSÁVEL	31
COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA	33
IMUNIDADE RADIADA A CAMPO PRÓXIMO	36
TERMO DE GARANTIA	37

INTRODUÇÃO

A MRM é uma empresa que realiza pesquisas de forma continuada, balizadas por um amplo Gerenciamento de Riscos e atendimento a todos os parâmetros exigidos e aplicáveis aos processos de fabricação pela ABNT NBR IEC 60601-1 e suas normas colaterais.

Os Nebulizadores IINALOVIDA são produtos certificados pelo INMETRO o que garante aos nossos usuários uma experiência em equipamentos de qualidade, eficiência e segurança.



Recomendamos que o leia com atenção antes de utilizar o equipamento pela primeira vez.

APRESENTAÇÃO

Os nebulizadores INALOVIDA são compostos por um compressor de diafragma, isento de óleo, com acionamento direto por motor elétrico. O fluxômetro conectado a cada válvula de saída da régua de distribuição regula a qualidade da névoa produzida na máscara de nebulização.

INDICAÇÃO MÉDICA DESTINADA

Os nebulizadores INALOVIDA são indicados para procedimentos inalatórios em humanos. A inalação ajuda a umidificar as vias respiratórias e a secreção nasal, é de fato um alívio para ajudar a melhorar a respiração quando o nariz está entupido, decorrente de gripes e tantas outras doenças respiratórias.

A nebulização é um tipo de aerossol terapia, ou oxigenioterapia, procedimento que utiliza a inalação de vapores como via medicamentosa. Esse método é amplamente indicado no tratamento de problemas respiratórios agudos e crônicos de diversas origens, incluindo asma, bronquites, sinusites, infecções e inflamações em geral.

Os nebulizadores INALOVIDA são indicados para utilização por profissional habilitado ao uso do equipamento em humanos em ambientes hospitalares, clínicas médicas e odontológicas, centros de saúde, ambulatorios e laboratórios.

POPULAÇÃO DE PACIENTES DESTINADA

- Idade: sem restrições;
- Peso: sem restrições;
- Condições de saúde: sem restrições;

- Contraindicações: não há.

PERFIL DO USUÁRIO

O equipamento exige que seu operador tenha um mínimo de:

- Discernimento e capacidade interpretativa.
- Ler e compreender caracteres em português em fonte Arial.
- Capacidade física: um membro capaz de pressionar uma tecla quadrada de 1,5 cm de lado.
- Acuidade visual: zero na escala do log MAR ou 20/20 corrigido se necessário.
- Consciência e orientação: equivalente a uma criança de 12 anos com supervisão de um adulto.

PARTE DO CORPO OU TECIDO NO QUAL SE APLICA OU INTERAGE

Os nebulizadores INALOVIDA não fazem contato com o paciente. Apenas a máscara utilizada para inalação faz contato com a pele do usuário.

PERFIL DO USUÁRIO (OPERADOR) DESTINADO:

Para adaptar o uso do produto aos usuários destinados, alguns fatores devem ser considerados quando se desenvolve um perfil de usuário. Dentre eles podemos citar: idade, sexo, linguística e contexto cultural, nível de educação e competência profissional. Potenciais deficiências dos usuários destinados devem ser observadas

Perfil do usuário destinado:

- Idade: sem restrições;
- Sexo: sem restrições;
- Linguística / contexto cultural: usuários alfabetizados no idioma Português com contexto cultural correspondente;
- Nível de educação e competência profissional: Médicos, Enfermeiros e auxiliares de Enfermagem e usuários em condições físicas desde que autorizados pelo profissional responsável;
- Potenciais deficiências dos operadores: não deve ser utilizado por usuários incapazes de compreender as instruções de utilização do equipamento (Manual do Usuário).

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

Os Nebulizadores INALOVIDA são equipamentos que operam com um sistema de pistão/diafragma acionado por motor elétrico isento de óleo para injetar ar comprimido, filtrado em todas as válvulas da régua garantindo uma névoa homogênea e contínua nas máscaras dos inaladores.

DESEMPENHO ESSENCIAL

Determinação do desempenho essencial de acordo com o requisito 4.3 da IEC 60601-1, 3 ed.:

Função necessária para o uso previsto:

- Os nebulizadores Inalovida são equipamentos que tem por finalidade a geração de névoa para tratamento por nebulização. É acionado por motor elétrico, o sistema pistão/diafragma injeta ar comprimido, filtrado, a uma taxa de 70 l/min, em todas as válvulas da régua, garantindo uma névoa homogênea e contínua nas máscaras dos inaladores.

Especificação do parâmetro de desempenho:

- Os nebulizadores Inalovida não possuem funções clínicas que estejam relacionadas com a segurança básica que são necessárias para o uso destinado ou que possam afetar a segurança do produto.

Avaliação do risco da perda ou degradação do desempenho:

- Os nebulizadores Inalovida não apresentam risco ao usuário em caso de perda ou degradação do desempenho, se utilizado conforme a recomendação do fabricante. Os riscos relacionados ao uso foram identificados e estão avaliados neste Arquivo de Gerenciamento de Risco.

Determinação do desempenho essencial:

- Com base na sistemática descrita acima, conclui-se que a família de nebulizadores INALOVIDA **não apresenta desempenho essencial**, pois não há riscos residuais inaceitáveis relacionados à parâmetros fisiológicos ou à degradação do desempenho.

CONTRAINDICAÇÕES



ATENÇÃO!

- Equipamento contraindicado para uso na presença de uma mistura anestésica inflamável com Ar, Oxigênio ou Óxido Nitroso.
- Equipamento contraindicado para utilização em um ambiente rico em oxigênio.
- Equipamento contraindicado para uso em locais sem aterramento adequado.
- O uso clínico do equipamento é contraindicado para operador e/ou paciente sem a capacitação profissional adequada.

ADVERTÊNCIAS



ATENÇÃO!

- Este manual deverá acompanhar o produto até o final de sua vida útil, leia-o com atenção antes de usar seu equipamento.
- Este equipamento deverá ser utilizado para os fins descritos neste manual, devendo para tanto estar em perfeitas condições de funcionamento. A sua utilização para outros fins, poderá ocasionar lesões ao usuário e avarias graves ao produto, não sendo cobertas pela garantia do fabricante.
- Para evitar choque elétrico, este equipamento deve ser conectado apenas a uma rede de alimentação com aterramento para proteção. Nunca utilize adaptadores tipo Benjamin, (T), para ligar o equipamento.
- A fim de evitar choque elétrico sempre retire o plugue, do cabo de alimentação elétrica, da tomada antes da realização de qualquer manutenção.
- A fim de evitar choque elétrico sempre retire o plugue, do cabo de alimentação elétrica, da tomada antes da realização de qualquer manutenção.
- Modificações, substituições e adaptações no equipamento e seus acessórios não devem ocorrer sem autorização do fabricante. A Empresa não se responsabiliza por acidentes ao usuário ou avarias ao equipamento em caso de descumprimento deste item.
- Em caso de substituição dos componentes elétricos do equipamento, tais como; cabos de alimentação elétrica, chave liga desliga etc. ensaios de segurança elétrica deverão ser realizados.
- Nunca lubrifique o compressor. Nunca utilize o equipamento como aspirador.
- A substituição, utilização ou adaptação de peças, acessórios, cabos e transdutores, como peças de reposição para componentes diferente dos

comercializados ou indicados pela MRM, podem resultar em acréscimo de emissões ou decréscimo da imunidade do equipamento. Tal ato será considerado mau uso e, portanto, sem cobertura da garantia em caso de defeitos do aparelho ou incidentes envolvendo o usuário.

- Os Nebulizadores INALOVIDA são equipados com cabo de rede dotado de plugue com três pinos, conforme o padrão brasileiro, certifique-se de conectá-lo a uma tomada de rede que possua aterramento adequado além da tensão indicada no aparelho. Desenrole o cabo do porta cabo na quantidade suficiente para conectar o plugue à tomada.
- Nunca enrole as mangueiras dos micronebulizadores no porta cabo do carrinho, caso contrário as mesmas poderão se dobrar diminuindo ou até mesmo interrompendo o fluxo de ar nos micronebulizadores.
- Equipamento não adequado na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nítrico.
- Mantenha e opere o equipamento em temperaturas entre 10 e 40° C, umidade relativa do ar entre 20% e 90% sem condensação, e pressão atmosférica entre 525 mmHg a 795 mmHg.
- Antes de iniciar qualquer movimento verifique se há condições de realizá-lo com segurança para o paciente e pessoas próximas ao equipamento. Quando em movimento evite passar com os rodízios sobre o cabo de rede e sobre as mangueiras dos nebulizadores, evite também choques contra paredes, móveis ou outros obstáculos que possam causar ou sofrer danos.
- Nunca inserir objetos ou cobrir as aletas de ventilação do Nebulizador, isso poderá ocasionar choque elétrico ou superaquecer o motor.
- Antes de iniciar qualquer reparo ou manutenção no equipamento, retire o plugue de rede da tomada elétrica, caso contrário há sério risco de choque elétrico.
- Jamais tente desconectar o plugue de rede puxando o cabo de alimentação do equipamento.
- A MRM recomenda manutenções periódicas a cada seis (06) meses em seus equipamentos, para tanto solicite junto a assistência técnica da empresa a





visita de um técnico especializado ou envie-nos seu equipamento para avaliação e manutenção.

- Os custos decorrentes da prestação de serviço por técnico da empresa correm por conta do cliente solicitante assim como o transporte do equipamento até a empresa e sua posterior devolução. As peças e ou componentes substituídos e a mão de obra executada que não fizerem jus à garantia contratada serão cobrados do cliente.
- A MRM possui em seu arquivo os projetos com as tabelas de componentes, materiais, acessórios, placas de circuito impresso e o leiaute de montagem e instalação que poderão ser fornecidos ao pessoal de serviço do cliente segundo acordo ou contrato firmado anteriormente.
- O equipamento possui materiais e componentes recicláveis, ao final de sua vida útil realize o seu descarte em local apropriado para reaproveitamento e reciclagem, ou devolva-o ao fabricante.
- Recomenda-se não conectar a alimentação em uma tomada que seja de difícil acesso para desconexão. Para isolar completamente o aparelho da rede elétrica desconecte ao cabo de rede da tomada.
- Pode haver risco de fogo se o equipamento for utilizado na presença de materiais, soluções ou gases inflamáveis, ou em um ambiente enriquecido com oxigênio;
- Equipamentos de comunicação por rádio frequência (RF), portáteis e móveis, podem afetar o funcionamento.
- Não convém que o equipamento seja utilizado em proximidade com ou empilhado sobre outro equipamento e que, caso o uso em proximidade ou empilhado seja necessário, convém que o equipamento seja observado para verificar se está funcionando normalmente na configuração na qual será utilizado.
- O inalador não deve passar por assistência técnica ou manutenção durante o uso com um paciente.
- Utilize apenas acessórios e componentes recomendados pela MRM.

- Ao iniciar a operação do equipamento, verifique se o mesmo está funcionando adequadamente. Caso seja identificada alguma avaria ou mal funcionamento, suspenda o uso contate a MRM.
- Não posicione o nebulizador de forma a obstruir as aberturas do gabinete.
- Nunca coloque objetos ou tecidos sobre o gabinete, pois isto poderá causar sobreaquecimento e danos permanentes ao nebulizador.
- Utilize somente máscaras biocompatíveis destinadas à procedimentos de nebulização recomendadas pela MRM.
- Aviso: Convém que os equipamentos portáteis de comunicação por RF (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) não sejam utilizados a menos de 30 cm de qualquer parte do nebulizador, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, pode ocorrer degradação do desempenho deste equipamento.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Fabricante
	Data de fabricação
	Número de série
	Atenção
	Siga as instruções de uso
	Parte aplicada Tipo BF
IP20	Grau de proteção contra penetração de sólidos e líquidos
	Peso bruto do equipamento com carga de trabalho
	Proibido obstruir as entradas de ventilação
	Classe II
	Ligado / Desligado
	Frágil
	Este lado para cima

	Mantenha afastado da chuva
	Mantenha protegido da luz solar
	Empilhamento máximo
	Limites de temperatura para transporte e armazenamento
	Limites de umidade para transporte e armazenamento
	Limites de pressão atmosférica

 MRM Hospitalar LTDA Rua Araruama Qd.56 Lt.26 Sala.01 Vila Alzira / Ap. De Goiânia - Go Cep: 74913-190 Sac: (62) 3549-8054 Cnpj: 20.920.517/0001-06			
Modelo: Nebulizador - Inalovida MRM-200C	SN	042023200C0001	
Massa: 13KG	LOT	030420230001	
Tensão: 115 – 220 V AC		03/04/2023	
Frequência: 50 / 60 Hz			
Potência: 290 VA			
Modo de operação: Intermitente 15min on - 20min off			
Fusíveis de entrada = Vidro pequeno, 250 V, 5 A			
Responsável Técnico: Suelen Carmem S. Teodoro - Coren / Go: 217.901			

Etiqueta de identificação do produto

Etiqueta De Rastreabilidade Acessório.			
Fabricante / Distribuidor MRM Hospitalar Ltda.			
Modelo			
Responsável Técnico Suelen Carmem S. Teodoro / Coren-Go 217.901 Registro Anvisa nº		NS	
		LOT	
Rua Araruama Qd.56 Lt.26 Sala.01 Vila Alzira - Ap. De Goiânia - Go / Cep:74913-190 Sac - Whatsapp: 3549-8054 / Cnpj:20.920.517/0001-06			

Etiqueta de rastreabilidade do acessório


MODELOS E ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Número de Saídas	Carro Suporte	Kit micro nebulização	Bivolt Automático
MRM-200	1 a 6	Não	1 a 6 Kits adulto ou infantil	Sim
MRM-200C	1 a 6	Sim (4 ou 5 rodízios com freios 1 a 6 polegadas)	1 a 6 Kits adulto ou infantil	Sim

ACESSÓRIOS

- KITS de nebulização adulto ou infantil
- Time digital
- Lâmpada piloto
- Tomada de válvula de impacto
- Suporte para máscaras

INALOVIDA EM DETALHES

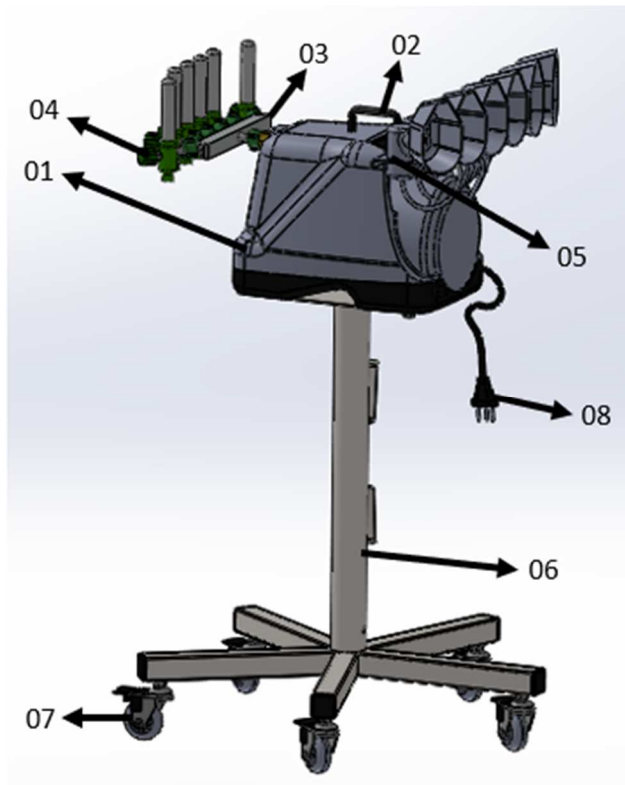

1. Gabinete
2. Alça auxiliar
3. Régua de distribuição
4. Fluxômetro
5. Suporte de máscaras
6. Carro de suporte
7. Rodízio com freio
8. Plugue (2P+T)

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Equipamento de concepção simplificada, robusto e confiável com operação conhecida por profissionais da área. Projetado e construído com a tecnologia MRM, equipado com um motor de 12 volts, em corrente contínua, alimentado por uma fonte de tensão com entrada de 115 a 220 volts, 2,0 ampères, automático, com proteção interna de curto circuito de saída o que garante a integridade do equipamento em casos de surtos de tensão na rede de alimentação. Equipado com uma régua de distribuição com opções de 1 a 6 saídas, em cada saída um fluxômetro permite a regulagem individual da qualidade e quantidade de névoa formada em cada máscara e necessária ao tratamento.

Equipamento é instalado sobre um carro de suporte, construído em chapa de aço carbono de 1,2 mm de espessura, coluna em tubo de aço carbono Ø 2 polegadas

com 1,2 mm de espessura apoiada em base de tubo retangular em aço carbono com espessura de 1,2 mm, com rodízios nas extremidades dotados de freios individuais que permitem a estabilidade do conjunto mesmo em rampas de até 10° de inclinação. Toda a estrutura metálica é pintada em resina epóxi em pó, por processo eletrostático

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E UTILIZAÇÃO

- Temperatura entre – 40 ° C e + 70 ° C;
- Umidade Relativa do Ar entre 10 % e 80 % sem condensação;
- Pressão Atmosférica entre 375 mmHg e 795 mmHg.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Classificação de acordo coma IEC 60601-1	
Tipo de proteção contra choque elétrico	Equipamento Classe II
Grau de proteção contra choque elétrico	Parte Aplicada Tipo BF
Partes aplicadas consideradas	Máscaras de nebulização
Grau de proteção IP20	2 (Proteção contra penetração de partículas sólidas)
	0 (Proteção contra penetração de líquidos)
Modo de Operação	15 minutos ligado / 20 minutos desligado
Uso em ambiente rico em oxigênio	Não adequado

Características físicas	
Altura	1050 mm
Largura	600 mm
Comprimento	600 mm
Massa do equipamento com carga máxima	11 Kg

Características elétricas	
Tensão de entrada	115 – 220 V AC
Frequência de entrada	50/60 Hz
Corrente máxima de entrada	2,0 A
Potência máxima de entrada	300 VA
Fusíveis de entrada	Vidro pequeno, 250 V, 1,5 A
Tensão de saída	12 Vcc
Corrente máxima de saída	8,3 Acc
Potência do Motor	1/4 cv. (186 W)
Rotação	em 60 Hz = 1750 rpm
Pressão Máxima do Compressor	40 lbf/pol ²
Deslocamento Teórico	70 l/min
Classe de Isolamento do Motor	F

DESEMBALAGEM

O produto é entregue pré-montado e contém partes móveis e frágeis, portanto transporte-o com cuidado até a área onde será desembalado. Todos os materiais utilizados na embalagem são recicláveis e não estéreis seu descarte e ou reciclagem é de responsabilidade do cliente. Verifique atentamente a existência de acessórios e partes avulsas, caso seja constatado o extravio ou dano dos mesmos contate imediatamente o transportador e o fabricante para instruções quanto às providencias a serem tomadas.

INSTALAÇÃO




ATENÇÃO!


- Ao instalar o equipamento mantenha o acesso ao plugue, do cabo de alimentação elétrica, desimpedido facilitando a sua desconexão da rede elétrica em emergências.
- O INALOVIDA é fornecido com cabo de alimentação elétrica dotado de plugue com três pinos, dos quais o pino central é o terra. O uso do equipamento em uma rede não aterrada poderá causar choque elétrico. Verifique se a tensão da rede local corresponde ao selo indicador de tensão no cabo de alimentação elétrica do Produto, de 115 a 220 V, com frequência de 50/60 Hz.
- Mantenha as aletas de ventilação desimpedidas. Não posicione o Inalovida muito próximo a paredes ou equipamentos que possam obstruir a ventilação do compressor, mínimo 20 centímetros. Nunca use o equipamento como cabide ou aparador.

CONECTANDO O FLUXÔMETRO

Retire um fluxômetro da embalagem, (elemento 1) e rosqueie a porca borboleta do fluxômetro, (elemento 2), à uma saída da régua de distribuição do equipamento, (elemento 3), aperte para que não haja vazamento:

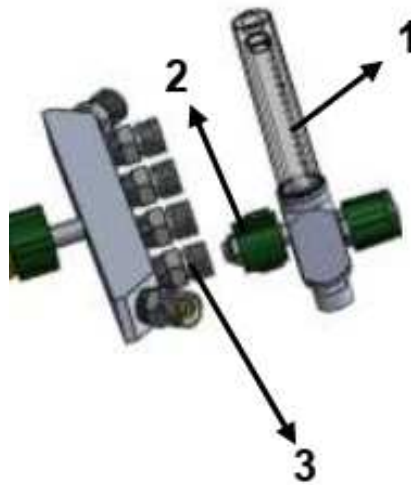


Repita o procedimento acima em todas as saídas da régua:

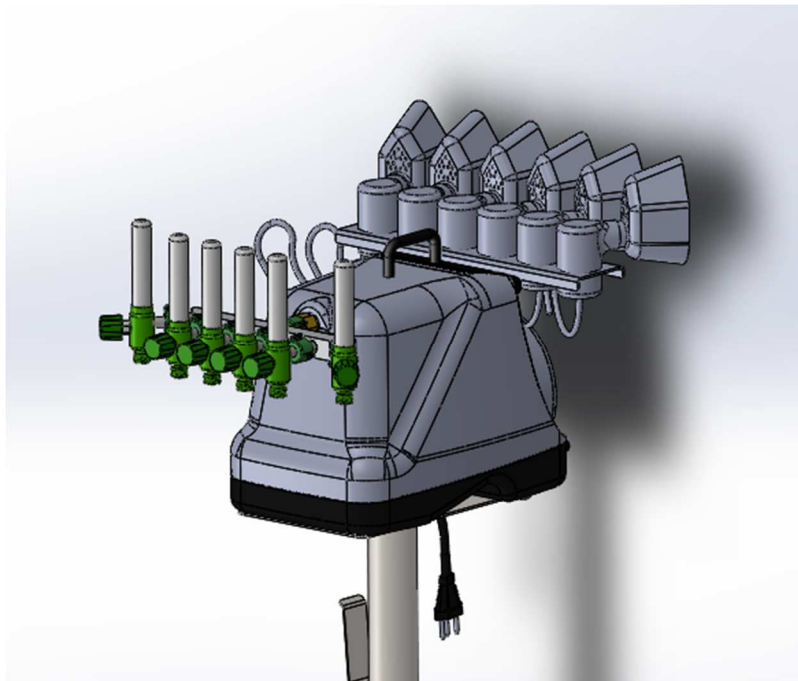


CONECTANDO A MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO


Retire a mangueira que acompanha a máscara de nebulização, da embalagem, (elemento 4), rosqueie a porca borboleta da mangueira à saída do fluxômetro, (elemento 5).

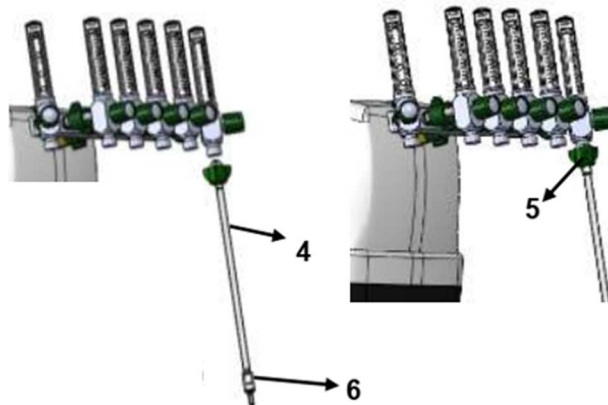

Desenrosque o copo da tampa da máscara de nebulização, (elemento 7) e despeje, nele, o medicamento prescrito, não ultrapasse a quantidade máxima marcada no próprio copo para que não prejudique a formação da névoa. Recoloque a tampa e mantenha o copo na posição vertical, ou insira a máscara no suporte para do carro de transporte, (elemento 8).

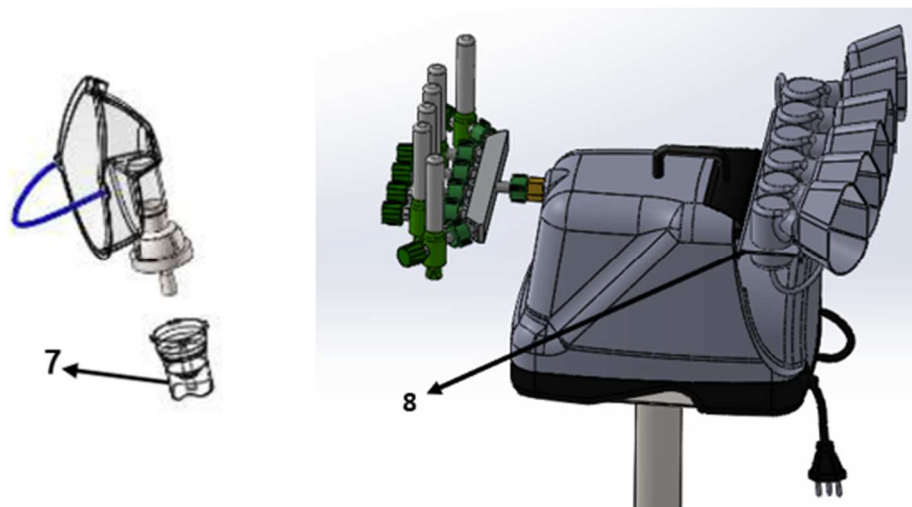

Encaixe o bico cônico da mangueira, (elemento 6) ao fundo do copo da máscara de nebulização, (elemento 9).

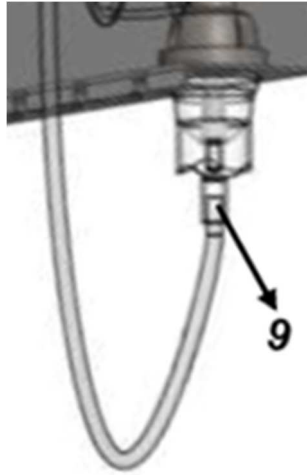

ATENÇÃO!

- Antes de reutilizar a máscara de nebulização certifique-se de que todas as conexões da mangueira, do fluxômetro e da máscara estejam adequadamente limpas isentas de óleo, graxa e poeira.
- Para evitar contaminação cruzada, não reutilize a máscara sem a limpeza indicada pelo fornecedor da própria máscara ou um dos métodos descritos neste manual.
- Nunca mantenha o equipamento em funcionamento com todos os fluxômetros fechados. Observe periodicamente a existência de vazamentos; no conjunto da máscara de nebulização, nas conexões do fluxômetro, substituindo tais acessórios conforme indicado pelo fabricante ou ao final de sua vida útil.

CONDIÇÕES DE USO



ATENÇÃO!


Antes de ligar o Inalovida, certifique-se de que:

- O equipamento está afastado da parede ou de obstáculos que possam impedir

a ventilação do motor.

- Não há roupas, objetos ou líquidos sobre o equipamento.
- Pelo menos um fluxômetro está totalmente aberto.
- O ambiente está de acordo com as indicações do fabricante.
- O operador, mesmo que este seja o próprio paciente, está familiarizado e devidamente treinado na operação do equipamento.
- A tensão de rede corresponde à marcada no cabo de alimentação do equipamento.
- O operador esteja posicionado próximo ao equipamento, raio aproximado de 50 cm, em relação a chave liga-desliga e fluxômetro.
- Que o paciente esteja o mais afastado possível do equipamento, (comprimento da mangueira aproximadamente 1 metro)


Abra completamente a saída do fluxômetro, conectado à máscara que será utilizada, girando o botão no sentido anti-horário, figura 7. Somente feche as saídas dos fluxômetros inativos.

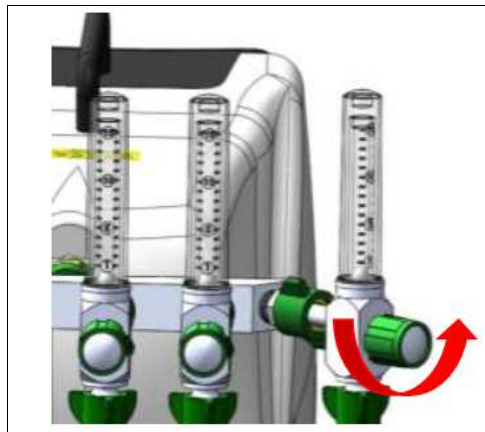

Pressione a chave liga-desliga, na lateral do equipamento, na posição I, o led verde ao lado da chave deverá acender, figura 8, e o motor será acionado.



Ajuste o fluxo de ar no fluxômetro girando o botão. A esfera de indicação de fluxo irá descer ao girar o botão no sentido horário, indicando redução do fluxo de ar, ou subir ao girar o botão no sentido anti-horário, indicando aumento do fluxo de ar.

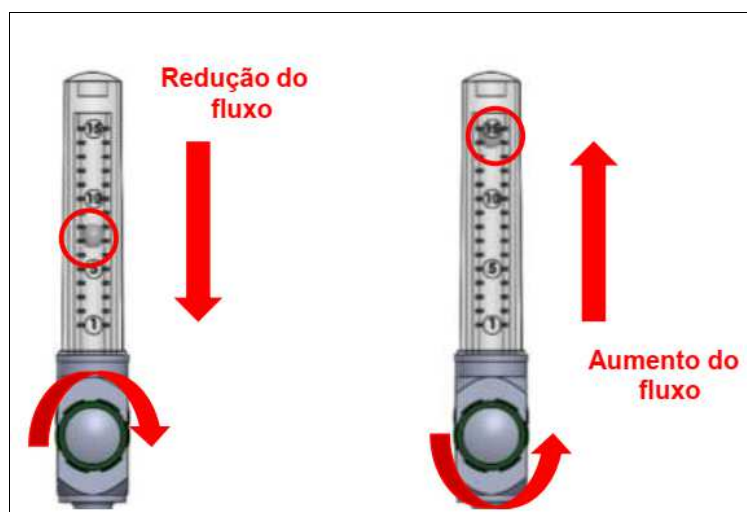

Posicione a máscara de nebulização na face do paciente. Ao final da aplicação feche completamente a saída do fluxômetro e desligue o equipamento, pressionando a chave liga-desliga na posição “O”.




ATENÇÃO!


- Nunca enrole as mangueiras no suporte do cabo de alimentação elétrica, há risco de dobrá-las ou mesmo rompê-las interrompendo o fluxo de ar.
- Não instale o equipamento em lugares fechados sem as devidas condições de operação contidas neste manual. Não obstrua as saídas de ventilação.
- Não introduza ou deixe nenhum objeto cair nas saídas de ventilação. Não derrame água ou outros líquidos sobre o equipamento.
- A não observação do modo de uso, 60 minutos ligado X 90 minutos desligado, e/ou a obstrução das saídas de ventilação do Inalovida poderão elevar até aproximadamente 50 ° C a temperatura na régua de distribuição e no topo do gabinete

ACIONANDO OS FREIOS

O carro de suporte do Inalovida possui rodízios que proporcionam um deslizar suave e seguro do conjunto, facilitando as manobras para deslocamento e posicionamento no ambiente de utilização. Os quatro rodízios possuem freio individual, que uma vez acionados aumentam a estabilidade do conjunto. Para frear pise na alavanca de freio de cada rodízio e as empurre para baixo até que se travem.

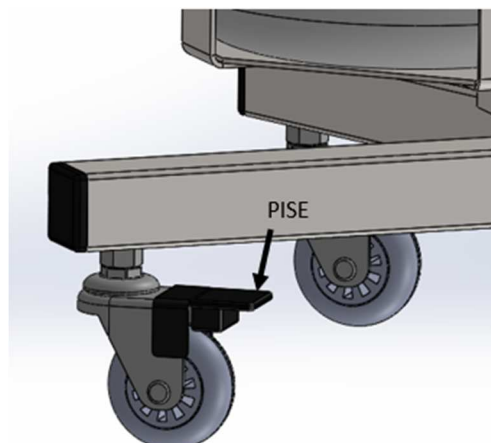

Para destravar puxe com a ponta dos pés, até que retornem à posição livre,

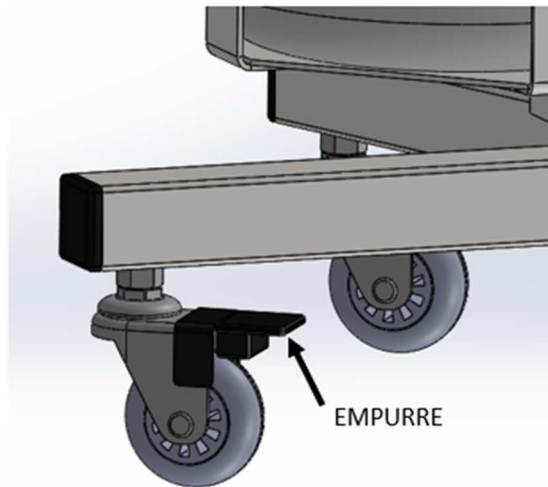

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Alça auxiliar;
- Régua de distribuição de 1 a 6 saídas;
- Carro de suporte com rodízios;
- Kits de nebulização adulto ou infantil;
- Time digital;
- Lâmpada piloto;
- Tomada de válvula de impacto;
- Suporte para máscaras.

OPCIONAIS

- Fluxômetro;
- Máscaras de nebulização, não estéril
Tipo protec / ns / unitec

MANUTENÇÃO




ATENÇÃO!

- Nunca realize nenhuma manutenção sem desconectar o plugue do cabo de alimentação da tomada. Nunca realize manutenções com o equipamento em uso.
- Nunca lubrifique o compressor.
- A MRM possui em seu arquivo os projetos com as tabelas de componentes, materiais, placas de circuito impresso e o leiaute de montagem e instalação que poderão ser disponibilizados ao cliente mediante acordo prévio.
- Durante a vigência da garantia a manutenção elétrica deverá ser realizada exclusivamente pela assistência técnica do fabricante, com agendamento pelos canais de comunicação listados neste manual. Os custos decorrentes da prestação de serviço por técnico da empresa correm por conta do solicitante assim como o transporte do equipamento até a empresa e sua posterior devolução.
- As peças e ou componentes substituídos e a mão de obra executada que não fizerem jus à garantia contratada serão cobrados do cliente.
- No que couber, a manutenção mecânica preventiva deverá ser realizada trimestralmente, preferencialmente pela assistência técnica do fabricante ou por pessoal de serviço com qualificação técnica em mecânica. A substituição dos fusíveis deverá ser realizada somente:
 - Pela assistência técnica autorizada;
 - Pelo pessoal de serviço com treinamento realizado pela empresa.
- OBS.: o treinamento deverá ser contratado e agendado com antecedência junto ao departamento comercial da MRM.

SUBSTITUINDO OS FUSÍVEIS.

A substituição dos fusíveis poderá ser realizada pela assistência técnica da MRM com agendamento pelos canais de comunicação listados neste manual ou pelo pessoal de serviço da unidade de saúde devidamente treinado e autorizado pela empresa. Desligue o plugue do cabo de alimentação, do Inalovida, da tomada e remova as porcas de fixação do gabinete, sob a mesa do carro de suporte.

Para acessar o fusível, gire a tampa do porta-fusível no sentido anti-horário:

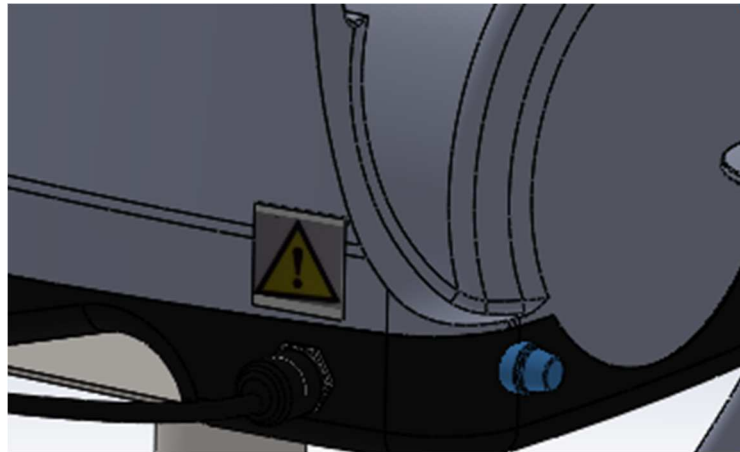

Retire o fusível queimado, (elemento 1), e o substitua por outro fusível conforme indicado em etiqueta adjacente aos porta fusíveis. Recoloque a tampa dos porta fusíveis, recoloca o gabinete sobre o carrinho e aperte novamente as porcas.

Caso o problema permaneça, contate o fabricante.

CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO



ATENÇÃO!

- Em caso de queda do equipamento, teste-o antes de utilizá-lo. Se houver qualquer dano, envie-o para a assistência técnica MRM. Não utilize o equipamento com peças soltas.
- Se o equipamento não estiver funcionando adequadamente como descrito, envie para avaliação na MRM.
- Nenhuma tensão mecânica deve ser aplicada ao cabo de alimentação. Jamais tente desconectar o plugue de rede puxando o cabo de alimentação do equipamento.
- Após o uso mantenha o equipamento desligado, porém conectado à tomada durante 90 minutos, pelo menos, a fim de garantir a estabilidade térmica no interior do aparelho, só então desligue-o da tomada.
- Segure firmemente o plugue ao conectar ou desconectar o aparelho da tomada.
- Não tente reparar nem reconstituir o cabo de alimentação do aparelho. Não utilize o Inalovida como suporte para outros equipamentos ou objetos, por menor e mais leves que sejam

LIMPEZA E DESINFECÇÃO



ATENÇÃO!

- Não realize qualquer procedimento de limpeza ou desinfecção com o equipamento ligado à rede elétrica, aguarde pelo menos 90 minutos após a

utilização para realizar a limpeza do gabinete.

- Nunca tente esterilizar ou desinfetar acessórios de uso único, descarte-os logo após a utilização.
- Não usar produtos à base de amoníaco, tricloroetileno, dicloroetileno, cloreto de amônia, hidrocarbonetos clorados e aromáticos, cloreto de metileno e acetonas. Estes agentes agressivos podem danificar as partes do equipamento e contribuir para o mau funcionamento.
- Atenção também para os "sprays" alcóolicos (20 a 40 % de álcool). Eles não possuem ação de limpeza necessária antes da desinfecção. A utilização de desinfetantes aplicados por "sprays" vaporizadores deve ser feita de acordo com as instruções de seus fabricantes e a uma distância de 30 cm do equipamento para evitar o acúmulo do produto em forma líquida.
- Não utilize produtos abrasivos como esponjas de aço por exemplo.

Somente:

- ✓ Utilizar pano macio e umedecido com detergente neutro para limpeza do gabinete e do carro suporte, retire o excesso com pano umedecido em água;
- ✓ Utilizar pano macio limpo e álcool 70% para desinfecção do gabinete e do carro suporte;
- ✓ Utilize os procedimentos acima, após cada uso do equipamento.

ESTERILIZAÇÃO – (Somente para as Máscaras de Nebulização)



ATENÇÃO!

O processo de esterilização descrito neste manual, deverá ser utilizado somente para as máscaras, fornecedor das máscaras de nebulização recomendadas pela MRM. Em caso de uso de outras marcas deverá ser observado o método de esterilização recomendado pelo fabricante.

Observação: os métodos de esterilização abaixo, foram retirados das “Instruções de uso do *Micro Nebulizador com Máscara Flexível*”.

Método químico

Solução aquosa:

1. Desmontar o equipamento, peça por peça, em água quente, corrente (torneira elétrica) com sabão contendo Hexaclorofeno.
2. Secar todas as peças.
3. **Recipiente nº 1.** Este recipiente deverá conter uma solução de CIDEX (Johnson&Johnson) na qual deverão ser submersas todas as peças já secas, aí permanecendo de 20 a 30 minutos. Poderá ser usado também o ZEPHIRAN (Bayer) solução aquosa.
4. **Recipiente nº 2.** Este recipiente deverá conter água esterilizada, na qual deverão ser enxaguadas todas as peças retiradas do recipiente nº 1.
5. **Recipiente nº 3.** Este recipiente esterilizado a seco receberá todas as peças devidamente secas em toalhas previamente esterilizadas.
6. Recomendamos proceder à troca da solução CIDEX de 10 em 10 dias, e água esterilizada, diariamente

Método Físico/Químico:

Oxido de Etileno (ETO). No Brasil existe legislação específica sobre funcionamento de centrais de esterilização por Óxido de Etileno.



ATENÇÃO!

- Nunca reutilize o INALOVIDA e seus acessórios sem a limpeza, desinfecção e esterilização adequadas, em caso de dúvida sobre as condições do equipamento refaça todos os procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O equipamento não liga	✓ Se o led indicador de uso (verde) estiver apagado. ✓ Conexão do plugue de alimentação com a tomada; ✓ Falta ou queda de energia elétrica. ✓ Fusíveis queimados. ✓ Caso contrário acione a assistência técnica.
Falta de névoa	✓ Mangueiras desconectadas ou danificadas; ✓ Mangueiras vincadas ou dobradas; ✓ Fluxômetro fechado; ✓ Fluxômetros inativos abertos; ✓ Acione a assistência técnica.

CONSIDERAÇÕES PARA PROJETO ECO RESPONSÁVEL

Utilização de substâncias perigosas: não são utilizadas substâncias perigosas ao longo do ciclo de vida do equipamento;

- Emissões atmosféricas: as emissões atmosféricas que ocorrem durante o processo de fabricação do equipamento são monitoradas e estão de acordo com a legislação vigente;
- Liberação de substâncias na água: não são liberadas substâncias na água de superfície e de lençóis freáticos;
- Resíduos, especialmente de substâncias perigosas: não há utilização de substâncias perigosas ao longo do ciclo de vida do equipamento;
- Utilização de recursos naturais, energia e matérias primas: a energia elétrica é utilizada como fonte de recuso natural para a produção do equipamento e para a transformação das matérias primas;
- Ruído, vibração, odores, poeira e campos eletromagnéticos: os fatores mencionados são considerados durante o ciclo de vida do produto e são verificados também nos testes de segurança de acordo com IEC 60601-1 realizados para a certificação;

- Transporte: o transporte do produto bem como de todos os envolvidos pode ser realizado por terceiros e estes devem estar de acordo com as legislações vigentes;
- Riscos derivados de Acidentes Ambientais e o Impacto Ambiental causado, ou que possa ser causado, como consequência de incidentes e situações de emergência potenciais: não são especificados materiais que possam causar risco de contaminação ao meio ambiente em caso de acidentes;
- Uso e contaminação da biosfera: as emissões atmosféricas que ocorrem durante o processo de fabricação do equipamento são monitoradas e estão de acordo com a legislação vigente;
- Instruções para a instalação do equipamento de forma a minimizar o impacto ambiental: o processo de instalação do equipamento não causa impactos ambientais;
- Instruções para o uso e manutenção do Equipamento EM de forma a minimizar o impacto ambiental: As instruções para o uso fornecem informações para minimizar o impacto ambiental. O processo de manutenção deve ser realizado pelo fabricante ou representante autorizado;
- Consumo durante a utilização normal: é considerado o consumo de medicamentos quando necessário e também consumo de soro fisiológico. Para a operação do nebulizador é considerado o consumo de energia elétrica;
- Emissões durante utilização normal: são consideradas as seguintes emissões durante a utilização normal: emissões eletromagnéticas e emissão de energia acústica. Essas emissões estão de acordo com as respectivas normas IEC 60601-1-2 e IEC 60601-1.
- Informações sobre a localização de substâncias perigosas dentro do equipamento: o equipamento não possui substâncias perigosas em seu interior como, por exemplo, fonte de radioatividade;
- Localização das peças e componentes dentro do Equipamento EM que contém energia armazenada: o equipamento não possui peças ou componentes que contenham energia armazenada que possam representar perigos.

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Apesar das emissões de RF do Nebulizador INALOVIDA se restringirem apenas às suas funções internas e próprias do equipamento a sua instalação necessita de atenção e cuidados especiais no que se refere à Compatibilidade Eletromagnética conforme as informações contidas na seção de advertências deste manual e também nas tabelas abaixo.

Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões eletromagnéticas		
O Nebulizador INALOVIDA é destinado para utilização no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Recomenda-se que o cliente ou usuário do Equipamento garanta que este seja utilizado em tal ambiente.		
Ensaio de Emissões	Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Diretrizes
Emissões de RF ABNT NBR IEC CISPR11	Grupo 1	O Nebulizador INALOVIDA utiliza energia de RF apenas para suas funções internas. No entanto, suas emissões de RF são muito baixas e não é provável que causem qualquer interferência em equipamentos eletrônicos próximos
Emissões de RF ABNT NBR IEC CISPR11	Classe A	Os Nebulizadores INALOVIDA são adequados para utilização em todos os estabelecimentos, inclusive estabelecimentos residenciais e aqueles diretamente conectados à rede pública de distribuição de energia elétrica de baixa tensão que alimenta edificações para utilização doméstica.
Emissões de harmônicos IEC 61000-3-2	Classe A	
Emissões devido à flutuação de tensão / cintilação. IEC 61000-3-3	Conforme	
Nota: O Nebulizador INALOVIDA não deve ser utilizado muito próximo ou empilhado sobre outros equipamentos eletroeletrônicos. Caso isso seja necessário recomenda-se que o Nebulizador INALOVIDA seja observado para verificar sua operação normal.		



ATENÇÃO: As características de emissões deste equipamento o tornam adequado para uso em áreas indústrias e hospitais (ABNT NBR IEC/CISPR 11 classe A). Se for utilizado em um ambiente residencial (para o qual normalmente é requerida a ABNT NBR IEC/CISPR 11 classe B), este equipamento pode não oferecer proteção adequada a serviços de comunicação por radiofrequência. O usuário pode precisar tomar medidas de mitigação, como realocar ou reorientar o equipamento.

Diretrizes e declaração do fabricante – Imunidade Eletromagnética			
O Nebulizador INALOVIDA é destinado para utilização no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Recomenda-se que o cliente ou usuário do Equipamento garanta que este seja utilizado em tal ambiente.			
Ensaio de Imunidade	Nível de Ensaio da ABNT NBR IEC CISPR11	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético Diretrizes
Descarga Eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	$\pm 8\text{KV}$ contato direto $\pm 2\text{KV}$, $\pm 4\text{KV}$, $\pm 8\text{KV}$, $\pm 15\text{KV}$ pelo ar	$\pm 8\text{KV}$ contato direto $\pm 2\text{KV}$, $\pm 4\text{KV}$, $\pm 8\text{KV}$, $\pm 15\text{KV}$ pelo ar	Pisos deveriam ser de madeira, concreto ou cerâmico, se os pisos forem cobertos com material sintético, a umidade relativa deveria ser pelo menos 30%.
Transitórios elétricos rápidos trem de pulsos ("Burst") IEC 61000-4-4	$\pm 2\text{ kV}$ / 100 kHz alimentação $\pm 1\text{ kV}$ / 100 kHz comunicação	$\pm 2\text{ kV}$ / 100 kHz alimentação $\pm 1\text{ kV}$ / 100 kHz comunicação	Qualidade de fornecimento de energia deveria ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico.
Surtos IEC 61000-4-5	$\pm 0,5\text{ kV}$, $\pm 1\text{ kV}$ Linha à linha $\pm 0,5\text{ kV}$, $\pm 1\text{ kV}$, $\pm 2\text{ kV}$ Linha à terra Ângulos: 0° , 90° , 180° e 270°	$\pm 0,5\text{ kV}$, $\pm 1\text{ kV}$ Linha à linha $\pm 0,5\text{ kV}$, $\pm 1\text{ kV}$, $\pm 2\text{ kV}$ Linha à terra Ângulos: 0° , 90° , 180° e 270°	Qualidade de fornecimento de energia deveria ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico.
Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão nas linhas de entrada de alimentação IEC 61000-4-11	Quedas de tensão: 100% (0% UT) por 0,5 ciclo nos ângulos de 0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° e 315° 100% (0% UT) por 1 ciclo (monofásico: a 0°) 30% (70% UT) por 25/30 ciclos (monofásico: a 0°) Interrupções de tensão: 100% (0% UT) por 250/300 ciclos	Quedas de tensão: 100% (0% UT) por 0,5 ciclo nos ângulos de 0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° e 315° 100% (0% UT) por 1 ciclo (monofásico: a 0°) 30% (70% UT) por 25/30 ciclos (monofásico: a 0°) Interrupções de tensão: 100% (0% UT) por 250/300 ciclos	Qualidade de fornecimento de energia deveria ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico. Se o usuário do Nebulizador INALOVIDA exige operação continuada durante interrupção de energia, é recomendado que o Nebulizador INALOVIDA seja alimentado por uma fonte de alimentação ininterrupta ou uma bateria.
Campo magnético na frequência de alimentação (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz ou 60 Hz	30 A/m 50 Hz ou 60 Hz	Campos magnéticos na frequência da alimentação deveriam estar em níveis característicos de um local típico em um ambiente hospitalar ou comercial típico.
NOTA Ut é a tensão de alimentação c.a, antes da aplicação do nível de ensaio.			

Diretrizes e declaração do fabricante – Imunidade Eletromagnética			
O Nebulizador INALOVIDA é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. Recomenda-se que o cliente ou usuário do Equipamento garanta que este seja utilizado em tal ambiente.			
Ensaio de Imunidade	Nível de Ensaio da ABNT NBR IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético Diretrizes
RF Conduzida IEC 61000-4-6	3Vrms na faixa de 6 Vrms nas bandas ISM e de radioamador entre 0,15 e 80 MHz (ambiente doméstico e instalações de saúde)	[3]Vrms	Equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel não deveriam ser usados próximos a qualquer parte do Nebulizador INALOVIDA incluindo cabos, com distância de separação menor que a recomendada, calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de Separação Recomendada $d = [1,17] \sqrt{P}$ $d = [1,17] \sqrt{P}$ 80MHz até 800MHz $d = [2,33] \sqrt{P}$ 800MHz até 2,7GHz
RF Radiada IEC 61000-4-3	10 V/m 80 até 2,7 GHz	[10]V/m	Onde P é a potência máxima nominal de saída do transmissor em Watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, d é a distância de separação recomendada em metro(m). Recomenda-se que a intensidade de campo estabelecida pelo transmissor de RF, como determinada através de uma inspeção eletromagnética no local, seja menor que o nível de conformidade em cada faixa de frequência. Pode ocorrer interferência ao redor do equipamento com o seguinte símbolo. 
Nota 1 Em 80MHz a 800MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta. Nota 2. Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estações de rádio base, telefone (celular/sem fio), rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstos teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, recomenda-se uma inspeção eletromagnética do local. Se a medida da intensidade de campo no local em que o Nebulizador INALOVIDA é usado excede o nível de conformidade utilizado acima, recomenda-se que o Nebulizador INALOVIDA seja observado para verificar se a operação está normal. Se um desempenho anormal for observado, procedimentos adicionais podem ser necessários, tais como a reorientação ou recolocação do Nebulizador INALOVIDA. Acima da faixa de frequência de 150KHz até 80MHz, recomenda-se que a intensidade do campo seja menor que 3V/m			

Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o Nebulizador INALOVIDA			
O Nebulizador INALOVIDA é destinado para utilização em ambiente eletromagnético no qual as perturbações de RF radiadas são controladas. O cliente ou usuário do equipamento pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação de RF (transmissores) portáteis e móveis e o Nebulizador INALOVIDA como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de comunicação.			
Potência Máxima nominal de saída do Transmissor W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor M		
	150 KHz até 80 MHz $d = 1,17 \sqrt{P}$	80 MHz até 800 MHz $d = 1,17 \sqrt{P}$	800 MHz até 2,7 GHz $d = 2,33 \sqrt{P}$
0,01	0,117	0,117	0,233
0,1	0,37	0,37	0,737
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,7	11,7	23,3
Para transmissores com uma potência máxima nominal de saída não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m), pode ser determinada utilizando a equação aplicável para a frequência do transmissor, onde P é a potência máxima nominal de saída do transmissor em Watts (w) de acordo com o fabricante do transmissor.			
Nota 1. Em 80 MHz a 800MHz aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais alta.			
Nota 2. Nas bandas de frequência ISM (industrial, médica e científica) entre 150KHz e 80MHz estão 6,765MHz até 6,675MHz; 13,553MHz até 13,567MHz; 26,957MHz até 27,283MHz e 40,66MHz até 40,70MHz.			
Nota 3. Um fator adicional de 10/3 é usado no cálculo da distância de separação recomendada para transmissores nas bandas de frequência ISM entre 150KHz e 80MHz e na faixa de frequência 80MHz até 2,7GHz para reduzir a probabilidade de interferência que os equipamentos de comunicação móveis/portáteis poderiam causar se levados inadvertidamente para áreas de pacientes.			
Nota 4. Essas diretrizes podem não ser aplicadas em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			

IMUNIDADE RADIADA A CAMPO PRÓXIMO

Band a [MHz]	Freq. ensaio [MHz]	Serviço	Modulação	Nível de ensaio [V/m]
380 a 390	385	TETRA 400	Pulse, 18 Hz	27
430 a 470	450	GMRS 460, FRS 460	FM, 1 kHz, Desvio de ± 5 kHz	28
704 a 787	710 745 780	Banda LTE 13, 17	Pulse, 217 Hz	9
800 a 960	810 870 930	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, Banda LTE 5	Pulse, 18 Hz	28
1.700 a 1.990	1.720 1.845 1.970	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, Banda LTE 1, 3, 4, 25, UMTS	Pulse, 217 Hz	28
2.400 a 2.570	2.450	Bluetooth, WLAN, 802.11 g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Pulse, 217 Hz	28
5.100 a 5.800	5.240 5.500 5.785	WLAN 802.11 a/n	Pulse, 217 Hz	9

*1 – As frequências e serviços listados na Tabela 9 (acima transcrita) são exemplos representativos baseados em equipamentos de comunicação por RF em uso nos dias da publicação desta Norma. A especificação de ensaio não tem a pretensão de cobrir todas as frequências e serviços utilizados em todos os países. Convém que o PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS leve em conta serviços de comunicações atuais. Convém que os ensaios sejam realizados nas frequências adicionais identificadas que não estejam representadas na Tabela 9

TERMO DE GARANTIA

1. A MRM oferecerá assistência técnica gratuita, no equipamento especificado abaixo, pelo prazo de 24 meses a partir da data da aquisição.
2. A gratuidade não inclui o transporte do equipamento, que deverá ser realizado pelo COMPRADOR até o estabelecimento da MRM, onde este oferecerá a assistência técnica gratuita.
3. Será reparado gratuitamente, no prazo estipulado acima, nos seguintes casos:
 - a) Defeitos de fabricação;
 - b) Danos ocorridos no produto, apesar do uso correto do equipamento;
4. Esta garantia perde a validade nos seguintes casos:
 - a) Uso inadequado do equipamento;
 - b) Danos por acidentes (queda) ou condições anormais de operação e manuseio;
 - c) Instalações elétricas deficientes;
 - d) Ligação do equipamento em rede elétrica inadequada;
 - e) Desgaste natural;
 - f) Estocagem incorreta, influência do ambiente (umidade, calor, etc.);
 - g) Agentes da natureza (raios, inundações, etc.)
 - h) Constatação de adulteração no número de série de identificação do produto;
 - i) Equipamento violado por técnicos não autorizados.
5. Serviços de Reparação:
 - a) Os serviços de reparação serão efetuados somente na MRM;
 - b) Dentro do período de Garantia, as peças ou componentes que, comprovadamente, apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente pela MRM.

6. No caso de dano irreparável ocorrido no equipamento, a MRM substituirá o equipamento vendido, se tal ocorrência for verificada por técnico autorizado pela empresa, e se estiver dentro do prazo de garantia.



ATENÇÃO!

A garantia só será válida mediante a apresentação deste Termo de Garantia devidamente preenchido, recorte-o se necessário, juntamente com a nota fiscal.



MRM HOSPITALAR LTDA

Rua Araruama Quadra 56 Lote 26 Sala 01 / Vila Alzira

Aparecida de Goiânia - Go

CNPJ: 20.920.517/0001-06

SAC: 62 3549 8054

www.mrmhospitalar.com.br

----- Recorte aqui ----- 

Termo de Garantia	
Nome:	
Endereço:	Cidade:
Estado:	Fone:
Nota Fiscal nº:	Número Série:
Equipamento: <i>ASPIRAVIDA</i>	Modelo:
ASSINATURA DO CLIENTE	



LINHA MEDICA HOSPITALAR



NEBULIZADOR HOSPITALAR ELETRICO INALOVIDA

DESCRIÇÃO

- ✓ Nebulização Elétrico Móvel portátil.
- ✓ Para utilização médica, domiciliar e laboratorial .
- ✓ Motor a pistão e isento de óleo.
- ✓ Baixo consumo de energia protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica.
- ✓ Silencioso e potente, baixo ruído de operação.
- ✓ Fluxômetro para controle de nevoa .
- ✓ Régua com válvula de impacto.
- ✓ Carenagem plástica de alta resistência.
- ✓ Silencioso e potente.
- ✓ Alça móvel e integrada na parte superior para transporte.
- ✓ Estrutura Do Conjunto Construída Em Aço carbono,
- ✓ Time digital
- ✓ Acionamento através do botão liga e desliga gangorra.
- ✓ Carro pedestal com rodízios com 4 ou 5 rodízios.
- ✓ Kit nebulização adulto ou infantil conexão universal oxigênio.
- ✓ Alguns itens são opcionais.



NEBULIZADOR ELÉTRICO LINHA MRM200



FOTO ILUSTRATIVA

Aparelho de Nebulização 1 saídas. Portátil com suporte para mascarar em aço carbono em pintura eletrostática, 1 kits de nebulização, compressor isento de óleo, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt e vazão de 30 a 70 l/min.

MODELO: MRM-200

MARCA: ASPIRAVIDA

PRODUTO: NACIONAL

GARANTIA: 2 ANOS

REGISTRO ANVISA: 81293579002

OPCIONAL



FLUXÔMETRO



KIT ADULTO



KIT INFANTIL



TIME DIGITAL



NEBULIZADOR ELÉTRICO LINHA MRM200



FOTO ILUSTRATIVA

Aparelho de Nebulização 2 saídas. Portátil com suporte para mascarar em aço carbono em pintura eletrostática, 2 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt e vazão de 30 a 70 l/min.

MODELO: MRM-200

MARCA: ASPIRAVIDA

PRODUTO: NACIONAL

GARANTIA: 2 ANOS

REGISTRO ANVISA: 81293579002

OPCIONAL



FLUXÔMETRO



KIT ADULTO



KIT INFANTIL



TIME DIGITAL



NEBULIZADOR ELÉTRICO LINHA MRM200



FOTO ILUSTRATIVA

Aparelho de Nebulização 3 saídas. Portátil com suporte para mascarar em aço carbono em pintura eletrostática, 3 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt e vazão de 30 a 70 l/min.

MODELO: MRM-200

MARCA: ASPIRAVIDA

PRODUTO: NACIONAL

GARANTIA: 2 ANOS

REGISTRO ANVISA: 81293579002

OPCIONAL



FLUXÔMETRO



KIT ADULTO



KIT INFANTIL



TIME DIGITAL



NEBULIZADOR ELÉTRICO LINHA MRM200



FOTO ILUSTRATIVA

Aparelho de Nebulização 4 saídas. Portátil com suporte para mascarar em aço carbono em pintura eletrostática, 4 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt e vazão de 30 a 70 l/min.

MODELO: MRM-200

MARCA: ASPIRAVIDA

PRODUTO: NACIONAL

GARANTIA: 2 ANOS

REGISTRO ANVISA: 81293579002

OPCIONAL



FLUXÔMETRO



KIT ADULTO



KIT INFANTIL



TIME DIGITAL



HOSPITALAR LTDA

NEBULIZADOR ELÉTRICO LINHA MRM200



FOTO ILUSTRATIVA

Aparelho de Nebulização 5 saídas. Portátil com suporte para mascarar em aço carbono em pintura eletrostática, 5 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt e vazão de 30 a 70 l/min.

MODELO: MRM-200

MARCA: ASPIRAVIDA

PRODUTO: NACIONAL

GARANTIA: 2 ANOS

REGISTRO ANVISA: 81293579002

OPCIONAL



FLUXÔMETRO



KIT ADULTO



KIT INFANTIL



TIME DIGITAL



NEBULIZADOR ELÉTRICO LINHA MRM200



FOTO ILUSTRATIVA

Aparelho de Nebulização 6 saídas. Portátil com suporte para mascarar em aço carbono em pintura eletrostática, 6 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt e vazão de 30 a 70 l/min.

MODELO: MRM-200

MARCA: ASPIRAVIDA

PRODUTO: NACIONAL

GARANTIA: 2 ANOS

REGISTRO ANVISA: 81293579002

OPCIONAL



FLUXÔMETRO



KIT ADULTO



KIT INFANTIL



TIME DIGITAL



HOSPITALAR LTDA

NEBULIZADOR ELÉTRICO LINHA MRM200



FOTO ILUSTRATIVA

Aparelho de Nebulização 1 saída. Com carro suporte em pintura eletrostática e rodizio 3 pol. Todos com freio, suporte para mascara, 1 kits de nebulização, compressor isento de óleo, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt e vazão de 30 a 70 l/min.

MODELO: MRM-200C

MARCA: ASPIRAVIDA

PRODUTO: NACIONAL

GARANTIA: 2 ANOS

REGISTRO ANVISA: 81293579002

OPCIONAL



FLUXÔMETRO



KIT ADULTO



KIT INFANTIL



TIME DIGITAL



HOSPITALAR LTDA

NEBULIZADOR ELÉTRICO LINHA MRM200



FOTO ILUSTRATIVA

Aparelho de Nebulização 2 saídas. Com carro suporte em pintura eletrostática e rodizio 3 pol. Todos com freio, suporte para mascara, 2 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt e vazão de 30 a 70 l/min.

MODELO: MRM-200C

MARCA: ASPIRAVIDA

PRODUTO: NACIONAL

GARANTIA: 2 ANOS

REGISTRO ANVISA: 81293579002

OPCIONAL



FLUXÔMETRO



KIT ADULTO



KIT INFANTIL



TIME DIGITAL



HOSPITALAR LTDA

NEBULIZADOR ELÉTRICO LINHA MRM200



FOTO ILUSTRATIVA

Aparelho de Nebulização 3 saídas. Com carro suporte em pintura eletrostática e rodízio 3 pol. Todos com freio, suporte para máscara, 3 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt e vazão de 30 a 70 l/min.

MODELO: MRM-200C

MARCA: ASPIRAVIDA

PRODUTO: NACIONAL

GARANTIA: 2 ANOS

REGISTRO ANVISA: 81293579002

OPCIONAL



FLUXÔMETRO



KIT ADULTO



KIT INFANTIL



TIME DIGITAL



HOSPITALAR LTDA

NEBULIZADOR ELÉTRICO LINHA MRM200



FOTO ILUSTRATIVA

Aparelho de Nebulização 4 saídas. Com carro suporte em pintura eletrostática e rodizio 3 pol. Todos com freio, suporte para mascara, 4 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt e vazão de 30 a 70 l/min.

MODELO: MRM-200C

MARCA: ASPIRAVIDA

PRODUTO: NACIONAL

GARANTIA: 2 ANOS

REGISTRO ANVISA: 81293579002

OPCIONAL



FLUXÔMETRO



KIT ADULTO



KIT INFANTIL



TIME DIGITAL



HOSPITALAR LTDA

NEBULIZADOR ELÉTRICO LINHA MRM200



FOTO ILUSTRATIVA

Aparelho de Nebulização 5 saídas. Com carro suporte em pintura eletrostática e rodizio 3 pol. Todos com freio, suporte para mascara, 5 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt e vazão de 30 a 70 l/min.

MODELO: MRM-200C

MARCA: ASPIRAVIDA

PRODUTO: NACIONAL

GARANTIA: 2 ANOS

REGISTRO ANVISA: 81293579002

OPCIONAL



FLUXÔMETRO



KIT ADULTO



KIT INFANTIL



TIME DIGITAL



HOSPITALAR LTDA

NEBULIZADOR ELÉTRICO LINHA MRM200



FOTO ILUSTRATIVA

Aparelho de Nebulização 6 saídas. Com carro suporte em pintura eletrostática e rodízio 3 pol. Todos com freio, suporte para máscara, 5 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt e vazão de 30 a 70 l/min.

MODELO: MRM-200C

MARCA: ASPIRAVIDA

PRODUTO: NACIONAL

GARANTIA: 2 ANOS

REGISTRO ANVISA: 81293579002

OPCIONAL



FLUXÔMETRO



KIT ADULTO



KIT INFANTIL



TIME DIGITAL



HOSPITALAR LTDA



HOSPITALAR LTDA.

62 98112-4796

Vendas3@mrmhospitalar.com.br

www.mrmhospitalar.com.br

CNPJ: 20.920.517/000-06 I.E: 106100831



Rua Araruama Qd.56 Lt.26 Sala.01 Vila Alzira / Ap. De Goiânia CEP: 74913190

BRASIL

INMETRO

----- Site do Inmetro -----

Sites de Interesse Mapa do Site Ouvidoria Fale com o Inmetro

Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

volta

Certificados

topo

Resultado da Consulta:

4 Certificado(s)

10 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **QC** N° Certificado: **QC-0804-20** Tipo: **Produto** Emissão: **21/08/2020** Validade: **21/08/2030** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07760277000161	MEDMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES EIRELI ME		AVENIDA CAUAXI, 293 - SL. 1108 - ALPHAVILLE CENTRO - BARUERI, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MEDMAX	EC1200G	SIM	ELETROCARDIOGRAFO		
MEDMAX	ECG100G	SIM	ELETROCARDIOGRAFO/100- 240VC.A., 50-60 HZ, 150 VA /CLASSE I /IPX0/CONTÍNUA /CF		
MEDMAX	ECG1212G	SIM	ELETROCARDIOGRAFO/100- 240VC.A., 50-60 HZ, 150 VA /CLASSE I /IPX0/CONTÍNUA /CF		
MEDMAX	ECG300G	SIM	ELETROCARDIOGRAFO/100- 240VC.A., 50-60 HZ, 150 VA /CLASSE I /IPX0/CONTÍNUA /CF		
MEDMAX	ECG300GT	SIM	ELETROCARDIOGRAFO/100- 240VC.A., 50-60 HZ, 150 VA /CLASSE I /IPX0/CONTÍNUA /CF		
MEDMAX	ECG600G	SIM	ELETROCARDIOGRAFO/100- 240VC.A., 50-60 HZ, 150 VA /CLASSE I /IPX0/CONTÍNUA /CF		

Certificador: **QC** N° Certificado: **QC-6305-22.01** Tipo: **Produto** Emissão: **24/08/2022** Validade: **24/08/2030** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07760277000161	MEDMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES EIRELI ME		AVENIDA CAUAXI, 293 - SL. 1108 - ALPHAVILLE CENTRO - BARUERI, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CONTEC	SP750	SIM	BOMBA DE INFUSÃO/110-240 V.C.A., 50/60HZ, 25VA/CLASSE I/IPX2/CONTÍNUA/TIPO BF		

Certificador: **QC** N° Certificado: **QC-6305-22.02** Tipo: **Produto** Emissão: **29/08/2022** Validade: **29/08/2030** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07760277000161	MEDMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES EIRELI ME		AVENIDA CAUAXI, 293 - SL. 1108 - ALPHAVILLE CENTRO - BARUERI, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CONTEC	CONTEC10C	SIM	DOPPLER FETAL DE BOLSO/4,5 V.C.C., (3X PILHA AA)/ALIMENTADO INTERNAMENTE/IP22/CONTÍNUO/TIPO CF		
CONTEC	CONTEC10CL	SIM	DOPPLER FETAL DE BOLSO/5V.C.C., 1A, - 3,7VC.C (BATERIA)/ALIMENTADO INTERNAMENTE/IP22/CONTÍNUO/TIPO CF		

Certificador: **QC** N° Certificado: **QC-6305-22.03** Tipo: **Produto** Emissão: **29/08/2022** Validade: **29/08/2030** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07760277000161	MEDMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES EIRELI ME		AVENIDA CAUAXI, 293 - SL. 1108 - ALPHAVILLE CENTRO - BARUERI, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CONTEC	SP80B	SIM	ESPIRÔMETRO/100-240 V.C.A., 50/60HZ, 0,15A/5V.C.C.; 1ª - 3,7VC.C. (BATERIA)/CLASSE II/IP22/CONTÍNUA/TIPO BF		



Nova Pesquisa
Certificados | **Produtos** | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

----- Site do Inmetro -----

Sites de Interesse Mapa do Site Ouvidoria Fale com o Inmetro

Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

volto

topo

Certificados

Resultado da Consulta:

33 Certificado(s)

54 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **ICEPEX** N° Certificado: [CE-LVL/ICEPEX-I 00141-23-1](#) Tipo: **Produto** Emissão: **15/01/2020** Validade: **15/01/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G, - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: G - NAO ESTERIL - COM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BO	SIM	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: G - NAO ESTERIL - COM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BORRACHA NATURAL - COR NATURAL - MARCA: G-TECH		
G-TECH	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: GG - NAO ESTERIL - COM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - B	SIM	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: GG - NAO ESTERIL - COM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BORRACHA NATURAL - COR NATURAL - MARCA: G-TECH		
G-TECH	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: M - NAO ESTERIL - COM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BO	SIM	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: M - NAO ESTERIL - COM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BORRACHA NATURAL - COR NATURAL - MARCA: G-TECH		
G-TECH	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: P - NAO ESTERIL - COM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BO	SIM	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: P - NAO ESTERIL - COM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BORRACHA NATURAL - COR NATURAL - MARCA: G-TECH		
G-TECH	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: PP - NAO ESTERIL - COM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - B	SIM	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: PP - NAO ESTERIL - COM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BORRACHA NATURAL - COR NATURAL - MARCA: G-TECH		

Certificador: **ICEPEX** N° Certificado: [CE-LVL/ICEPEX-I 00141-23-2](#) Tipo: **Produto** Emissão: **15/01/2020** Validade: **15/01/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G, - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: G - NAO ESTERIL - SEM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BO	SIM	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: G - NAO ESTERIL - SEM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BORRACHA NATURAL - COR NATURAL - MARCA: G-TECH		
G-TECH	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: GG - NAO ESTERIL - SEM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - B	SIM	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: GG - NAO ESTERIL - SEM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BORRACHA NATURAL - COR NATURAL - MARCA: G-TECH		
G-TECH	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: M - NAO ESTERIL - SEM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BO	SIM	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: M - NAO ESTERIL - SEM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BORRACHA NATURAL - COR NATURAL - MARCA: G-TECH		
G-TECH	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: P - NAO ESTERIL - SEM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BO	SIM	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: P - NAO ESTERIL - SEM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BORRACHA NATURAL - COR NATURAL - MARCA: G-TECH		
G-TECH	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: PP - NAO ESTERIL - SEM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - B	SIM	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO: PP - NAO ESTERIL - SEM PO - TIPO 1- LISA - AMBIDESTRA - BORRACHA NATURAL - COR NATURAL - MARCA: G-TECH		

Certificador: **SGS** N° Certificado: [BRA19/00322](#) Tipo: **Produto** Emissão: **22/02/2019** Validade: **22/02/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
G-TECH	OLED GRAPH 2	SIM	OXÍMETRO DE PULSO, OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO; 3V (2 PILHAS AAA), EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE, IP22, PARTE APLICADA TIPO BF E MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUA; MODELO DO FABRICANTE: MD300C26	
G-TECH	OLED GRAPH PEDIÁTRICO	SIM	OXÍMETRO DE PULSO, OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO; 3V (2 PILHAS AAA), EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE, IP22, PARTE APLICADA TIPO BF E MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUA; MODELO DO FABRICANTE: MD300C5	

Certificador: **SGS** Nº Certificado: [BRA19/00761](#) Tipo: **Produto** Emissão: **17/04/2019** Validade: **17/04/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	FR1DZ1	SIM	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO; 3V (2X PILHAS AAA); EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE; IP22; PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO		

Certificador: **SGS** Nº Certificado: [BRA19/02029](#) Tipo: **Produto** Emissão: **02/10/2019** Validade: **02/10/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	COMPACT	SIM	ALIMENTAÇÃO INTERNA BATERIA: 2 X 1,5V TAMANHO AA; IP22; PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: RSS1002-015030-W2B; ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR AC/DC: 100-240VAC 50/60HZ 0,2A; SAÍDA: 3VDC, 0,5A; CLASSE II		

Certificador: **SGS** Nº Certificado: [BRA20/00589](#) Tipo: **Produto** Emissão: **17/04/2020** Validade: **17/04/2026** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	ALLERGY FREE DUAL: ULTRA-SONICO	SIM	100-240V; 50/60HZ; CLASSE II; 25W004		
G-TECH	ALLERGY FREE FILTER 2: ULTRA-SONICO	SIM	100-240V; 50/60HZ; CLASSE II; 25W004		
G-TECH	ALLERGY FREE TIMER: ULTRA-SONICO	SIM	100-240V; 50/60HZ; CLASSE II; 25W004		

Certificador: **SGS** Nº Certificado: [BRA20/00669](#) Tipo: **Produto** Emissão: **01/05/2020** Validade: **01/05/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	SMART LIGHT (REF. COM.: XB-8712)	SIM	ENTRADA: 100 – 240V, 50/60HZ, 0,4A; SAÍDA: 6V, 1A / CLASSE II / IP22 / CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: PARTE APLICADA TIPO BF / MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUA		

Certificador: **SGS** Nº Certificado: [BRA20/00681](#) Tipo: **Produto** Emissão: **01/05/2020** Validade: **01/05/2050** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		

G-TECH	SMART LCD (REF. COM.: XB-8722)	SIM	ENTRADA: 100 – 240V, 50/60HZ, 0,4A; SAÍDA: 6V, 1A / CLASSE II / IP22 / CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: PARTE APLICADA TIPO BF / MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUA
--------	--------------------------------	-----	---

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA20/00955](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [18/06/2020](#) **Validade:** [18/06/2025](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	BP3BK1-3	SIM	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO; 3V (2 PILHAS AAA); EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE; IP22; PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO.		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA20/01344](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [28/08/2020](#) **Validade:** [28/08/2025](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	NEBMESH2. REF. COMERCIAL: HL100K	SIM	NEBULIZADOR DE REDE VIBRATÓRIA; 3V (2 PILHAS AA) OU 5V 1,0A CABO USB; EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE; IP22; PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA20/01500](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/10/2020](#) **Validade:** [02/10/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	ALLERGY FREE HM 3L	SIM	100-240V; 25W; 50-60HZ; CLASSE II003		
G-TECH	ALLERGY FREE HR 3L	SIM	100-240V; 25W; 50-60HZ; CLASSE II003		
G-TECH	BABY 2	SIM	100-240V; 25W; 50-60HZ; CLASSE II003		
G-TECH	DUAL 2	SIM	100-240V; 25W; 50-60HZ; CLASSE II003		
G-TECH	FILTER 3	SIM	100-240V; 25W; 50-60HZ; CLASSE II003		
G-TECH	TIMER 2	SIM	100-240V; 25W; 50-60HZ; CLASSE II003		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA20/01515](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [08/10/2020](#) **Validade:** [08/10/2025](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	MA100	SIM	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO, 100-240 VA.C., 50/60HZ, 0,3 A, CLASSE II, IP20, OPERAÇÃO CONTÍNUA, PARTE APLICADA TIPO BF, ALIMENTAÇÃO INTERNA: 6VD.C. (4 PILHAS AA), 0,6 A		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA20/01580](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [19/10/2020](#) **Validade:** [19/10/2025](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	LED. MD300C19.	SIM	EQUIPAMENTO MÉDICO; EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE, 3 VD.C. (2 PILHAS AAA), 600 MAH, IP22, PARTE APLICADA TIPO BF, OPERAÇÃO CONTÍNUA		
G-TECH	OLED GRAPH. MD300C23.	SIM	EQUIPAMENTO MÉDICO; EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE, 3 VD.C.		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA20/01622](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [26/10/2020](#) **Validade:** [26/10/2025](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
PREMIUM	LP200	SIM	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL PREMIUM; 3V (2 PILHAS AAA); EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE; IP22; PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO; REF. COMERCIAL HL168ZA		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA20/01630](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [26/10/2020](#) **Validade:** [26/10/2025](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	LA250. REF. COM.: HL868ZA.	SIM	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL; 6VC.C. (4 PILHAS AAA); OPERAÇÃO CONTÍNUA; PARTE APLICADA TIPO BF; IP22		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA21/00013](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [07/01/2021](#) **Validade:** [07/01/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	G-TECH. REF. COM.: JPD-100S	SIM	MONITOR PRENATAL DE BATIMENTOS CARDÍACOS; ALIMENTAÇÃO INTERNA: 9V; IP22; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO; PARTE APLICADA TIPO BF (A PROVA DE DESFIBRILAÇÃO)		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA21/00585](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [15/04/2021](#) **Validade:** [15/04/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	GP400. REF. COM.: HL158AU	SIM	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO; TENSÃO: 3V (2 PILHAS AAA); EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE; GRAU DE PROTEÇÃO IP: IP22; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO		
G-TECH	GP450SP. REF. COM.: HL158AU-D	SIM	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO; TENSÃO: 3V (2 PILHAS AAA); EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE; GRAU DE PROTEÇÃO IP: IP22; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO		
G-TECH	GP480BT. REF. COM.: HL158AU-BD	SIM	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO; TENSÃO: 3V (2 PILHAS AAA); EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE; GRAU DE PROTEÇÃO IP: IP22; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA21/00587](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [15/04/2021](#) **Validade:** [15/04/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH E PANNEL	GP200. REF. COM.: HL158OA	SIM	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL; TENSÃO: 3V (2 PILHAS AAA); EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE; GRAU DE PROTEÇÃO		

IP: IP22; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO

APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL G-TECH, REF.: HL158PA, 3 VD.C. (2 PILHAS AAA), OPERAÇÃO CONTÍNUA, PARTE APLICADA TIPO BF, IP22, EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE

Certificador: **SGS** **Nº Certificado:** [BRA21/00694](#) **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2021** **Validade:** **02/05/2026** **Status do Certificado:** **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G, - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	LA800. REF. COMERCIAL: HL858A1	SIM	6V (4 PILHAS AAA); EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE OU CABO USB (CLASSE II); IP22; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO		
G-TECH	LA850BT. REF. COMERCIAL: HL858A1-B	SIM	6V (4 PILHAS AAA); EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE OU CABO USB (CLASSE II); IP22; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO		

Certificador: **SGS** **Nº Certificado:** [BRA21/00736](#) **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **11/05/2021** **Validade:** **11/05/2026** **Status do Certificado:** **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G, - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
PREMIUM	THPRSC1. REF. COMERCIAL: T81	SIM	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO: 3V (2 PILHAS 1,5V AA), INTERNAMENTE ENERGIZADO, IP22, PARTE APLICADA TIPO BF, MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO.		

Certificador: **SGS** **Nº Certificado:** [BRA21/01060](#) **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **23/07/2021** **Validade:** **23/07/2026** **Status do Certificado:** **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G, - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	BP3MZ1. REF. COM.: WATCH BP O3	SIM	APARELHO DE MONITORAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL G-TECH; 6V (4 X 1,5V PILHAS AAA); IP21; PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO; EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE.		

Certificador: **SGS** **Nº Certificado:** [BRA21/01441](#) **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **30/09/2021** **Validade:** **30/09/2026** **Status do Certificado:** **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G, - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	SMART. REF. COMERCIAL: HL-0637II	SIM	BOMBA TIRA LEITE AUTOMÁTICA; ADAPTADOR AC/DC: 100-240V 50/60HZ 0,2A, SAÍDA: 5VC.C. 1A; CLASSE II; IP22; PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO		

Certificador: **SGS** **Nº Certificado:** [BRA21/01688](#) **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **08/11/2021** **Validade:** **08/11/2026** **Status do Certificado:** **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G, - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	GO. REF. COMERCIAL: KFT-26.	SIM	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO G-TECH; 3V (BATERIA CR2032); IP22; ENERGIZADO INTERNAMENTE; PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA22/00017](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [07/01/2022](#) **Validade:** [07/01/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	BSP11. REF. COMERCIAL: DBP-1231	SIM	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL; TENSÃO: 6 V (4 PILHAS AAA DE 1,5V CADA); CLASSE DE ISOLAÇÃO: EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE; GRAU DE PROTEÇÃO IP: IP20; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO		
PANVEL	BSP11. REF. COMERCIAL: DBP-1231	SIM	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL; TENSÃO: 6 V (4 PILHAS AAA DE 1,5V CADA); CLASSE DE ISOLAÇÃO: EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE; GRAU DE PROTEÇÃO IP: IP20; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA22/00018](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [07/01/2022](#) **Validade:** [07/01/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
PREMIUM	BSP21. REF. COMERCIAL: DBP-2141	SIM	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL PREMIUM; TENSÃO: 3 V (2 PILHAS AAA DE 1,5V CADA); CLASSE DE ISOLAÇÃO: EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE; GRAU DE PROTEÇÃO IP: IP22; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: PARTE APLICADA TIPO BF; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA22/00710](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/06/2022](#) **Validade:** [30/06/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JKH HEALTH CO., LTD.	JKH HEALTH CO., LTD.	4-5F, BUILDING 12, HENGMINZHU INDUSTRIAL PARK,, - XINQIAO TO - - SHENZHEN, - CHINA	ATIVO	FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA22/01031](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [04/10/2022](#) **Validade:** [04/10/2052](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	TH160; TH500	SIM	1,5V (1X BATERIA DE LÍTIO LR41), EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE, IP22, PARTE APLICADA TIPO BF, MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA.		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA22/01294](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [09/12/2022](#) **Validade:** [09/12/2052](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G. - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
G-TECH	NEBMESH3 (REFERENCIA COMERCIAL TL-186)	SIM	TENSÃO 3V (2 X PILHAS AA 1,5V); POTÊNCIA ATIVA 2,5W; EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE; IP22; PARTE APLICADA TIPO BF / MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUA		

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA23/00111](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [03/02/2018](#) **Validade:** [03/02/2048](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G, - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
G-TECH	NEBCOM V (TL-100C); NEBDOG (TL-100D)		SIM	127V/230V; 1,35A/0,8A, 50/60HZ, CLASSE II, IP21, PARTE APLICADA TIPO BF, MODO DE OPERAÇÃO: INTERMITENTE	

Certificador: [SGS](#) N° Certificado: [BRA23/00160](#) Tipo: [Produto](#) Emissão: [14/02/2023](#) Validade: [14/02/2053](#) Status do Certificado: [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALPOES G, - VILA SAO SEBASTIAO - DUQUE DE CAXIAS, RJ - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
G-TECH	ULTRANEB DESK 2		SIM	100-240VA.C., 50/60HZ, 0.6A (RSS1006-180240-W2B-H); 100-240VA.C., 50/60HZ, 0.5A (HNSF240075WP); CLASSE II, IP21, PARTE APLICADA TIPO BF, MODO DE OPERAÇÃO INTERMITENTE	

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de Interesse

Mapa do Site

Ouvidoria

Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados



Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



Resultado da Consulta:
29 Certificado(s)
60 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 18.05544** Tipo: **Produto** Emissão: **19/12/2018** Validade: **03/03/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	UPM50	SIM	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MD - 100-240 V ~ I 50/60 HZ I 4400MAH.		
MD	UPM60	SIM	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MD - 100-240 V ~ I 50/60 HZ I 0.2-0.6A.		
MD	UT100	SIM	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MD - 100-240 V ~ I 47/63 HZ I 2500 MAH.		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 19.05615** Tipo: **Produto** Emissão: **19/02/2019** Validade: **19/02/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
BIONET	CARDIOCARE 2000	SIM	FAMÍLIA DE ELETROCARDÍOGRAFOS I 100 A 240VAC I 50/60HZ I 1.0 A 0.5A, 60W MAX.		
BIONET	CARDIOTOUCH 3000	SIM	FAMÍLIA DE ELETROCARDÍOGRAFOS I 100 A 240VAC I 50/60HZ I 1.0 A 0.5A, 60W MAX.		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 19.05662** Tipo: **Produto** Emissão: **25/03/2019** Validade: **25/03/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	FD-200A	SIM	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD I PILHA: 2AA X 1.5 DC - LR6 I 2 MHZ		
MD	FD-200B	SIM	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD I PILHA: 2AA X 1.5 DC - LR6 I 2 MHZ		
MD	FD-200C	SIM	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD I PILHA: 2AA X 1.5 DC - LR6 / BATERIA: 2 X 1.2V I 2 MHZ		

MD	FD-200D	SIM	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD I PILHA: 2AA X 1.5 DC - LR6 / BATERIA: 2 X 1.2V I 2 MHZ
MD	FD-200E	SIM	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD I PILHA: 2AA X 1.5 DC - LR6 I 2 MHZ
MD	FD-200G	SIM	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD I PILHA: 2AA X 1.5 DC - LR6 I 2 MHZ
MD	FD-200P	SIM	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD I PILHA: 2AA X 1.5 DC - LR6 / BATERIA: 2 X 1.2V I 2 MHZ

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 19.05866** Tipo: **Produto** Emissão: **27/08/2019** Validade: **29/03/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	FS-300	SIM	TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO POR INFRAVERMELHO I TENSÃO: 2 X AAA 1.5V		
MD	FS-700PRO	SIM	TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO POR INFRAVERMELHO I TENSÃO: 2 X AAA 1.5V		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 19.05908** Tipo: **Produto** Emissão: **23/09/2019** Validade: **12/11/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	FD-300 B	SIM	DOPPLER FETAL DE MESA - MD I TENSÃO: DC 3 X 1.2 [V]		
MD	FD-300 C	SIM	DOPPLER FETAL DE MESA - MD I TENSÃO: DC 3 X 1.2 [V]		
MD	FD-300 D	SIM	DOPPLER FETAL DE MESA - MD I TENSÃO: DC 3 X 1.2 [V]		
MD	FD-300 G	SIM	DOPPLER FETAL DE MESA - MD I TENSÃO: DC 3 X 1.2 [V]		
MD	FD-300 I	SIM	DOPPLER FETAL DE MESA - MD I TENSÃO: DC 3 X 1.2 [V]		
MD	FD-300P	SIM	DOPPLER FETAL DE MESA - MD I TENSÃO: DC 3 X 1.2 [V]		



Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 20.06281** Tipo: **Produto** Emissão: **08/05/2020** Validade: **08/05/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
BIONET CO., LTD	CARDIO 7	SIM	ELETROCARDIOGRAFO TENSÃO: 100 V A 240 V / FREQUÊNCIA: 50/60 HZ / CONSUMO: 1,0 A 0,5 A, 60 W MÁX.		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 20.06588** Tipo: **Produto** Emissão: **04/09/2020** Validade: **04/09/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	BM1 XPRO	SIM	MEDIDOR DE SINAIS VITAIS - FONTE 100 ~ 240V I 50/60 HZ I 1,2 A		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 20.06657** Tipo: **Produto** Emissão: **27/10/2020** Validade: **06/01/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	SA110	SIM	OXÍMETRO DE PULSO - 6 VDC I 4 PILHAS ALCALINAS "TIPO AA"		
MD	SA120	SIM	OXÍMETRO DE PULSO - 6 VDC I 4 PILHAS ALCALINAS "TIPO AA"		
MD	SA200	SIM	OXÍMETRO DE PULSO - 6 VDC I 4 PILHAS ALCALINAS "TIPO AA"		
MD	SA210	SIM	OXÍMETRO DE PULSO - 6 VDC I 4 PILHAS ALCALINAS "TIPO AA"		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 20.06658** Tipo: **Produto** Emissão: **27/10/2020** Validade: **06/01/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	SB100	SIM	OXÍMETRO DE PULSO - 3 VDC I 2 PILHAS ALCALINAS "TIPO AAA"		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 20.06663** Tipo: **Produto** Emissão: **28/10/2020** Validade: **13/01/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	SB200	SIM	OXÍMETRO DE PULSO - 3 VDC I 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AAA		
MD	SB210	SIM	OXÍMETRO DE PULSO - 3 VDC I 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AAA		
MD	SB220	SIM	OXÍMETRO DE PULSO - 3 VDC I 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AAA		



Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 21.06781** Tipo: **Produto** Emissão: **26/01/2021** Validade: **08/08/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	MARK II	SIM	OTOSCÓPIO - 2,5 V (2 PILHAS TIPO C)		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 21.06786** Tipo: **Produto** Emissão: **28/01/2021** Validade: **16/08/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	MARK II (PILHA)	SIM	DERMATOSCÓPIO - 2,5 V (2 PILHAS TIPO C)		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 21.06792** Tipo: **Produto** Emissão: **28/01/2021** Validade: **11/08/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	----------

					empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	OFTALMOSCÓPIO MARK II	SIM	OFTALMOSCÓPIO - 2,5 V (2 PILHAS TIPO C)		

Certificador: [NCC](#) **Nº Certificado:** [NCC 21.06806](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [01/02/2021](#) **Validade:** [09/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	VISIO 2000 (LED OU XENON)	SIM	OTOSCÓPIO - 2,5 V (2 PILHAS TIPO C)		

Certificador: [NCC](#) **Nº Certificado:** [NCC 21.06931](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [12/05/2021](#) **Validade:** [02/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	EYESCOPE (WFE-02S)	SIM	OFTALMOSCÓPIO INDIRETO/ RETINÓGRAFO DIGITAL PORTÁTIL - 3,6 V (BATERIA) I 100-240V (FONTE ALIMENTAÇÃO) I 50/60 HZ I 0.3A		
MD	RETINAMAP (WFC-01)	SIM	OFTALMOSCÓPIO INDIRETO/ RETINÓGRAFO DIGITAL PORTÁTIL - 3,6 V (BATERIA) I 100-240V (FONTE ALIMENTAÇÃO) I 50/60 HZ I 0.3A		



Certificador: [NCC](#) **Nº Certificado:** [NCC 21.06942](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [24/05/2021](#) **Validade:** [24/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	SA300	SIM	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - 100-240 VAC (ADAPTADOR) OU 6VDC (PILHAS) I 50/60 HZ I 0,2 A		
MD	SA310	SIM	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - 100-240 VAC (ADAPTADOR) OU 6VDC (PILHAS) I 50/60 HZ I 0,2 A		

Certificador: [NCC](#) **Nº Certificado:** [NCC 21.07004](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [15/07/2021](#) **Validade:** [03/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	MARK III CONVENCIONAL	SIM	LARINGOSCÓPIO - ALIMENTAÇÃO DE 2.5V POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL		

Certificador: [NCC](#) **Nº Certificado:** [NCC 21.07005](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [15/07/2021](#) **Validade:** [09/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA -	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
MD	MARK III FIBRA ÓPTICA	SIM	LARINGOSCÓPIO - ALIMENTAÇÃO DE 2.5 V OU 3.5V (PILHA)

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 21.08759** Tipo: **Produto** Emissão: **05/01/2021** Validade: **08/08/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	VISIO 2000 (BATERIA RECARREGÁVEL)	SIM	OFTALMOSCÓPIO - BATERIA NI-MH RECARREGÁVEL 2.5V / BATERIA NI-MH RECARREGÁVEL 3.5V / BATERIA LI-ION RECARREGÁVEL 2.5V / BATERIA LI-ION RECARREGÁVEL 3.5V I 100 V - 240 V - 50 / 60 HZ		
MD	VISIO 2000 (PILHA)	SIM	OFTALMOSCÓPIO - 2,5 V (2 PILHAS TIPO C)		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 22.07140** Tipo: **Produto** Emissão: **14/04/2022** Validade: **09/05/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	.OMNI	SIM	DERMATOSCÓPIO - 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA (2.5V)		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 22.07158** Tipo: **Produto** Emissão: **19/12/2022** Validade: **19/12/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	VISIO 1500	SIM	OTOSCÓPIO - 2.5 VDC I 3.5 VDC		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 22.09087** Tipo: **Produto** Emissão: **02/02/2022** Validade: **02/02/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	VS2000E	SIM	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA - 100-240 VAC / 50/60 HZ / 60 VA		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 22.09213** Tipo: **Produto** Emissão: **03/05/2022** Validade: **03/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	BT-410A; BT-410F	SIM	FOTÓFORO LED - ADAPTADOR: ENTRADA: AC 100-240 VAC I SAÍDA: DC 4.2V I BATERIA: 3.7 V. I 50/60 HZ I ADAPTADOR: 1000 MA I BATERIA: 2.600 MAH		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 22.09222** Tipo: **Produto** Emissão: **09/05/2022** Validade: **09/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	BT-350	SIM	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - ADAPTADOR: ENTRADA AC I 100~240 V I SAÍDA DC 18V I BATERIA: 14.8V I 50/60 HZ I ADAPTADOR: 2,8 A I BATERIA: 2600 MAH.		
MD	BT-350E	SIM	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - ADAPTADOR: ENTRADA AC I 100~240 V I SAÍDA DC 18V I BATERIA: 14.8V I 50/60 HZ I ADAPTADOR: 2,8 A I BATERIA: 2600 MAH.		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 22.09259** Tipo: **Produto** Emissão: **24/05/2022** Validade: **24/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
BIONET	FC 1400	SIM	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - ENTRADA: AC I 100 - 240V I SAÍDA 18V I BATERIA: 10.8 VDC I 50-60 HZ I ADAPTADOR: 2.8A I BATERIA: 3250 MAH		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 22.09285** Tipo: **Produto** Emissão: **07/06/2022** Validade: **07/06/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	BT220C	SIM	DOPPLER FETAL - 3 V		
MD	BT220L	SIM	DOPPLER FETAL - 3 V		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 22.09379** Tipo: **Produto** Emissão: **29/07/2022** Validade: **29/07/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	DV-350	SIM	100-240 V I 50/60 HZ I 1,1 A		

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 23.07159** Tipo: **Produto** Emissão: **04/01/2023** Validade: **04/01/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MD	CABO CURTO TIPO AA 2.5V	SIM	LARINGOSCÓPIO - DUAS PILHAS AA		
MD	CABO MÉDIO TIPO C 2.5V	SIM	LARINGOSCÓPIO - DUAS PILHAS TIPO C OU BATERIA		

			RECARREGÁVEL 2.5V LI-ION 2200MA
MD	CABO MÉDIO TIPO C 3.5V	SIM	LARINGOSCÓPIO - DUAS PILHAS TIPO C OU BATERIA RECARREGÁVEL 3.5V LI-ION 2200 MA
MD	CABO PEQUENO TIPO AA 2.5V	SIM	LARINGOSCÓPIO - DUAS PILHAS TIPO AA OU BATERIA RECARREGÁVEL 2.5V LI-ION 1000MA
MD	CABO PEQUENO TIPO AA 3.5V	SIM	LARINGOSCÓPIO - DUAS PILHAS TIPO AA OU BATERIA RECARREGÁVEL 3.5V LI-ION 1000 MA

Certificador: **NCC** Nº Certificado: **NCC 23.07162** Tipo: **Produto** Emissão: **03/02/2023** Validade: **03/02/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	MACROSUL	RUA JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - - ATUBA - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
MD		CABO CURTO TIPO AA 2.5V	SIM	LARINGOSCÓPIO - DUAS PILHAS AA	
MD		CABO MÉDIO TIPO C 2.5V	SIM	LARINGOSCÓPIO - DUAS PILHAS TIPO C OU BATERIA RECARREGÁVEL 2.5V LI-ION 2200MA	
MD		CABO PEQUENO TIPO AA 2.5V	SIM	LARINGOSCÓPIO - DUAS PILHAS TIPO AA OU BATERIA RECARREGÁVEL 2.5V LI-ION 1000MA	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 105, de 11 de julho de 2002.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria n.º 257, de 12/11/1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, o modelo BR20D, de esfigmomanômetro marca PREMIUM, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização das verificações metrológicas.

1 CARACTERÍSTICOS DO MODELO:

1.1 Requerente: Glicomed Produtos Médico Hospitalar Ltda.

Endereço: Rua da Quitanda, 185 - Centro - Rio de Janeiro-RJ

1.2 Fabricante: Wenzhou Hongshun Industries & Tradeco.

País de Origem: China

1.3 Designação: esfigmomanômetro mecânico do tipo aneróide.

1.4 Marca: PREMIUM.

1.5 Modelo: BR20D.

1.6 Descrição: Instrumento mecânico, constituído basicamente por manômetro aneróide com dispositivo indicador; braçadeira; pêra e válvula manual de controle de saída de ar.

1.6.1 Manômetro aneróide: utiliza um sensor elástico de dois fole (4 diafragmas) que se deforma em função da pressão que lhe é aplicada, transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro indicador.

1.6.2 Dispositivo indicador: constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial. A referência zero da escala é caracterizada por um retângulo com comprimento correspondente a tolerância de $\pm 3\text{mmHg}$, em torno do ponto zero.

Faixa de medição: 0 a 300 mmHg

Valor de uma divisão: 2 mmHg

Graduação máxima: 304 mmHg

Graduação mínima: 2 mmHg

1.6.3 Braçadeira: confeccionada em tecido tipo náilon ou similar, não elástico, ajustável e fixada ao braço por meio de velcro e/ou fecho metálico em sua faixa delimitadora. É dotada de tira para fixação do manômetro. É apresentada no seguinte tamanho:

a) Tamanho "ADULTO" - destinada à circunferência do braço de 22cm a 28cm, com o comprimento total de 52cm e a largura de 14,5cm.

1.6.4 Manguito: Confeccionado em látex com dois tubos vulcanizados do mesmo material, medindo:

a) Tamanho "ADULTO" - 22cm de comprimento por 12cm de largura

1.6.5 Pêra: Confeccionada em látex, formato anatômico e flexível

1.6.6 Válvula de controle de saída de ar: Confeccionada em metal cromado de rosca com controle manual.

2 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

2.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo INMETRO/DIMEL n.º 52600 003017/2000.

3 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

3.1 O instrumento, deverá portar, as seguintes inscrições:

3.1.1 No mostrador:

a) marca ou nome do fabricante;

b) número de série;

c) unidade de pressão utilizada;

d) marca de aprovação do modelo, na forma 'SÍMBOLO DO INMETRO – ML xxx/yyyy' (n.º e ano).

3.1.2 Na braçadeira:

a) identificação do tamanho e da circunferência do braço, conforme nomenclatura e dimensões constantes em 1.5.3

b) faixa delimitadora de utilização;

c) marcação do centro do manguito, identificada por uma linha com a inscrição "ARTÉRIA";

d) marca do fabricante;

e) marca de aprovação do modelo.

3.1.3 No manual:

a) marca ou nome e endereço do fabricante;

b) método correto de utilização e leitura do instrumento;

c) especificações técnicas incluindo o dimensionamento da braçadeira;

d) periodicidade de verificação;

e) instruções para limpeza e esterilização;

f) número e data da Portaria que aprova o Regulamento Técnico Metrológico.

4 CONTROLE METROLÓGICO:

4.1 Verificações metrológicas: Devem ser realizadas de acordo com o estabelecido no Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria INMETRO N.º 24/1996;

4.2 Erros máximos permitidos: Os erros máximos permitidos são os constantes do item 8 do Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria INMETRO N.º 24/1996;

4.3 Marca de verificação: O instrumento aprovado em verificação metrológica, receberá a respectiva marca, aposta pelo órgão executor da verificação, na parte frontal do instrumento.

5 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA:

5.1 Vista frontal do manômetro;

5.2 Vista lateral do manômetro;

5.3 Braçadeira velcro adulto - frente;

5.4 Braçadeira velcro adulto - verso;

5.5 Braçadeira de fecho metálico adulto – frente;


5.6 Braçadeira de fecho metálico adulto – verso;

6 ENTRADA EM VIGOR

6.1 Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.


ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal

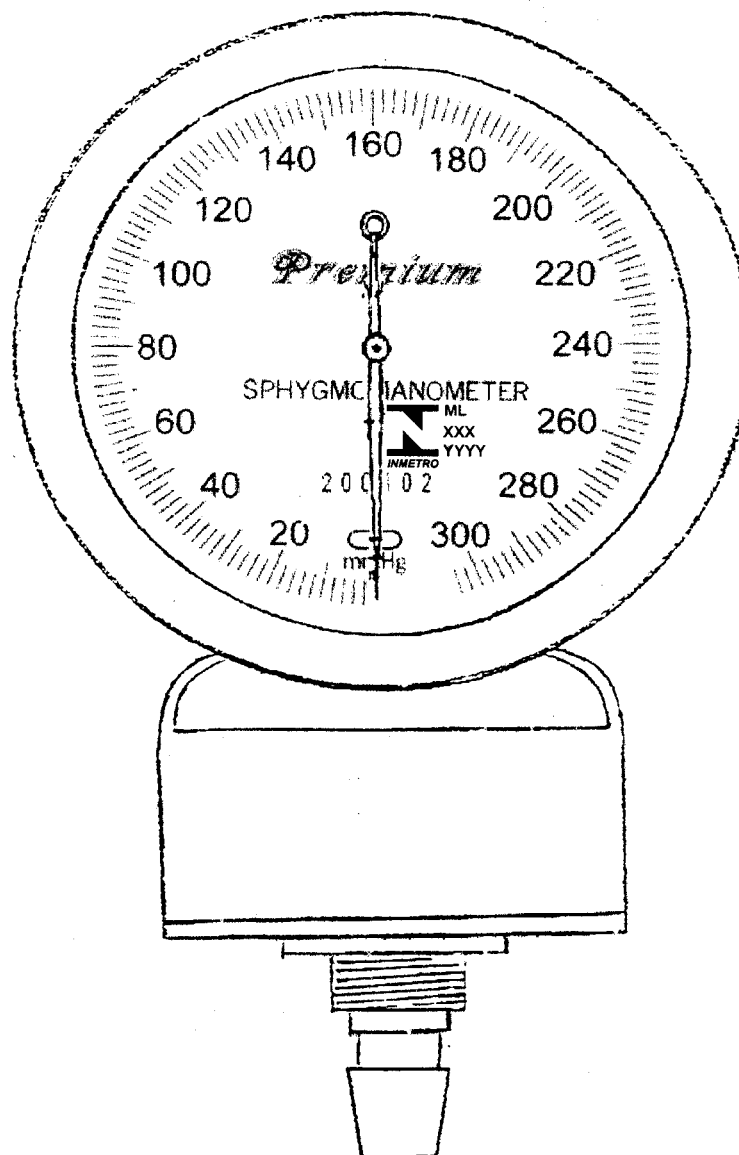

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 105, DE 11 DE JULHO DE 2002

	FABRICANTE: WENZOU HONGSHUN – CHINA	COTAS EM:
	VISTA FRONTAL DO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE MARCA PREMIUM	ESCALA: SEM ESCALA
		ANEXO: 01

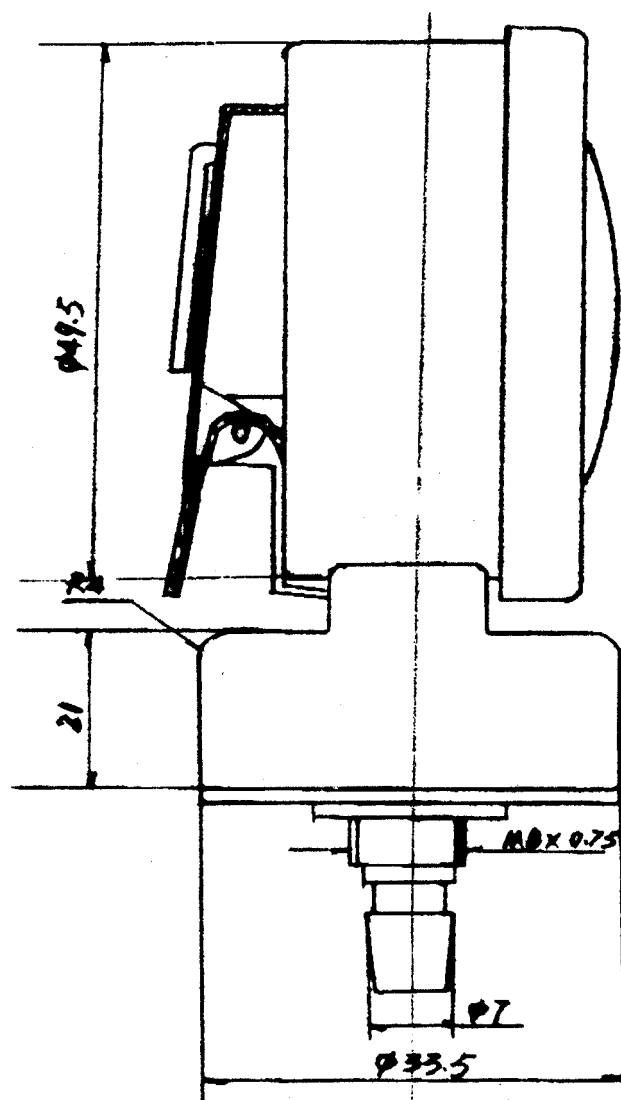

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 105, DE 11 DE JULHO DE 2002




FABRICANTE: WENZOU HONGSHUN – CHINA

VISTA LATERAL DO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE
MARCA PREMIUM

COTAS EM:
mm

ESCALA:
2.1

ANEXO:
02

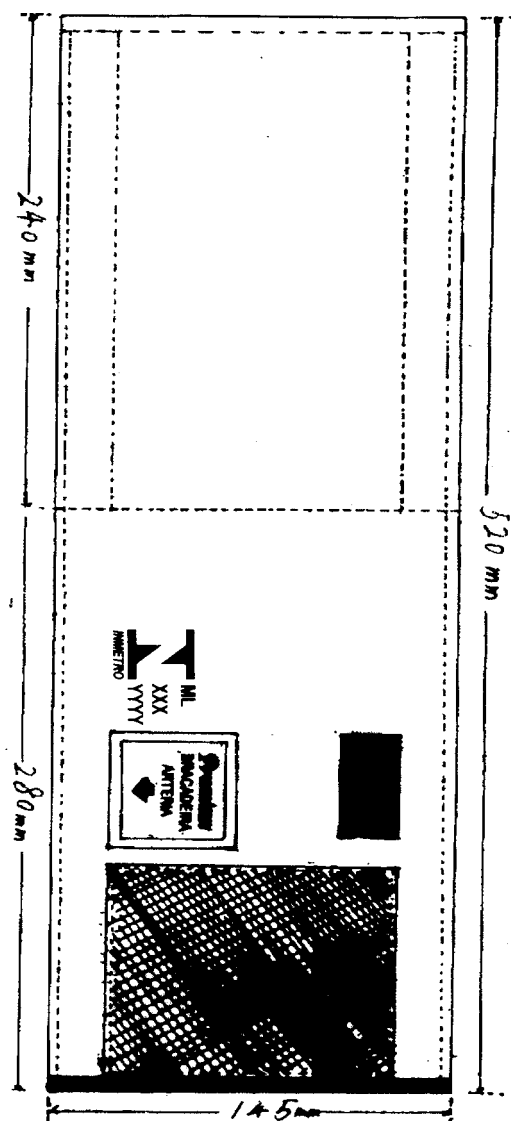

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 105, DE 11 DE JULHO DE 2002




FABRICANTE: WENZOU HONGSHUN – CHINA

BRAÇADEIRA PARA ESFIGMOMANÔMETRO TAMANHO
ADULTO – FIXAÇÃO POR VELCRO MARCA PREMIUM -
FRENTE

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
03

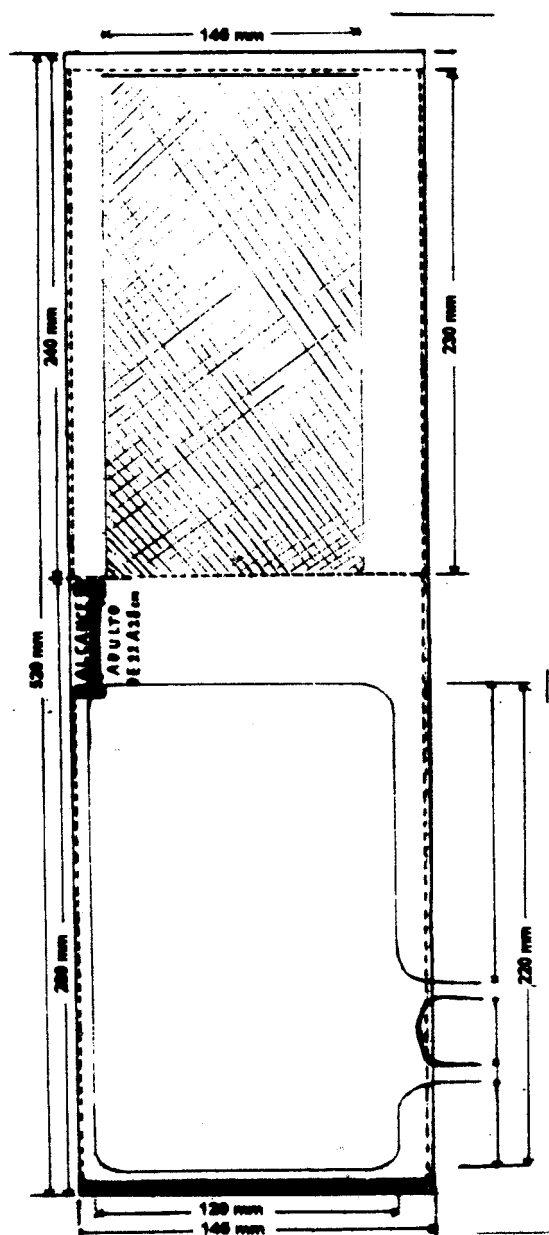

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 105, DE 11 DE JULHO DE 2002




FABRICANTE: WENZOU HONGSHUN – CHINA

BRAÇADEIRA PARA ESFIGMOMANÔMETRO TAMANHO
ADULTO – FIXAÇÃO POR VELCRO MARCA PREMIUM -
VERSO

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
04

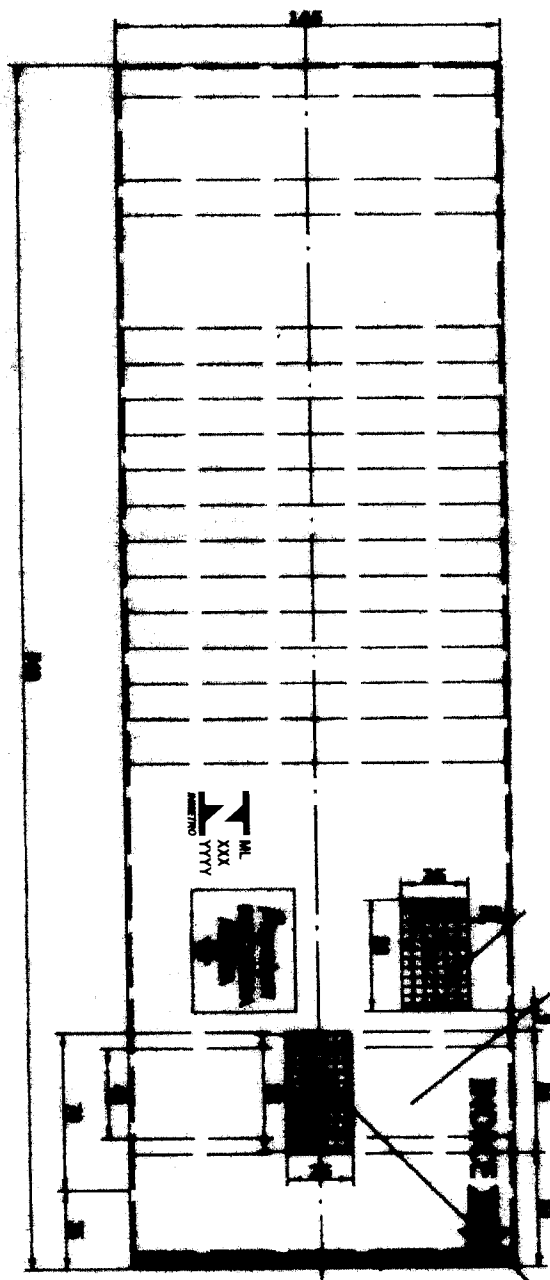

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 105, DE 11 DE JULHO DE 2002




FABRICANTE: WENZOU HONGSHUN – CHINA

BRAÇADEIRA PARA ESFIGMOMANÔMETRO TAMANHO
ADULTO – FIXAÇÃO POR FECHO METÁLICO MARCA
PREMIUM - FRENTE

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
05

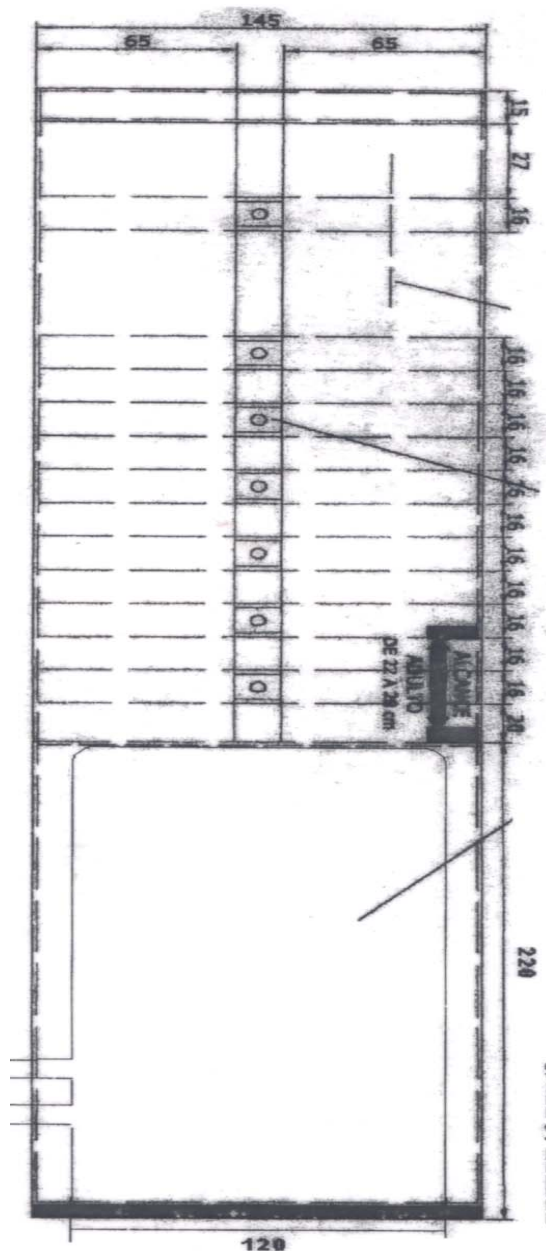

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 105, DE 11 DE JULHO DE 2002



FABRICANTE: WENZOU HONGSHUN – CHINA

BRAÇADEIRA PARA ESFIGMOMANÔMETRO TAMANHO
ADULTO – FIXAÇÃO POR FECHO METÁLICO MARCA
PREMIUM - FRENTE

COTAS EM:
mm

ESCALA:
SEM

ANEXO:
06

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

2 Certificado(s)

0 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **QC** N° Certificado: **QC-2703-23.01** Tipo: **Produto** Emissão: **27/10/2023** Validade:**27/10/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#) Portaria Inmetro nº 384 de 18/12/2020

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
20920517000106	MRM HOSPITALAR LTDA		RUA ARARUAMA, SN - QUADRA 56 - VILA ALZIRA - APARECIDA DE GOIÂNIA, GO - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MRM HOSPITALAR	MRM-200; MRM-200C	NÃO	NEBULIZADOR/115-220VC.A., 50/60HZ, 300VA/NÃO CONTÍNUO/TIPO BF /CLASSE II /IP20		

Certificador: **QC** N° Certificado: **QC-2703-23.02** Tipo: **Produto** Emissão: **27/10/2023** Validade:**27/10/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
20920517000106	MRM HOSPITALAR LTDA		RUA ARARUAMA, SN - QUADRA 56 - VILA ALZIRA - APARECIDA DE GOIÂNIA, GO - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MRM HOSPITALAR	MRM-300 / MRM-300C / MRM-300C2 / MRM-400 / MRM-400C MRM-400C2 / MRM-600 / MRM-600C / MRM- 600C2 MRM-500 / MRM-500C / MRM-500C2	NÃO	ASPIRADORES/115-220VC.A., 50/60HZ, 290VA /CONTÍNUO/TIPO BF /CLASSE I /IP20		

Acessível com
VLibras

topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



[Home](#) > [Setor Regulado](#) > [Regularização de produtos e serviços](#) > [Produtos para saúde](#) > [Produtos não regularizados como dispositivos médicos](#)

Produtos não regularizados como dispositivos médicos

Publicado em 03/12/2020 15h34 Atualizado em 28/02/2023 17h58

Compartilhe:



Atualizado em 10/05/2022



CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

de uso portátil.

15. Aquecedor para laboratório

16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)

17. Autoclave, exceto para esterilização de dispositivos médicos

18. Balança para laboratório

19. Banho histológico

20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.

21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

22. Câmara anaeróbica

23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)

a. Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos

24. Centrifuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)

a. Centrifuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

25. Chuveiro e lava-olhos de emergência

26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde

30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)

31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).

32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações

35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

36. Digestor

37. Diluidor de amostras

38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)

39. Dispensador/removedor de parafina para histologia

40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos

41. Equipamento para gerenciamento de amostras

42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios

43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

45. Estufa, exceto para esterilização de dispositivos médicos

46. Evaporador centrífugo a vácuo

47. Fermentador de culturas

48. Filtro para soluções

49. Forno mufla

50. Fotômetro de chama

51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados

52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.

53. | CONTEÚDO 1 PÁGINA INICIAL 2 NAVEGAÇÃO 3 BUSCA 4 MAPA DO SITE 5



54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
 - a. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)



CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar
 - b.

- c. Esterilizador de ar
- d. Umidificador de ar
- 4. Babador de uso odontológico
- 5. Balde
- 6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)
- 7. Barreira para separação de ambientes
- 8. Biombo
- 9. Bomba a vácuo
- 10. Caldeira
- 11. Caneta para marcação cirúrgica
- 12. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
- 13. Capa para Equipamentos
- 14. Central de ar comprimido
- 15. Central de gases medicinais
- 16. Central de vácuo
- 17. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
- 18. Compressor de ar
- 19. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
- 20. Cortador de isopor para confecção de moldes
- 21. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
- 22. Dispositivo para abertura de frasco ampola
- 23. Dispositivo para abertura de produtos médicos
- 24. Embalagem para esterilização de produtos médicos
- 25. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
- 26. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 - a. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
- 27. Equipamentos para Lavanderia
- 28. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
- 29. Escova para limpeza de produtos em geral
- 30. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
- 31. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
- 32. Fogão para preparação de alimentos
- 33. Gel para absorção de resíduos orgânicos
- 34. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
- 35. Gerador de vapor
- 36. Gesso para confecção de modelo odontológico
- 37. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
- 38. Incinerador de resíduos hospitalares
- 39. Indicador físico, químico ou biológico
- 40. Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais



42. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 - a. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 - b. Cadeiras de espera
 - c. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 - d. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 - e. Mesa de cabeceira
 - f. Mesa para Necrópsia
43. Negatoscópio
44. Papel higiênico / papel toalha
45. Pia hospitalar
46. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
47. Protetor auricular de ruídos
48. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade
49. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
50. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
51. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
52. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
53. Régua endodôntica para medição de limas
54. Restritores utilizados na contenção do paciente
55. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
56. Saco para coleta de resíduos hospitalares
57. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
58. Saltos ortopédicos
59. Secador de ar medicinal
60. Seladora de embalagens de produtos médicos
61. Sistema de comunicação hospitalar
62. Sistema de sinalização hospitalar
63. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares



CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA ACONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

CONTEÚDO 1 PÁGINA INICIAL 2 NAVEGAÇÃO 3 BUSCA 4 MAPA DO SITE 5

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições
4. Cronômetro
5. Relógio para treinamento
6. Dardo
7. Dilatador nasal adesivo
8. Disco
9. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - a. Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - b. Halteres
 - c. Estações de Musculação
 - d. Remadores
 - e. Aparelho para abdominais
 - f. Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10. Mesa ou cadeira para massagem
11. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13. Protetor não ortopédico de partes do corpo
14. Tablado (exceto para fisioterapia)
15. Vara para salto



CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicate e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar
 - b. Purificador de ar
 - c. Esterilizador de ar
 - d. Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. l

15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira e bico
19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
20. Massageador de gengiva
21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
22. Mordedor para lactentes
23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Purificador de água
34. Sauna
35. Secador e escova de cabelos
36. Top maternal, Sling



CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, laminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou

3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Streptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares



Compartilhe:



Desativado



Configurações avançadas de cookies

[Ver Declaração de Cookies](#)

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies.

Cookies estritamente necessário

Esses cookies permitem funcionalidades essenciais, tais como segurança, verificação de identidade e gestão de rede.

Esses cookies não podem ser desativados em nossos sistemas. Embora sejam necessários, você pode bloquear esses cookies diretamente no seu navegador, mas isso pode comprometer sua experiência e prejudicar o funcionamento do

Visam a melhoria do desempenho do site por meio da coleta de dados anonimizados sobre navegação e uso dos recursos disponibilizados. Se você não permitir a coleta desses cookies, esses dados não serão usados para melhoria do site.

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

Cookies de terceiros

O portal gov.br depende dos serviços oferecidos por terceiros que permitem:

- Melhorar as campanhas de informação do governo;
- Oferecer conteúdo interativo;
- Melhorar a usabilidade e facilitar o compartilhamento de conteúdo nas redes sociais;
- Assistir a vídeos e apresentações animadas diretamente no gov.br.

Os cookies de terceiros no portal gov.br são todos cookies de publicidade e multimídia do Google. Esses terceiros coletarão e usarão dados de navegação também para seus próprios fins. O usuário pode desativá-los direto no site da Google.

- Informativo oficial dos cookies de terceiros do Google (<https://business.safetym.google/adscokies>).
- Política do Google (<https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl-pt-BR>).

O Google Analytics no portal gov.br tem recursos de relatórios de publicidade ativados, que coleta informações adicionais por cookie da DoubleClick, como atividade da Web e de IDs de publicidade do dispositivo (atividade do aplicativo) (<https://support.google.com/analytics/answer/2799357>)

O portal gov.br não tem controle sobre quais cookies de terceiros serão ativados. Alguns cookies de terceiros que podem ser encontrados ao acessar o portal: Domínios: Google, Youtube, DoubleClick.net

Configuração de cookies no navegador



Gerenciar cookies

Rejeitar cookies

Aceitar cookie



Aparelho de Pressão Digital de Braço

G·TECH

Modelo BSP11



Leia este Manual de Instruções antes de utilizar o seu
Aparelho de Pressão Digital modelo BSP11

M A N U A L

Precauções e Advertências

- Leia o manual de instruções antes do uso.
- Não exponha o aparelho a temperaturas muito elevadas, umidade, poeira ou à luz do sol direta.
- A braçadeira contém uma bolsa de ar (manguito) muito sensível. Manuseie com cuidado e evite qualquer tipo de compressão, torção ou dobra.
- Evite acúmulo de impurezas em seu aparelho.
- Não deixe o instrumento cair. Evite vibrações fortes.
- Jamais tente consertar o monitor por conta própria, pois qualquer abertura desautorizada do mesmo invalidará o direito à garantia.
- Não lavar o aparelho ou a braçadeira. Para limpeza siga os procedimentos descritos neste manual.
- A auto-medição significa controle e não diagnóstico ou tratamento. Os valores incomuns deverão sempre ser discutidos com o seu médico.
- O valor da pulsação exibido no visor do monitor NÃO é adequado para a verificação da frequência cardíaca de portadores de marcapassos!
- Nos casos da irregularidade cardíaca (arritmia), as medições devem ser avaliadas por um médico especializado.
- Não deixe o aparelho ao alcance de crianças, por conter peças pequenas que podem ser engolidas.
- Não descartar as pilhas em lixo comum.
- O aparelho é de uso adulto.
- Descanse pelo menos 5 minutos antes de realizar uma medição.
- Relaxe pelo menos de 3 a 5 minutos entre as medições.
- Não se mova, fale ou agite o aparelho durante uma medição.
- Não realize medições em uma temperatura/ umidade fora da faixa determinada para operação do aparelho (Temperatura: 10° C- 40° C e Umidade: 15 % a 90%), pois isso pode causar leituras imprecisas
- Espere de 30 a 45 minutos antes de realizar uma medição caso tenha consumido bebidas à base de cafeína ou tenha fumado cigarros.
- É recomendado que ao ser realizada a medição, seja utilizado o mesmo braço (preferencialmente o esquerdo) e o mesmo horário de medição durante os dias.
- Indivíduos que apresentarem algum problema circulatório como arteriosclerose, diabetes, doença hepática, doença renal, hipertensão severa, favor, consultar um médico antes da utilização do aparelho.
- Evite se alimentar, praticar exercícios e tomar banho até 30 minutos antes do teste.
- O Aparelho de Pressão Digital G-Tech Modelo BSP11 não deve ser utilizado em medições invasivas

Interferência eletromagnética

Este monitor contém componentes eletrônicos sensíveis (sensores). Não deve, portanto, ser armazenado ou utilizado na proximidade de campos elétricos ou eletromagnéticos fortes, como, por exemplo, telefones móveis e fornos de micro-ondas a fim de evitar alterações temporárias da exatidão dos resultados de suas medições.

Indicação de Uso

- Medição da Pressão Arterial Sistólica e Diastólica
- Medição da Pulsação (Frequência Cardíaca)

Identificação do Produto

O Aparelho de Pressão Digital G-Tech Modelo BSP11 é um aparelho automático de braço que realiza medições da pressão sanguínea sistólica, diastólica e da frequência cardíaca, por um método não invasivo. Este aparelho utiliza o método oscilométrico de medição.

A pressão sanguínea é a pressão exercida pelo sangue contra a superfície interna das artérias. A força original vem do batimento cardíaco. A pressão sanguínea varia a cada instante, seguindo um comportamento cíclico. São vários os ciclos que se superpõem, mas o mais evidente é o determinado pelos batimentos cardíacos. Chama-se ciclo cardíaco o conjunto de acontecimentos desde um batimento cardíaco até o próximo batimento.


No momento em que o coração contrai e ejeta seu conteúdo na aorta, a pressão é máxima. Esta fase no ciclo cardíaco chama-se sístole, sendo que a pressão neste instante é chamada de pressão sanguínea sistólica, ou chamada também de alta. Quando o coração se dilata ao receber o sangue, o ciclo é chamado de diástole, sendo que a pressão neste instante é chamada de pressão sanguínea diastólica, ou chamada também de baixa.

Vários fatores como, por exemplo, atividade física, ansiedade e hora do dia, podem influenciar sua pressão sanguínea. A pressão sanguínea é geralmente mais baixa pela manhã e aumenta a partir da tarde para o anoitecer. Ela costuma ser, em média, inferior no verão e mais alta no inverno.

Variações na Pressão Sanguínea

A hipertensão arterial é uma doença perigosa que pode afetar a qualidade de vida do indivíduo. Isso pode levar a uma grande quantidade de problemas, incluindo insuficiência cardíaca, insuficiência renal e hemorragia cerebral. Ao manter um estilo de vida saudável e visitando o seu médico regularmente, a hipertensão e doenças relativas podem ser muito mais fáceis de controlar quando diagnosticado nos estágios iniciais.



A pressão sanguínea frequentemente sofre alterações por várias vezes ao longo do dia. Normalmente a pressão sanguínea aumenta enquanto se está trabalhando e é menor quando se está tomando banho, ingerindo álcool ou dormindo. Alguns hormônios, como a adrenalina (hormônio liberado pelo corpo quando sob estresse), promovem a contração das artérias o que causa o aumento da pressão sanguínea. Abaixo está um exemplo de variação da pressão ao longo do dia.

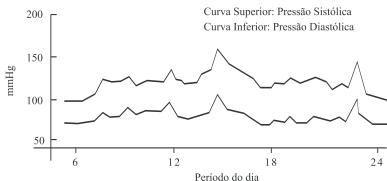


Indicador de categoria de risco WHO

O Aparelho de Pressão Digital G-Tech Modelo BSP11 é equipado com indicador de pressão sanguínea WHO que classifica sua pressão sanguínea dentro de 6 estágios descritos abaixo, baseada em diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (World Health Organization – WHO).

O gráfico abaixo (codificado por cores no monitor) dica os resultados do teste

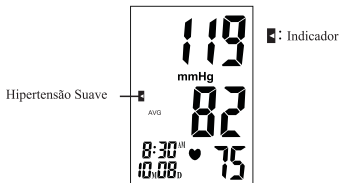

Após cada medição, o aparelho indica automaticamente sua posição nos 6 estágios de acordo

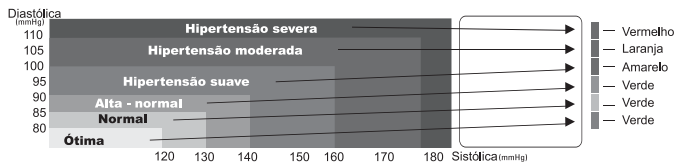

Observação:

Quando a pressão sistólica e diastólica de uma pessoa são classificados em 2 categorias diferentes, a categoria mais alta deve ser aplicada.

Ex.: pressão sistólica 181 mmHg e diastólica 99 mmHg Categoria Vermelha (Hipertensão severa)

Ex.: pressão sistólica 110 mmHg e diastólica 95 mmHg Categoria Amarela (Hipertensão suave)

Atenção:


A tabela acima não é exata para a classificação da pressão sanguínea e é indicada para ser usada como um guia para o entendimento das medições da pressão sanguínea não invasiva.

Forma de Apresentação do Produto


Conteúdo:

- 01 Aparelho de Pressão Digital G-Tech Modelo BSP11
- 01 Braçadeira tamanho adulto para circunferência de braço de 22 a 36 cm
- 01 Manual de instruções
- 01 Bolsa protetora para armazenamento
- 04 pilhas alcalinas AAA


Descrição do Aparelho

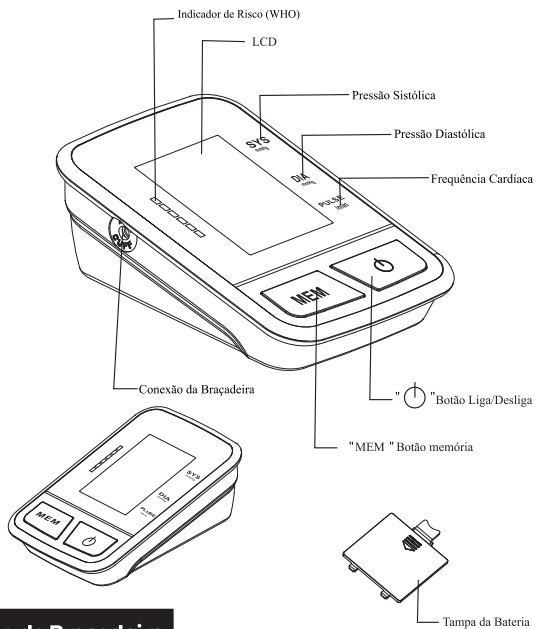

Descrição da Braçadeira

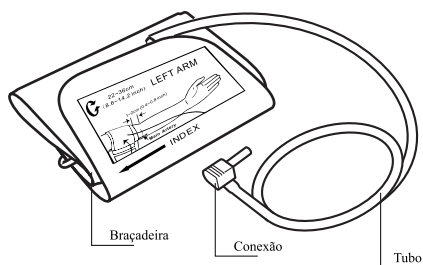


Descrição dos Símbolos na Tela

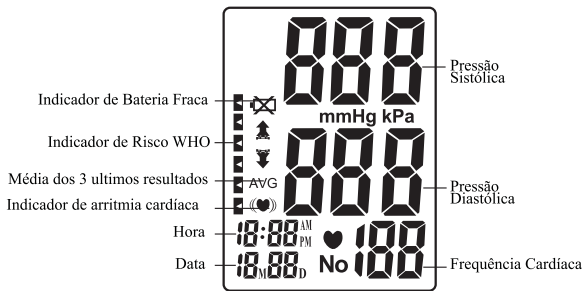



SÍMBOLOS	Definição
 Símbolo de Bateria Fraca	Indica bateria fraca ----- SUGESTÃO: Substitua as baterias por novas.
 Símbolo de Frequência de Pulsação	O coração piscando irá surgir quando a pulsação é detectada durante uma medição. ----- SUGESTÃO: Não fale ou faça movimentos durante a medição.
 Símbolo de Detecção de Batimento Cardíaco Irregular	Aparece se um batimento cardíaco irregular for detectado. ----- SUGESTÃO: Não fale ou faça movimentos durante a medição. Repita a medição após descansar por, no mínimo, 3 minutos.
 Barra de Indicador de Categoria de Risco	A seta indica em a categoria de risco em que está situada a medição realizada.
 Número de Medição	Indica o número da medição armazenada na memória.
 Média das últimas 3 medições	Indica a média das últimas 3 medições.

Colocando a braçadeira

Insira, firmemente, o pino da braçadeira na porta de entrada correspondente no lado esquerdo do monitor.



Coloque a braçadeira sobre o braço esquerdo e certifique-se de que a extremidade inferior da braçadeira esteja aproximadamente entre 1 e 2 cm acima do cotovelo. Para obtenção de resultados mais precisos, posicione o braço de modo que a braçadeira permaneça na mesma altura do coração.




Atenção:

Certifique-se de remover qualquer tecido ou objeto que esteja cobrindo seu braço no momento da colocação da braçadeira.


Não utilize este aparelho de pressão se seu braço estiver lesionado

Procedimento de Medição – Modo rápido


1.Instale as baterias, conforme figura abaixo.

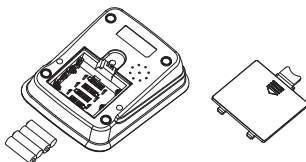

2. Insira o pino da braçadeira na porta de entrada correspondente no lado esquerdo do monitor.




3. Remova a roupa ou qualquer tecido que esteja na área do braço.



4. Descanse por, pelo menos, 5 minutos antes de realizar a medição. Sente-se, confortavelmente, em uma cadeira com o seu braço apoiado em uma superfície rígida e com os pés apoiados no chão conforme figura abaixo.



5. Coloque a braçadeira sobre o braço esquerdo e posicione o mesmo de modo que a braçadeira permaneça na mesma altura do coração. Certifique-se que a extremidade inferior da braçadeira esteja aproximadamente entre 1 e 2 cm acima do cotovelo e de que o tubo está mais próximo da parte interna do braço.

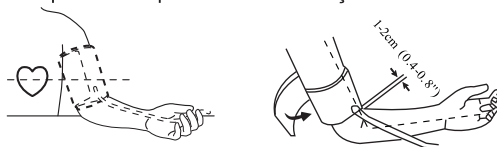

6. Pressione o botão “⏻” para ligar o monitor e iniciar a medição.

Modo de Configuração do sistema

1. Configuração de data e horário

Com o aparelho desligado, pressione o botão “⏻” por aproximadamente 3 segundos para acionar o modo de configuração de data e horário. Configure, primeiramente, o mês ajustando com o botão «MEM» Pressione o botão “⏻” novamente para confirmar o mês corrente. Repita o passo acima para ajustar o dia atual (1, 2, 3... 31), a hora (1, 2, 3... 12) e o minuto (00, 01, 02, 03... 59). Toda vez que o botão “⏻” for pressionado, irá ser concluído a seleção que estará configurando e se dará continuidade a configuração em sucessão (dia, hora, minuto).



2. Salvando as configurações


Enquanto estiver em qualquer modo de configuração, pressione o botão “⏻”, por aproximadamente 3 segundos, para desligar o aparelho. Todas as informações serão salvas.

Nota: o aparelho irá salvar automaticamente todas as informações e desligar se ficar inativa por 3 minutos.

Realizando a Medição

1. Ligando o aparelho

• Pressione o botão “” até escutar um som de “beep”. Todos os símbolos irão aparecer na tela do visor por um segundo.



Nota: o aparelho não funcionará caso haja ar residual do teste anterior na braçadeira. O visor LCD irá piscar  até que a pressão esteja estabilizada.

2. Pressurização

• A pressão inicial é primeiramente bombeada a 190 mmHg. Se a pressão arterial sistólica do usuário que está realizando a medição for maior que 190 mmHg, o aparelho irá automaticamente re-inflar por conta própria.



Precaução de segurança: Se a pressão na braçadeira for extremamente alta durante o teste, pressione o botão “” para interromper a medição. A braçadeira será rapidamente esvaziada quando o aparelho for desligado

3. Medição


Depois de a braçadeira inflar, o ar lentamente vai sendo liberado conforme indicado pelo valor correspondente da pressão da braçadeira. O ícone ♥ será exibido piscando simultaneamente no visor sinalizando detecção do batimento cardíaco.



Nota: Manter-se relaxado durante o teste. Evite falar ou se movimentar durante a medição.

4. Visualização dos Resultados

Três sons curtos de beep irão soar quando o teste for concluído. O visor exibirá as medições para a pressão arterial sistólica e diastólica. Um indicador que representa a medição atual aparecerá ao lado da correspondente classificação de categoria de risco WHO.



Nota: Consulte as páginas 4 e 5 para detalhes sobre a classificação de acordo com as categorias de risco WHO.

Este símbolo ((♥)) irá aparecer na tela indicando que uma certa irregularidade na frequência do batimento cardíaco foi detectada durante a medição.

O ritmo do batimento cardíaco que for maior ou menor que 25% do ritmo cardíaco médio, é definido como um ritmo de batimento cardíaco irregular. Movimentos excessivos durante a medição também podem resultar no aparecimento deste símbolo. Consulte regularmente seu médico.


Nota: O registro de batimento cardíaco irregular não será gravado na memória.

O valor da pulsação exibido no visor NÃO é adequado para a aferição da frequência cardíaca de portadores de marcapassos.

Função Memória

Verificação da Memória e da média dos 3 últimos resultados de medição

Com o aparelho desligado, pressione o botão “MEM” para ativar a exibição da tela. Depois que o aparelho executa um auto-diagnóstico, a tela exibirá a média das 3 últimas medições realizadas. Pressionando o botão “MEM” novamente, a tela exibirá a última medição armazenada na memória como NO: 01. Os resultados mais antigos armazenados na memória podem ser visualizados pressionando o botão “MEM”.

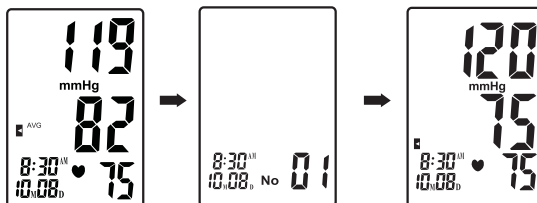

Se o número de medições superar a capacidade de armazenamento de 120 medições, os testes mais recentes irão aparecer primeiro, eliminando, desta forma, as medições mais antigas.

Apagando os dados da Memória

A memória para um grupo selecionado pode ser excluída acessando o modo de verificação da memória. Pressione e segure o botão "⌚" por aproximadamente cerca de 3 segundos para apagar todos os registros da memória. O monitor emite um sinal sonoro indicando êxito na exclusão e será exibido na tela o ícone "--". Em seguida, pressione o botão "⌚" para desligar o monitor.



Nota: A memória não pode ser recuperada uma vez que tenha sido apagada.

Desligando o Medidor

O botão "⌚" pode ser pressionado para desligar o aparelho de pressão em qualquer modo.


O aparelho irá se desligar automaticamente após cerca de 3 minutos sem operação em qualquer modo.

Precaução de Segurança: Se a pressão na braçadeira tornar-se muito extrema durante a medição, pressione o botão "⌚" para desligar o aparelho.


Uma vez o aparelho desligado, a pressão da braçadeira se dissipará rapidamente.

Substituição das baterias

Quando o seu aparelho de pressão emitir 4 avisos sonoros breves e, simultaneamente, o símbolo de bateria fraca  aparecer na tela, por aproximadamente 5 segundos, substitua as mesmas por baterias novas e não misture baterias novas e usadas.



Para realizar a substituição das baterias, remova a tampa da bateria e insira 4 baterias alcalinas AAA no compartimento das baterias conforme mostrado na figura abaixo. Certifique-se de que as polaridades $+/-$ estejam posicionadas adequadamente.



Atenção:


- As medições armazenadas na memória não são apagadas durante a troca de baterias.
- Após a substituição das baterias, configure a data e o horário.
- As baterias e equipamento devem ser descartadas conforme as leis sanitárias locais.
- Mantenha as baterias longe do alcance das crianças devido ao risco de sufocamento.
- Remova as baterias do aparelho quando este ficar sem uso por longos períodos de tempo.
- Não misture pilhas antigas e novas, simultaneamente, no momento da utilização do aparelho.

Manutenção

- Siga as instruções de armazenamento e conservação do equipamento.
- Guarde-o em embalagem própria, evitando assim o acúmulo de impurezas.
- Não exponha o aparelho a temperaturas muito elevadas, umidade, poeira ou à luz do sol direta.



- Não deixe o instrumento cair. Evite vibrações fortes. A braçadeira contém uma bolsa de ar (manguito) muito sensível. Manuseie-a com cuidado e evite qualquer tipo de compressão, torção ou dobra.




- Para a limpeza, utilize um pano macio e levemente umedecido com água e seque-o imediatamente com um pano seco.



- Não utilizar agentes de limpeza abrasivos (gasolina, removedores ou solventes similares) e não imergir monitor em líquidos.



- Não mergulhe a braçadeira em água! Aplique uma pequena quantidade de álcool em um pano macio para limpar a superfície da braçadeira. Permita que a braçadeira seque naturalmente à temperatura ambiente.
- Remova as baterias do aparelho quando este ficar sem uso por longos períodos de tempo.



- Jamais tente consertar o monitor por conta própria, pois qualquer abertura desautorizada do mesmo invalidará o direito à garantia.



Resolução de Problemas

SÍMBOLOS/SINTOMAS	CONDIÇÕES/CAUSAS	INDICAÇÕES/ CORREÇÕES
O aparelho não liga quando o botão  é pressionado.	Pilhas descarregadas.	Substitua por 4 pilhas alcalinas novas tipo AAA.
	As polaridades das pilhas estão posicionadas de forma incorreta.	Certifique-se de que as polaridades estão posicionadas corretamente

SÍMBOLOS/SINTOMAS	CONDIÇÕES/CAUSAS	INDICAÇÕES/ CORREÇÕES
Os resultados da pressão arterial não se encontram dentro da faixa normal	A braçadeira está muito apertada ou não devidamente posicionada no braço.	Recoloque a braçadeira no braço conforme especificado no tópico “Colocando a braçadeira” (Veja página 8)
	Resultados imprecisos devido ao excesso de movimentação durante a medição	Sente-se, confortavelmente, em uma cadeira e se posicione de modo que a braçadeira esteja na mesma altura do coração. Não se mova, fale ou agite o aparelho durante a medição. (Veja página 9)
" Err "	A braçadeira não está inflando adequadamente.	Verifique se a braçadeira está devidamente acoplada ao monitor.
	Operação inapropriada	Leia cuidadosamente o manual do usuário novamente e realize a medição novamente.
	Pressão excedendo 300 mmHg	Leia cuidadosamente o manual do usuário novamente, desligue o aparelho e repita a medição.

Para saber onde encontrar um posto de assistência técnica autorizada, acesse nosso site: www.accumed.com.br ou entre em contato com nosso SAC: 0800 052 1600

Garantia

O Aparelho de Pressão Digital G-Tech Modelo BSP11 tem garantia de 5 anos a contar da data de entrega efetiva do produto. A garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal, com data de compra, nome, referência do produto e identificação do revendedor. A garantia não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal, que possuem garantia de noventa dias, também contados à partir da data de compra. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura do aparelho realizada sem autorização do fabricante invalidará esta garantia, não existindo componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário.

As pilhas e os danos provocados pelo vazamento das mesmas, não estão cobertos pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto por atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva ao direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante, após análise técnica.

Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia.

Todos os serviços de manutenção oriundos das partes sensíveis ao desgaste de uso normal serão cobrados em separado, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia. As verificações periódicas não são cobertas pela garantia e serão cobradas separadamente. A calibração periódica não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecida na regulamentação metrológica.

Especificações Técnicas

Modelo	BSP11
Método de Medição	Oscilométrico
Intervalo de Medição	Pressão: 30-280 mmHg
Frequência Cardíaca (pulsação)	30 a 180 bpm
Erro Máximo	Pressão: ± 3 mmHg Pulsação: ± 5 %
Inflagem	Automática (Bomba de Ar)
Deflação	Automática (válvula de controle de liberação de ar)
Display	LCD
Memória	120 medições
Dimensões (comprimento x largura x altura)	140 x 98 x 48 mm
Peso	340 g (excluindo as baterias)
Tamanho da braçadeira	22 – 36 cm

Condições de Armazenamento/Transporte	Temperatura: -20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F) Umidade: 15% ~ 90 % U.R.
Condições de Operação	Temperatura: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Umidade: 15% ~ 90 % U.R.
Fonte de Alimentação	4 pilhas alcalinas AAA (1,5 V)
Vida útil da bateria	Aprox. 2 meses com 3 testes por dia
Desligamento automático	Após 3 minutos sem uso
Acessórios	Manual de instruções, 4 pilhas alcalinas AAA, braçadeira tamanho adulto de braço de circunferência 22-36 cm e estojo

Classificação

De acordo com grau de proteção contra choque elétrico: Parte aplicada tipo BF.
De acordo com grau de proteção contra penetração de água: Equipamento IP22
Modo de operação: Contínuo

Observação importante: De acordo com a Portaria INMETRO n° 46/2016, é obrigatória a verificação desse instrumento uma vez por ano por um órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – INMETRO (RBMLQ-I).

Abaixo seguem tabelas onde estão descritas informações importantes sobre compatibilidade eletromagnética. Ref.: IEC 60601-1-2.

Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões Eletromagnética		
O Aparelho de pressão digital G-tech modelo BSP11 é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou o usuário do Aparelho de pressão digital G-tech modelo BSP11 garanta que este seja utilizado em tal ambiente.		
Ensaio de Emissões	Conformidade	Ambiente Eletromagnético – diretrizes
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1	O Aparelho de pressão digital G-tech modelo BSP11 utiliza a energia de RF apenas para a sua função interna. Portanto, suas emissões RF são muito baixas e não é provável que causem qualquer interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
Emissões de RF CISPR 11	Classe B	

Emissões de Harmônicos IEC 61000-3-2	Não Aplicável	O Aparelho de pressão digital G-tech modelo BSP11 é apropriado para uso em todos estabelecimentos, incluindo domicílios e aqueles diretamente conectados à REDE PÚBLICA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA de baixa tensão que alimenta as edificações utilizadas como domicílios.
Flutuação de tensão/ e missões cintilação IEC 61000-3-3	Não Aplicável	

Diretrizes e declaração do fabricante - Imunidade Eletromagnéticas			
O Aparelho de pressão digital G-tech modelo BSP11 é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou o usuário do Aparelho de pressão digital G-tech modelo BSP11 garanta que este seja utilizado em tal ambiente.			
Ensaio de Imunidade	Nível de Ensaio IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Diretrizes
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 6kV contato ± 8kV ar	± 6kV contato ± 8kV ar	Convém que os pisos sejam de madeira, concreto ou cerâmica. Se os pisos estiverem recobertos por material sintético, convém que a umidade relativa seja de pelo menos 30%.
Campo magnético gerado pela frequência da rede elétrica (50/60Hz) IEC 61000-4-8	3A/m	3A/m	Convém que campos magnéticos na frequência da rede de alimentação tenham níveis característicos de um local típico em um ambiente típico hospitalar ou comercial.
NOTA: Ut é a tensão de rede c.a. anterior à aplicação do nível de ensaio.			

Diretrizes e declaração do fabricante - Imunidade Eletromagnética			
O Aparelho de pressão digital G-tech modelo BSP11 é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou o usuário do Aparelho de pressão digital G-tech modelo BSP11 garanta que este seja utilizado em tal ambiente.			
Ensaio de Imunidade	Nível de Ensaio IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Diretrizes
RF Conduzida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	Não Aplicável	Não convém que sejam utilizados equipamentos de comunicação por RF móveis ou portáteis a distâncias menores em relação à qualquer parte do Aparelho de pressão digital G-tech modelo BSP11, incluindo cabos, do que a distância de separação recomendada calculada pela equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de Separação Recomendada $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz a } 2,5 \text{ GHz}$ Onde P é o nível máximo declarado da potência de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d é a distância de separação recomendada em metros (m). Convém que a intensidade de campo proveniente de transmissores de RF, determinada por uma vistoria eletromagnética do campo, seja menor do que o nível de conformidade para cada faixa de frequência. Pode ocorrer interferência na vizinhança dos equipamentos marcados com seguinte símbolo: 
RF Irradiada IEC 61000-4-3	3 Vrms 80 MHz a 2,5 GHz	3V/m	

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação por RF móveis ou portáteis e o Aparelho de pressão digital G-tech modelo BSP11			
O Aparelho de pressão digital G-tech modelo BSP11 é destinado para o uso em um ambiente eletromagnético na qual perturbações por irradiações por RF são controladas. O comprador ou usuário do Aparelho de pressão digital G-tech modelo BSP11 pode ajudar a prevenir interferências eletromagnéticas mantendo a distância mínima entre os equipamentos de comunicação por RF móveis ou portáteis (transmissores) e o Aparelho de pressão digital G-tech modelo BSP11 como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.			
Nível máximo declarado da potência de saída do transmissor W	Distância de separação recomendada de acordo com a frequência do transmissor m		
	150kHz a 80 MHz	80MHz a 800MHz	800MHz a 2.5GHz
	Não Aplicável	$d = \left\lceil \frac{3,5}{E_1} \right\rceil \sqrt{P}$	$d = \left\lceil \frac{7}{E_1} \right\rceil \sqrt{P}$
0.01	Não Aplicável	0.12	0.23
0.1	Não Aplicável	0.38	0.73
1	Não Aplicável	1.2	2.3
10	Não Aplicável	3.8	7.3
100	Não Aplicável	12	23
1. Nota: em caso de 80 MHz de frequência ou 800 MHz, a fórmula para a faixa superior é aplicável.			
2. Nota: Essas são as diretrizes. Condições reais podem variar.			

Descrição de símbolos de rotulagem

Item	Descrição
	Consulte as Instruções de Uso
	Validade
	Data de Fabricação
	Código do lote
	Número de Série
	Parte aplicada de tipo BF;
IP22	Protegido contra objetos sólidos estranhos de diâmetro > 12,5mm e contra queda vertical de gotas d'água à uma inclinação de até 15°
	Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos
	Fabricante
	Atenção, leia as instruções de uso

Descrição de símbolos na caixa de transporte

Item	Descrição
	Frágil, manusear com cuidado
	Manter afastado de luz solar
	Manter afastado de chuva
	Este lado para cima
	Limites de temperatura

Fabricado por: Joytech Healthcare Co. Ltd.
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100, Zhejiang - China


Importado e Distribuído por:
Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda.
CNPJ:06.105.362/0001-23

Rodovia Washington Luiz, 4370 - Galpões G, H, J, K e L
Vila São Sebastião - Duque de Caxias - RJ
CEP: 25055-009

SAC: 0800 052 1600 - Comercial: 21 2126-1600
www.accumed.com.br

Responsável Técnico: Marcos Eduardo da Silva Jordão
CRQ/RJ 3ª Região: 03212320
Registro ANVISA nº: 80275310064

Revisão07_060820



TERMO DE GARANTIA

O Esfigmomanômetro Aneróide Premium tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva do produto. A garantia somente será válida mediante apresentação da nota fiscal, com data de compra, nome, referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica às partes sensíveis ao desgaste de uso normal (braçadeira, pêra, válvula de deflação e manguito), que possuem garantia de noventa dias, também contados à partir da data de compra.

A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia, não existindo componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto por atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante, após análise técnica.

Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todos os serviços de manutenção oriundos das partes sensíveis ao desgaste de uso normal será cobrado em separado. calibração periódica não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica.

Para saber onde encontrar um posto de assistência técnica autorizado, acesse nosso site: www.accumed.com.br ou entre em contato com nosso SAC: 0800 052 1600

De acordo com as Portarias INMETRO nº 153 de 12 de Agosto de 2005 e 46 de 22 de Janeiro de 2016, é obrigatória a verificação deste instrumento uma vez por ano por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – INMETRO (RBMLQ-I).

Importado e distribuído por: **ACCUMED - Produtos Médico-Hospitalares Ltda.**
Rod. Washington Luiz, 4370 - Galpão G, H, J, K e L - Vila S. Sebastião - Duque de Caxias - RJ • CEP: 25055-009 • CNPJ: 06.105.362/0001-23
Insc. Est.: 77.701.290 • www.accumed.com.br • Suporte: 0800 052 1600 • Comercial: 21 2126 1600
Resp. Técnico: Marcos Jordão CRQ 3ª reg.: 03212320 • Reg. ANVISA nº: 80275310022
Portaria de Aprovação do INMETRO/DIMEL nº 177/2009
Fabricado na China por: Wenzhou Kangju Medical Instruments Co. Ltd
177-197, Yong Qiang Road, Yongzhong, 325024, Wenzhou - Zhejiang - China



ML
177
12/05/09



INSTRUÇÕES DE USO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM






INDICAÇÃO DE USO

O esfigmomanômetro Aneróide Premium é indicado para a medição da pressão arterial sanguínea.

APRESENTAÇÃO

Esfigmomanômetro Aneróide Premium: Bolsa de viagem contendo um esfigmomanômetro aneróide completo e um manual de instruções.

DESCRIÇÃO

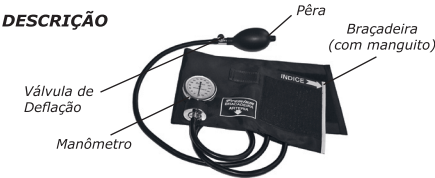

A pressão arterial é registrada em duas medidas: a mais alta chama-se sistólica (medida quando o coração está bombeando); a mais baixa chama-se diastólica (medida quando o coração está relaxado). Alguns fatores podem causar uma elevação na pressão arterial, como por exemplo, ansiedade, nervosismo, etc., porém, deve-se monitorar constantemente os níveis de pressão arterial,

pois, deste modo, será possível diagnosticar o mais cedo possível a hipertensão arterial, que poderá oferecer, sérios riscos à saúde como derrames e ataques cardíacos prematuros.

MODO DE USAR

- 1- A medição da pressão arterial deve ser realizada num ambiente calmo, o paciente deve estar relaxado e deve ser repetida diversas vezes em dias diferentes sob as mesmas condições e no mesmo horário.
- 2- Coloque a braçadeira ao redor da parte superior do braço e certifique-se de que esteja diretamente em contato com a pele e que as roupas não estejam apertando o braço;
- 3- Feche a Válvula de Deflação girando o parafuso no sentido horário;
- 4- Através do método palpatório, localize o pulso radial, infle a braçadeira até desaparecer as pulsa ções, registre esse valor de pressão;
- 5- Coloque o estetoscópio sobre a artéria, na parte interna do cotovelo, infle a braçadeira até 20/30 mmHg acima do valor de pressã o determinado na etapa anterior;
- 6- Alivie a pressã o, abrindo, bem devagar, o parafuso da válvula de deflação, acompanhe a pulsação com o estetoscópio;

- 7- O valor da pressão máxima (sistólica) será o valor onde se conseguiu identificar os batimentos cardíacos com maior intensidade;
- 8- Continue desinflando até não ouvir mais a pulsação, este ponto de pressão irá corresponder a pressão mínima ou diastólica.
- 9- Continue a aliviar a pressão até desinflar completamente a braçadeira.

NOTA: Para uma ausculta mais sensível, recomenda-se a utilização do Estetoscópio Duplo, Duplo Cardiológico ou Rappaport da marca PREMIUM.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Evite choques!
- Não infle acima de 300 mmHg!
- Não exponha a braçadeira a radiação solar intensa.
- Não toque a braçadeira ou suas partes com materiais cortantes.
- Sempre desinfe completamente a braçadeira antes de guardá-la.
- Não desmontar o manômetro! Guarde o instrumento completo na bolsa fornecida.
- Limpe o manômetro, a pêra e a braçadeira com tecido suave levemente umedecido com água
- Este Esfigmomanômetro não deve ser utilizado em medições invasivas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Temperatura de Armazenagem: recomendada na faixa de 0°C a 35°C.
- Umidade Relativa do Ar de Armazenagem: máxima recomendada de 85%.
- Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg.
- Valor de Uma Divisão: 2 mmHg.
- Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente.
- Tolerância: +/- 3 mmHg.
- Tamanho da Braçadeira:(O modelo da braçadeira está especificado na embalagem do produto)

MODELO	TAMANHO BRAÇADEIRA (cm)	TAMANHO MANGUITO (cm)	CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO (cm)
Neonatal	18,5 x 5,5	4 x 8	7 – 13
Infantil	22,5 x 7,5	6 x 11	10 – 18
Adulto	52 x 14,5	12 x 22	18 – 35
Grande	62 x 17,5	14 x 31	27 x 45
Extra Grande	78 x 21	18 x 36,5	35 – 51

Observação: Braçadeiras aprovadas nas Portarias INMETRO/DIMEL nº 177, de 12 de Maio de 2009 e INMETRO/DIMEL nº 116, de 21 de Junho de 2019

Tabela 2 – Diretrizes e declaração de fabricante – imunidade eletromagnética - para todos os EQUIPAMNETO e SISTEMAS - Ensaios de Imunidade Conformidade Ambiente Eletromagnético			
Guia e Declaração do Fabricante - Imunidade Eletromagnética O Laringoscópio MD é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do Laringoscópio MD deve assegurar que ele seja utilizado conforme o ambiente.			
Teste de Imunidade	Nível de Teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético-Guia
IEC 61000-4-2 Descarga Eletrostática (ESD)	± 6 kV contato ± 8 kV ar	Conforme Conforme	O piso deve ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se o piso for coberto com material sintético, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%.
IEC 61000-4-4 Transiente Elétrico Rápido/Explosão	± 2 kV para linhas de corrente elétrica ± 1 kV para linhas de entrada / saída	Conforme	A qualidade da corrente elétrica deve ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-5 Surto de Tensão	± 1 kV linha(s) a linha (s) ± 2 kV Linha (s) para a terra	Conforme	A qualidade da corrente elétrica deve ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-11 Quedas, Curtas Interrupções e Variações de Tensão nas linhas de alimentação	<5% UT (> 95% de queda em UT) para 0,5 ciclo 40% UT (60% de queda em UT) para 5 ciclos 70% UT (30% de queda em UT) para 25 ciclos <5% UT (> 95% de queda em UT) por 5 s	<5% UT (> 95% de queda em UT) para 0,5 ciclo 40% UT (60% de queda em UT) para 5 ciclos 70% UT (30% de queda em UT) para 25 ciclos <5% UT (> 95% de queda em UT) por 5 s	A qualidade da corrente elétrica deve ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o usuário do Laringoscópio MD necessitar de funcionamento contínuo durante as interrupções de energia, recomenda-se que o Laringoscópio MD seja alimentado por uma fonte de alimentação contínua ou por bateria.
IEC 61000-4-8 Campo Magnético da Frequência da Corrente (50/60 Hz)	3 A/m	3 A/m	Os campos magnéticos da frequência de alimentação devem estar em níveis característicos de um ambiente hospitalar ou comercial típico.
NOTA: UT é a tensão CA da rede elétrica antes da aplicação do nível de teste.			

Tabela 4 – Diretrizes e declaração de fabricante – imunidade eletromagnética - para todos os EQUIPAMENTOS e SISTEMAS que não são de SUPORTE À VIDA.			
Guia e Declaração do Fabricante - Imunidade Eletromagnética O Laringoscópio MD é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do Laringoscópio MD deve assegurar que ele seja utilizado conforme o ambiente.			
Teste de Imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Guia
IEC 61000-4-6 RF Conduzida	3 Vrms 150 KHz a 80 MHz	3 Vrms	Equipamentos RF portáteis e móveis de comunicação não devem ser utilizados próximos a qualquer parte do Laringoscópio MD, incluindo cabos, menor que o afastamento recomendado calculado a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Afastamento recomendado: d = 1,2 √P d = 1,2 √P 80 MHz a 800 MHz d = 2,3 √P 800 MHz e 2,5 GHz Onde P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). Intensidades de campo de transmissores de RF fixos, conforme determinado por uma análise local eletromagnética, a deve ser menor do que o nível de conformidade em cada faixa de frequência. b Pode ocorrer interferência na proximidade de equipamento marcado com o seguinte símbolo: 
IEC 61000-4-3 RF Radiada	3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a maior gama de frequência. NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			
a. A intensidade de campo de transmissores fixos, tais como estações de base para rádio (celular / sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, uma pesquisa eletromagnética local deve ser considerada. Se a intensidade de campo medida no local em que o Laringoscópio MD é usado excede o nível de conformidade de RF aplicável acima, o Laringoscópio MD deve ser observado para verificar a operação normal. Se for observado desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como reorientação ou reposicionamento do Laringoscópio MD. b. Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade de campo deverá ser inferior a 3 V/m.			

Tabela 6 – Distância de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o EQUIPAMENTO ou SISTEMA – para EQUIPAMENTO e SISTEMA que não são de SUPORTE A VIDA			
Distância de separação recomendada entre equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis e o Laringoscópio			
O Laringoscópio MD é destinado ao uso em um ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF irradiadas são controladas. O cliente ou o usuário do Laringoscópio MD pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação RF portátil e móvel (transmissores) e o Laringoscópio MD como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.			
Potência de saída nominal máxima do transmissor / W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor / m		
	150 kHz to 80 MHz d=1,2√P	80 MHz to 800 MHz d=1,2√P	800 MHz to 2,5 GHz d=2,3√P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,70	11,70	23,30
Para transmissores com uma potência máxima de saída não listada acima, a distância d de separação recomendada em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a maior gama de frequência. NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			

NOTA	
Interferência Eletromagnética Aparelhos de Diatermia, RaioX, bem como equipamentos contendo motores de funcionamento intermitente produzem campos eletromagnéticos de grande intensidade. Portanto, esses aparelhos podem produzir interferências em circuitos eletrônicos que estejam nas vizinhanças, podendo fazê-los operar de modo errôneo.	
Minimizando os riscos de interferências eletromagnéticas Coloque seu aparelho o mais distante possível de outros aparelhos eletrônicos, bem como de objetos metálicos oblongos (canos, esquadrias metálicas), pois estes objetos podem atuar como antenas secundárias.	
Simbologia na embalagem	
Símbolo	Descrição
	Equipamento Energizado internamente, parte aplicada Tipo B.
	Siga as instruções de uso.
	Fabricante
	Importador e Distribuidor Autorizado no Brasil
	Este símbolo indica que lixo eletrônico não deve ser descartado em lixo comum doméstico. Procure um ponto de coleta de lixo eletrônico em sua região.
	Marca CE para dispositivos médicos.
	Número de lote do dispositivo.
	Data de fabricação
	Referência do produto

Simbologia no equipamento	
Símbolo	Descrição
	Equipamento Energizado internamente, parte aplicada Tipo B.
	Marca CE para dispositivos médicos
	Número de lote do dispositivo
	Marca de Certificação INMETRO

Garantia:
O Laringoscópio Convencional - MD possui garantia de um (1) ano após a data de entrega do aparelho ao usuário.
A garantia cobre defeitos de materiais construtivos e de fabricação.

A garantia será perdida caso ocorram: uso indevido ou em desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro dano.

Estão excluídas da garantia lâmpadas e pilhas. Durante o período de garantia serão efetuadas todos reparos e/ou trocas necessários sem nenhum custo adicional ao usuário.

Assistência Técnica:
Consulte a Assistência sobre quaisquer dúvidas sobre o funcionamento ou operação do instrumento, bem como reparos ou manutenção corretiva que venham a ser necessários.

Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.
Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, 270 – Atuba
CEP 82600-070 – Curitiba - Paraná
(41) 2102-8344
suporte@macrosul.com

 Atenção: Este produto não deve ser utilizado na presença de gases inflamáveis.

 Aviso: Este produto não deve ser imerso em líquidos.

 Descarte o equipamento e pilhas de forma segura. Procure o ponto de coleta de resíduos eletrônicos mais próximo da sua região



A marcação CE atesta que o produto foi fabricado em conformidade com as exigências das Diretrizes da União Europeia, cumprindo os requisitos de segurança indicados nas normas em vigor.



Medical Devices (Pvt) Ltd.
Paquistão.



Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397/0001-11.
Curitiba - Paraná - Brasil
ANVISA 80070210014.



Laringoscópio Convencional - MD



Agradecemos por adquirir o Laringoscópio Convencional - MD. Este produto é fabricado de acordo com os mais exigentes padrões de seleção dos materiais de fabricação e controle de qualidade total a fim de garantir qualidade insuperável e assegurar um aparelho de excelente desempenho e confiabilidade.

O operador deve ler com atenção e entender minuciosamente as instruções deste manual a fim de manter o desempenho durável e confiável do produto por período prolongado.

Após abrir a embalagem, primeiramente verifique todos os componentes em relação aos padrões especificados. Certifique de que a configuração do produto está completa e em perfeitas condições.

Indicação de Uso
O Laringoscópio Convencional - MD é um equipamento portátil utilizado por profissionais capacitados da área médica a fim de facilitar procedimentos de laringoscopia e a intubação endotraqueal e exames cuidadosos da garganta, através da iluminação e abertura da epiglote, utilizando lâminas (retas e curvas) de diferentes tamanhos que se adaptam às características anatômicas de cada paciente.
A configuração do produto é caracterizada por um cabo recartilhado para maior ergonomia e segurança, lâminas acetinadas para reduzir brilho e reflexão, alimentação por pilhas alcalinas ou bateria recarregável e iluminação por uma lâmpada que pode ser Xenon/Halógena ou LED.

Características
Oferecemos uma ampla linha de laringoscópios desde os modelos convencionais até os de fibra óptica. As mais famosas lâminas estão configuradas em diversos tamanhos e são feitas de aço inoxidável com acabamento acetinado (fosco) para redução de brilho e reflexão, aperfeiçoando ainda mais o seu desempenho e durabilidade. Os cabos são de aço inoxidável e estão disponíveis em 5 configurações.

As lâminas também podem ser de uso único, nos modelos Macintosh, Miller e McCoy, embaladas individualmente.

As lâminas do Laringoscópio Convencional MD são fabricadas a partir de aço inoxidável austenítico antimagnético 18/8, qualidade AISI 303/304, com baixíssima porcentagem de carbono o que lhe confere altíssima resistência à corrosão e superior comparada à dos demais aços inoxidáveis .

Os cabos MARK III Standard são fabricados e embalados em áreas ambientalmente controladas de partículas presente no ar, minimizando a possibilidade de contaminação e assegurando o desempenho pretendido. São fabricados a partir de materiais padronizados por diretivas internacionais para instrumentos médicos e cirúrgicos. Possuem superfície com acabamento seguro, livre de arestas e rebarbas. Possuem sistema de travamento de acordo com os padrões internacionais de intercambiabilidade com as lâminas, assegurando um engate preciso e seguro.

Em conformidade com a norma ISO 7376, que dispõe os requisitos gerais para laringoscópios utilizados para intubação e especifica as dimensões críticas dos cabos e da lâmpada do encaixe do cabo à lâmina. A norma aborda ainda as especificações para a intercambiabilidade de lâminas e cabos.

Como usar as Lâminas Flexi-tip
Não force a alavanca da lâmina ao desengatá-la do cabo. Não aplique pressão nas direções mostradas na (Fig. 1), pois pode forçar a lâmina e alavanca-la para fora.
Ao engatar a lâmina no cabo, tenha cuidado para não ocorrer nenhum dano, pois caso contrário, pode resultar em ação incorreta ou rigidez à ponta flexível. A lâmina Flex-tip deve ser engatada no cabo de modo usual. A alavanca que movimenta a ponta da lâmina pode então ser acionada com a palma da mão em direção ao cabo.
Nenhum contato com a alavanca deve ser feito durante o estágio inicial de uso, ou seja, até que a ponta do laringoscópio tenha sido inserida na valécua epiglótica.
Uma vez que este estágio tenha sido alcançado, o movimento da alavanca em direção ao cabo elevará a ponta da lâmina e, portanto, elevará a epiglote, sem a necessidade de aumentar a força exercida pela parte principal da lâmina. Libere a alavanca antes de retirar a lâmina da laringe do paciente.

Instruções de Uso

1. Coloque pilhas (consulte a tabela de acessórios para certificar o tamanho das pilhas) no interior do cabo e rosqueie a tampa da extremidade do cabo no sentido horário.
2. Engate a lâmina através do alinhamento da ranhura da sua base sobre o eixo na parte superior do cabo, aplique uma força suficiente e puxe até a posição horizontal, obtendo o encaixe sob pressão (Fig.2). Neste momento a lâmpada acende, proporcionando uma iluminação em feixe necessária para a realização do procedimento por profissional capacitado.
3. Verifique sempre se a intensidade luz fornecida é satisfatória para a realização do procedimento, caso contrário troque as pilhas.
4. Para trazer a lâmina à posição de repouso, sem iluminação, aplique força para baixo.
5. Para retirar a lâmina do cabo, aplique força para baixo e empurre a base da lâmina para Cima com o seu dedo polegar. Encaminhe para higienização e assepsia.

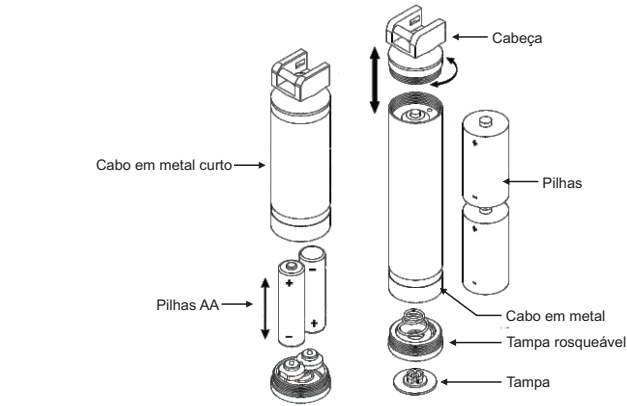
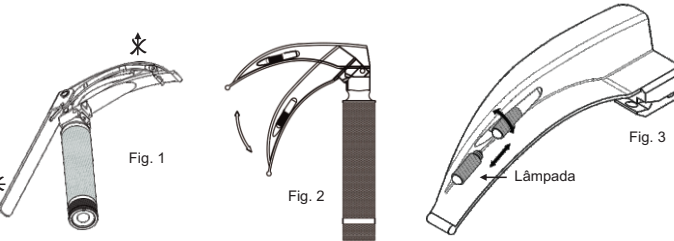


Fig. 4

Substituição da lâmpada

1. Desrosqueie a lâmpada girando-a no sentido anti-horário até soltá-la (Fig. 3).
2. Substitua por uma nova e rosqueie no sentido horário até ficar bem firme.
3. Certifique de que a lâmpada está adequadamente rosqueada.

Substituição das pilhas

1. Desrosqueie a tampa inferior do cabo e remova as pilhas (Fig. 4).
2. Para maior longevidade, recomenda-se o uso de pilhas alcalinas. Pilhas de carbono comum também podem ser usadas.
3. Substitua com pilhas de tamanho apropriado e certifique-se de que os polos + e - estejam posicionados corretamente.
4. No cabo Curto, insira uma pilha com o polo (+) para baixo e a outra pilha com o polo (+) para cima. Se a iluminação falhar, verifique se as polaridades das pilhas estão inseridas corretamente.
5. Reinstale a tampa inferior do cabo.

Pilhas são resíduos tóxicos ao meio ambiente e devem ser descartadas de acordo com os regulamentos locais. Procure o ponto de coleta mais próximo de sua região.

Armazenamento e Conservação

Não permita que o equipamento receba choques mecânicos, pois pode prejudicar a funcionalidade do mesmo. Armazene-o em local limpo e seco.
Condições de Operação: 10°C a 40°C; umidade entre 30% a 75%; 700hPa – 1060hPa.
Condições de Armazenamento e Transporte: -20°C a 60°C; umidade entre 10% a 90% (sem condensação); 500hPa – 1060hPa.

Cuidados e Manutenção

Remova as pilhas e baterias antes do procedimento de limpeza.

LÂMINAS

1. Limpeza

Imediatamente após o uso, o laringoscópio deve ser lavado em água corrente fria até que toda sujeira visível seja removida. Assegure-se que todas as áreas de difícil alcance sejam lavadas com água corrente. Mergulhe o conjunto do laringoscópio selado em uma solução enzimática de limpeza preparada de acordo com as recomendações do fabricante, por no mínimo dois minutos. Retire o dispositivo da solução e enxágue com água corrente morna por no mínimo 1 minuto para remover todos os resíduos e sujeiras visíveis. Em seguida mergulhe o dispositivo em detergente enzimático. Remova a tampa inferior e escove minuciosamente utilizando uma escova macia de nylon, assegure-se de que todas as áreas de difícil acesso sejam alcançadas e os resíduos sejam removidos. Seque com um tecido limpo e livre de fiapos ou tecido estéril. A limpeza adequada dos instrumentos é um processo crítico e necessário antes da desinfecção e esterilização. Pros siga com a desinfecção de alto nível ou procedimento de esterilização.

⚠ A limpeza por equipamento de ultrassom é estritamente proibida.

2. Desinfecção

A imersão em solução termoquímica em um esterilizador até o máximo de 65°C pode promover a desinfecção. Neste caso, as recomendações do fabricante quanto à duração e concentração da solução, devem ser rigorosamente respeitadas. Após a desinfecção, enxágue abundantemente em água estéril e seque com um tecido seco, limpo e livre de fiapos.

3. Imersão em Soluções Frias

Para obter alto nível de desinfecção, soluções de Cidex® OPA ou glutaraldeído a 2,4% podem ser usadas de acordo com as instruções do fabricante. Seque com um tecido limpo e livre de fiapos ou tecido estéril. Monte todas as partes, coloque as pilhas no cabo e teste se o sistema está funcionando adequadamente. Caso não funcione, verifique abaixo as instruções de teste da pilha/lâmpada.

⚠ **NÃO imergir as lâminas em soluções com água sanitária, produtos a base de iodo (PVPI – polivinilpirrolidona) ou hidróxido de potássio.** Essas soluções danificam gravemente o instrumento. Também evite o contato metal com metal após a imersão, as lâminas devem ser enxaguadas com água estéril para remover resíduos químicos e secas com um tecido limpo, livre de fiapos ou tecido estéril.

4. Esterilização

Antes de realizar qualquer procedimento a seguir, as lâminas devem ser limpas como descrito no procedimento de limpeza.

4.1. Esterilização a gás

A esterilização a gás por óxido de etileno a temperatura máxima de 65°C e pressão de 8 psi pode ser realizada. Este método de esterilização é preferivelmente recomendável quando a esterilização é realizada com frequência.

4.2 Esterilização a vapor

A esterilização a vapor também pode ser realizada. Insira o dispositivo em um envelope de autoclave apropriado.

Deslocamento De Vapor Por Gravidade		
Temperatura	121°C (250°F)	132°C (270°F)
Tempo do ciclo	30 min	4min
Tempo de secagem	15 min	20 min

Nota: não exceder a temperatura de 135°C e a pressão de 28 psi.

Os métodos de esterilização flash (ou “ciclo flash”) de autoclaves e esterilização através do calor seco por ar quente (estufa) devem ser evitados, pois esses processos danificam o instrumento.



4.3 Sistema de Esterilização Steris Amsco V-Pro

Lâminas e cabos do Laringoscópio Convencional - MD são compatíveis com:

Sistema de esterilização por temperatura Amsco V-Pro 1 Low

Sistema de esterilização por temperatura Amsco V-Pro 1 Plus Low

Sistema de esterilização por temperatura Amsco V-Pro 1 Pro Max

4.4 Esterilização por Plasma de Peróxido de Hidrogênio Sterrad

Lâminas e cabos do laringoscópio Convencional MD são compatíveis com:

Sistema Sterrad 100NX (Ciclo Padrão e Expresso)

Sistema Sterrad NX (Ciclo Padrão)

Sistema Sterrad 1005 e 200 (Ciclo Curto fora US)

Sistema Sterrad 50

CABOS

1. Limpeza e Esterilização

A esterilização dos cabos por imersão em soluções frias ou em autoclave deve seguir as mesmas recomendações descritas para a lâmina. Entretanto, as pilhas e a lâmpada devem ser removidas antes da desinfecção e esterilização. O cabo pode ser exposto ao óxido de etileno (ETO). A lâmpada pode ser limpa com algodão embebido em álcool isopropílico. O cabo principal e a tampa inferior também podem ser expostos ao óxido de etileno.

⚠ **Não permita que nenhum excesso de fluido infiltre-se nos contatos elétricos. As pilhas devem ser removidas antes da limpeza e esterilização.**

Teste de Manutenção Periódica do Cabo e Lâmina

As lâminas e o cabo do laringoscópio devem sempre ser testados após os procedimentos de limpeza, desinfecção, esterilização e antes do uso. Para testar conecte a lâmina ao cabo e puxe a lâmina para cima, na posição LIGA, como na (Fig.2). Se a luz falhar ou piscar, verifique a lâmpada, pilhas e os contatos elétricos. Certifique-se da instalação adequada das peças de reposição como lâmpadas e pilhas. Se o problema persistir, por favor entre em contato com o Suporte Técnico.

Aviso:

As instruções de esterilização listadas acima, fornecidas por Medical Devices Ltd, destinam-se a procedimentos compatíveis com materiais específicos. A esterilização deve ser realizada conforme o protocolo hospitalar ou institucional aprovado. A Medical Devices Ltd não pode garantir a esterilização. A validação da esterilização é de responsabilidade do hospital, instituição e/ou pelo fabricante do equipamento de esterilização.

Acessórios e peças sobressalentes

- Estojo macio para 5 lâminas e 1 cabo MARK III Standard - MD
- Estojo rígido para laringoscópio - MD
- Lâmpada Vacuum 2.5V Rosca Pequena para Laringoscópio Convencional - MD
- Lâmpada Vacuum 2.5V Rosca Grande para Laringoscópio Convencional - MD
- Lâmpada LED 2.5V Rosca Pequena para Laringoscópio Convencional - MD
- Lâmpada LED 2.5V Rosca Grande para Laringoscópio Convencional - MD
- Lâmpada Xenon/Halógena 2.5V Rosca Pequena para Laringoscópio Convencional - MD
- Lâmpada Xenon/Halógena 2.5V Rosca Grande para Laringoscópio Convencional - MD

Especificações Elétricas

Tensão de Alimentação	- Cabo Médio: 2 Pilhas tipo C 2,5 V - Cabo Pequeno e Cabo Curto: 2 Pilhas tipo AA 2,5 V
Tipo de proteção contra choque elétrico	Energizado internamente
Grau de proteção contra choque elétrico	Tipo B
Grau de proteção contra penetração de líquidos	IPX0
Modo de operação	Contínuo
Não adequado na presença de mistura anestésica inflamável.	

Lâminas Convencional - MD Disponíveis		
Modelo	Tamanho	Característica
Macintosh	0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5	• Lâmina curva • Autoclavável até 134°C por até 4.000 ciclos
Miller	00/ 1/ 2/ 3/ 4	• Lâmina reta • Autoclavável até 134°C por até 4.000 ciclos
McCoy Flexi-Tip	2/ 3/ 4	• Lâmina curva com ponta articulável • Autoclavável até 134°C por até 4.000 ciclos • Ponta articulável projetada contra belisco • Canal da lâmina desenvolvido para melhor visualização da epiglote

Cabos Convencional Mark III Standard - MD Disponíveis		
Modelo	Alimentação	
Cabo médio Standard Mark III tipo C 2.5V	2 pilhas Tipo C	
Cabo pequeno Standard Mark III tipo AA 2.5V	2 pilhas Tipo AA	
Cabo curto Standard Mark III tipo AA 2.5V	2 pilhas Tipo AA	

Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões Eletromagnéticas		
Tabela 1 – Diretrizes e declaração de fabricante Emissões Eletromagnéticas – para todos os EQUIPAMENTOS e SISTEMAS		
O Laringoscópio MD é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do Laringoscópio MD deve assegurar que ele seja utilizado conforme o ambiente.		
Teste de emissão	Conformidade	Ambiente Eletromagnético – Orientação
CISPR 11 - Emissões de Radiofrequência (RF)	Grupo 1	O Laringoscópio MD utiliza energia de RF apenas para o seu funcionamento interno. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e é improvável que causem qualquer interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
CISPR 11 - Emissões de Radiofrequência (RF)	Classe B	O Laringoscópio MD é adequado para uso em todos os estabelecimentos, incluindo ambientes domésticos e locais conectados diretamente à rede elétrica de baixa tensão que fornece energia a edifícios usados para fins domésticos.
IEC 61000-3-2 - Emissões Harmônicas	Classe B	
IEC 61000-3-3 - Flutuações de tensão/ Emissões com tremulação	Conforme	

MANUAL DE INSTRUÇÕES
BOMBA DE INFUSÃO
MODELO SP750

Sumário

Capítulo 1 Breve Introdução	3
1.1 Geral	3
1.2 Recursos	3
1.3 Especificação técnica	4
1.4 Introdução de peças e botões da bomba	5
1.5 Embalagem	7
Capítulo 2 Instalação	9
2.1 Requisitos do local	9
2.2 Instalação para suporte	9
2.3 Preparação antes de operar	9
2.3.1 Instalação do conjunto IV	9
Capítulo 3 Operação da bomba	11
3.1 Seleção para o modo de energia	11
3.2 Opere a bomba	11
3.3 “A infusão terminará! ” e estado "KVO"	13
3.4 Alarme de bolhas de ar	13
3.5 Alarme de pressão (oclusão)	14
3.6 Alarme de porta aberta	14
3.7 Alternar para o modo de energia	15
Capítulo 4 Iniciar e parar de infundir	16
4.1 Ligue a bomba	16
4.2 Configuração para volume total	16
4.3 Configuração para taxa de infusão	16
4.4 Tipo de conjunto IV	17
4.5 INICIAR / PARAR a bomba	17
4.6 Eliminar alarme	18
4.7 “A infusão terminará! e estado "KVO"	19
Capítulo 5 Função de infusão	21
5.1 Limpar volume infundido	21
5.2 Acumulação de volume infundido	21
5.3 Alterar "VOLUME TOTAL" durante a infusão	21

5.4 BOLUS.....	21
5.5 Troque o frasco de infusão durante a infusão.....	22
5.6 Paciente em movimento.....	22
5.7 Ruído e Calor	22
Capítulo 6 Configuração do sistema.....	23
6.1 Limiar de pressão.....	23
6.2 Calibração de taxa.....	24
6.3 Idioma	24
6.4 Som do botão	25
6.5 Redefinir.....	25
Capítulo 7 Calibração para o conjunto IV	26
7.1 Precisão de infusão.....	26
7.2 IV Definir Requisitos	26
7.3 Seleção do conjunto IV	26
7.4 Calibração para o conjunto IV	27
Capítulo 8 Manutenção	28
8.1 Limpeza e Desinfecção	28
8.2 Manutenção periódica.....	28
8.2.1 Inspeção da taxa de infusão	28
8.2.2 Inspeção e manutenção de bateria embutida	28
8.3 Tratamento sem poluição e reciclagem.....	29
8.4 Eliminação e reciclagem do conjunto IV.....	29
Capítulo 9 Características da infusão	30
9.1 Características de precisão.....	30
9.2 Características de resposta à oclusão.....	31
9.3 Conjunto IV recomendado e componente de infusão.....	31
Capítulo 10 Compatibilidade e interferência EMC	32
Apêndice I Explicação dos alarmes do sistema.....	34
Apêndice II Diretriz da EMC e declaração do fabricante	35

Prefácio

Avisos importantes

Antes de operar a bomba, leia este manual com atenção.

Guarde bem este manual para uso posterior.

O Manual do Usuário é completamente compilado de acordo com as normas IEC60601-2-24-2012, IEC 60601-1: 2012 e IEC 60601-1-8: 2012. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Devido às atualizações do produto, o dispositivo que você recebeu pode não ser totalmente consistente com a descrição neste Manual do Usuário. Lamentamos sinceramente por isso.

Sobre este manual

Este manual apresenta principalmente o seguinte conteúdo:

- Visão geral, descrições de funções e especificações técnicas.
- Métodos de instalação e teste.
- Procedimentos de operação para a bomba e menu principal, procedimentos de calibração para o conjunto IV.

Precauções de segurança

 Aviso 

- A bomba não pode ser operada por pessoas que não a conhecem.
- A bomba deve estar adequadamente aterrada.
- A bomba só pode ser usada para infusão geral, evite usá-la para infundir sangue ou outras situações.
- Durante o uso, verifique regularmente o volume residual e o tubo de ajuste IV, e não é recomendável confiar completamente nas funções de alarme.
- Evite usar a bomba em estado de alarme e elimine o alarme antes de continuar usando.
- Não reutilize ou desinfete os conjuntos de infusão de uso único. Os conjuntos de infusão usados devem ser descartados seguindo os métodos apropriados.
- Evite usar a bomba em ambiente com objetos inflamáveis.
- Opere a bomba na faixa de 120 cm da altura do coração do paciente.
- Somente os componentes, conectores e produtos descartáveis em conformidade com as normas nacionais podem ser usados no sistema. Consulte o seu revendedor para obter informações relevantes.
- A precisão da infusão não é confiável se for utilizado um conjunto IV não calibrado.
- A bomba é um sistema que fornece pressão positiva, pode produzir pressão líquida positiva para superar a resistência ocorrida no processo real, incluindo a resistência produzida por pequenos cateteres e filtros, o que é conveniente para injeção intravenosa. Como o uso de filtros durante a infusão não é considerado, a bomba não

fornece a função de verificar o filtro e não dispara o alarme sob a condição de usar filtros.

Atenção:

- Verifique se a bomba está firmemente conectada ao poste de infusão para evitar o risco de queda.
- Antes de operar, verifique se o pipeline do conjunto IV está desbloqueado e instalado corretamente.
- Certifique-se de que não há bolhas de ar no conjunto IV, caso contrário, use o modo "Bolus" ou remova manualmente as bolhas.
- Quando a bomba estiver trabalhando continuamente por mais de uma hora, para garantir alta precisão de infusão, mova a tubulação extrudada entre a bomba peristáltica e a placa de pressão para evitar que a mesma posição seja pressionada por muito tempo.
- Não coloque o equipo extrudado entre os transdutores de ultrassom, caso contrário, pode causar um alarme errado por bolhas de ar.
- A bomba é calibrada para precisão com água destilada, viscosidade e proporção da solução podem influenciar a precisão da infusão.
- A bomba para de infundir sob condições de alarme, exceto os alarmes "Infusão terminada!", "KVO" e "Bateria fraca". O monitoramento periódico deve ser realizado para garantir que a bomba funcione conforme o esperado.
- Recomenda-se ajustar o volume de infusão em 15 ml abaixo do volume real de líquido, caso contrário, todo o líquido na tubulação poderá ser injetado e o dispositivo alertará quanto a bolhas de ar.
- Antes de trabalhar com a bateria interna, verifique a bateria para garantir que ela tenha energia suficiente. Carregue o dispositivo, se necessário.
- Quando o dispositivo é alimentado apenas por bateria, uma bateria totalmente carregada pode fornecer 4 horas de trabalho contínuo com a velocidade da bomba de 25 ml / h, mas o tempo de trabalho não pode ser garantido se a bateria estiver danificada ou totalmente carregada. Por favor, não use injeção rápida no estado de bateria fraca.
- Se a bomba funcionar de maneira anormal e o motivo não for claro, pare a infusão e relate o erro (incluindo as informações dos componentes da infusão, quantidade da infusão, taxa de infusão, número da máquina, tipo de líquido infundido etc.) ao distribuidor ou fabricante que vendeu o produto para você.
- Nossa empresa pode fornecer diagramas de circuitos, listas de componentes, desenhos, especificações de calibração e outros materiais, conforme solicitado, para ajudar o pessoal técnico qualificado na manutenção do dispositivo.

Capítulo 1 Breve Introdução

1.1 Geral

O produto é uma bomba de infusão volumétrica com alta segurança e longa vida útil. É fácil de operar. Seu controle de vazão de alta precisão e medidas abrangentes de alarme garantem a segurança do paciente e o efeito do tratamento satisfeito.

A bomba de infusão foi projetada para uso em enfermagem clínica, onde é necessária uma infusão precisa.

Medidas especiais de segurança incluem:

- O grampo do conjunto IV evita o fluxo livre de líquido se a porta da bomba abrir acidentalmente.
- O detector de bolhas de ar de alta precisão impede que as bolhas de ar entrem no corpo do paciente.
- O sensor de pressão pode detectar o bloqueio da tubulação a jusante.
- Quando o alarme de bloqueio de alta pressão aparece, o sistema A.B.S para de infundir imediatamente e elimina automaticamente a pressão no conjunto IV, para evitar o desaparecimento repentino de obstruções, causando injeção transitória de altas doses.
- Os parâmetros de infusão durante a infusão são protegidos contra alterações arbitrárias.
- Contraindicações: É proibida a infusão de sangue.

1.2 Recursos

- 1) Entrega de fluidos de alta precisão, para alcançar o efeito ideal de infusão;
- 2) Compatível com vários conjuntos IV padrão;
- 3) 2,8" display LCD;
- 4) O tempo residual pode ser exibido durante a infusão;
- 5) Com função de lembrete quando começar a infundir;
- 6) Alarme para oclusão, bolha de ar, porta aberta e motor anormal;
- 7) O limiar de alarme de pressão pode ser ajustado pelo pessoal médico;
- 8) O grampo do conjunto IV evita que o líquido flua livremente se a porta da bomba abrir acidentalmente;
- 9) A.B.S - SISTEMA ANTI BOLUS previne o desaparecimento repentino de obstruções, causando injeção transitória de altas doses;
- 10) Pare a infusão automaticamente se os alarmes ("Infusão finalizada!", "KVO" e "Bateria fraca forem excluídos);
- 11) Energia fornecida por energia CA externa e bateria de lítio embutida.

1.3 Especificação técnica

Tipo	Bomba de infusão volumétrica
Taxa de bolus	699 mL/h
Faixa de taxa de infusão	1 mL/h~699 mL/h, incremento 1 mL/h
Intervalo de volume predefinido	1 mL~9999 mL, incremento 1 mL
Precisão	±5%
Taxa KVO	1 mL/h
Exibir informações	☐ Taxa de infusão ☐ Volume total ☐ Volume infundido ☐ Tempo residual
Alarmes	☐ Infusão pronta ☐ Porta aberta ☐ Oclusão ☐ Bolhas de ar ☐ Falha do motor ☐ A infusão terminará! ☐ Estado KVO ☐ Bateria Fraca ☐ Bateria esgotada
Detecção de pressão de oclusão	100 kPa~300 kPa
Classificação de segurança	Classe I, tipo BF
Classificação de proteção	IPX2
Modo de trabalho	Operação contínua
Fonte de energia	AC100~240 V, 50/60 Hz
Bateria	Bateria recarregável de íon de lítio, 7,4 V / 5000 mAh
Carregamento da bateria	Quando a bomba está conectada à energia CA, a bateria pode ser carregada automaticamente e leva 8 h ~ 12 h para carregar completamente.
Operação contínua	A bomba pode trabalhar continuamente por mais de 4 horas com a taxa de infusão de 25 mL / h depois de totalmente carregada.
Peso máximo	Cerca de 1,9 kg
Dimensão	143,6 mm (C) × 151,8 mm (L) × 195,3 mm (A))
Ambiente de trabalho	☐ Temperatura: +5 °C~+40 °C ☐ Humidade relativa: 20%~90% ③ pressão atmosférica: 860 hPa~1060 hPa
Ambiente de armazenamento	☐ Temperatura ambiente: -30 °C~+55 °C ☐ Humidade relativa: 5%~96% ☐ Pressão atmosférica: 500 hPa~1060 hPa ☐ Nenhum gás corrosivo ☐ Bem ventilado
Conjunto IV aplicável	O conjunto de infusão de bomba descartável fabricado pela Shinva Ande Healthcare Apparatus Co., Ltd.


1.4 Introdução de peças e botões da bomba



Figura 1-1 Vista frontal

N°.	Nome	Descrição
1	Alça	Conveniente para transportar
2	Indicador de estado de trabalho	É verde quando a bomba funciona normalmente e vermelho quando o alarme é exibido.
3	Porta da bomba	Corrija o conjunto de IV.
4	Botão de seleção	No menu na parte inferior da tela, pressione-o para executar a seleção de operação do lado direito.
5	Botão de seleção de cursor ou número	Se você precisar inserir números, pressione o botão ACIMA ou ABAIXO para selecionar. Em outros momentos, é usado como botão de seleção do cursor.
6	Indicador de energia e carregamento	Indique o tipo de energia: Amarelo: quando a bomba funciona apenas com bateria; Verde: quando a bomba trabalha com energia externa; Verde (indicador de carregamento): no estado de carregamento.
7	Botão de alarme de limpeza/Confirmar	Confirme a seleção atual ou limpe o alarme
8	Ligue/Desligue	Pressione e segure para ligar ou desligar a bomba
9	BOLUS	É usado para enxaguar o conjunto intravenoso antes da infusão; Este botão é proibido de usar durante o processo de infusão; Quando a infusão for suspensa, pressione-a para infundir rapidamente com a taxa de infusão de 699mL / h.
10	Iniciar/parar	No menu principal, pressione-o para iniciar ou interromper a infusão.

11	Trava para porta da bomba	Abra a porta da bomba quando a levantar.
----	---------------------------	--

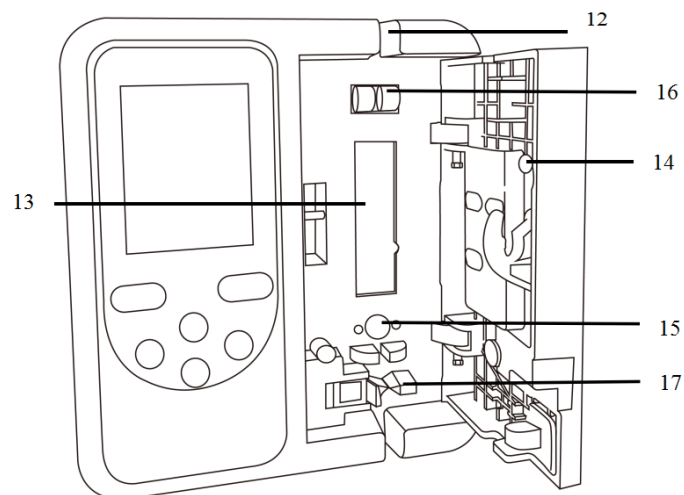

Figural-2 Vista interna da porta da bomba

N°.	Nome	Descrição
12	Slot para conjunto IV	Corrija o conjunto de IV.
13	Bomba peristáltica de dedo	Aperte o conjunto de IV e controle a taxa de fluxo.
14	Sensor da porta	Detectar o estado da porta da bomba (abrir ou fechar) durante a infusão.
15	Sensor de pressão	Detectar se há oclusão no equipo a jusante durante a infusão.
16	Detector de bolhas de ar	Detectar se há bolha de ar no conjunto IV durante a infusão.
17	Braçadeira IV	Quando a porta está aberta, o grampo irá apertar o conjunto IV imediatamente para evitar o fluxo de líquido. Quando está fechado, o grampo do conjunto IV se abre automaticamente e o líquido pode fluir.

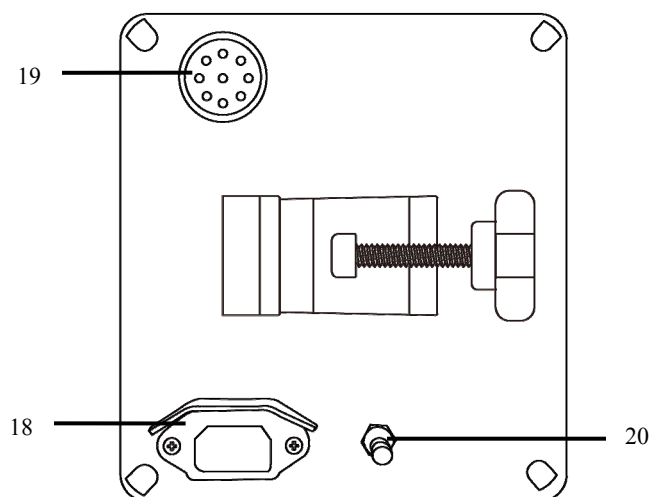


Figura 1-3 Visão de trás

Nº.	Nome	Descrição
18	Tomada do cabo de alimentação	Conecte com o cabo de alimentação CA
19	Alto falante	Para fazer alarmes sonoros
20	Terminal de aterramento	Para conectar com o fio terra

1.5 Embalagem


Configuração padrão:

- (1) Uma bomba de infusão
- (2) um cabo de alimentação
- (3) Um manual do usuário:

🔔 Se faltar alguma peça na embalagem, entre em contato imediatamente com o revendedor.

Símbolos

Símbolo	Descrição
	Peça aplicada tipo BF
IPX2	Grau de proteção contra a entrada de líquido
	Consulte o manual de instruções / livreto
	WEEE (2002/96/EC)

	Equipotencialidade
	Representante Europeu
	Fabricante
	Data de fabricação
	Número de série
	Fluxo de líquido para infusão
	Limitação de temperatura de transporte: -30 °C ~ + 55 °C
	Limitação de umidade de transporte: 5% ~ 96%
	Dessa forma
	Frágil, manuseie com cuidado
	Manter longe da chuva
	Limite de empilhamento por número (8 camadas)
	Corrente alternada

Capítulo 2 Instalação

2.1 Requisitos do local

O cabo de alimentação deve ser conectado a uma tomada com três pinos (um fio é o fio terra), a fonte de alimentação é AC100 ~ 240 V, 50/60 Hz. Não coloque a bomba em ambiente com líquido ou gás inflamável. A bomba deve ser operada dentro de uma faixa de temperatura de 5 °C a 40 °C. Não opere a bomba perto de equipamento que emita radiação eletromagnética de alta frequência (como unidade cirúrgica de alta frequência ou equipamento de cauterização), para evitar alarmes falsos.

 Aviso 

Evite abrir o gabinete para ajustar ou manter a bomba sob condições de manutenção, a manutenção necessária deve ser realizada por engenheiros de serviço qualificados, autorizados pelo fabricante.

2.2 Instalação para suporte

O suporte permite a montagem da bomba em um poste de infusão especial. O local da instalação fica na parte traseira da bomba.

 Aviso 

Antes de instalar a bomba no polo de infusão, verifique a estabilidade do polo de infusão.

2.3 Preparação antes de operar

- 1) Abra a embalagem.
- 2) Instale a bomba no poste de infusão móvel ou coloque-a sobre uma mesa.
- 3) Conecte o cabo de alimentação a uma tomada CA aterrada.
- 4) Insira o conjunto IV na bomba.
- 5) A câmara de gotejamento do conjunto IV deve ser colocada aproximadamente 10 cm acima da bomba,
e o grampo do rolo deve estar sob a bomba de infusão.

Atenção:

Se a bomba for recebida ou não for usada por um longo período, conecte-a à energia CA e aguarde 5 minutos antes de operar (a bateria deve ser carregada completamente antes de usar a bateria como fonte de alimentação).

Quando a bomba é transportada do ambiente em que a temperatura está abaixo de 0 °C para a sala, opere-a após 15 minutos.

2.3.1 Instalação do conjunto IV

Os passos são os seguintes:

- 1) Antes de instalar o conjunto IV, selecione o tipo de conjunto IV de acordo com a bomba de infusão.
- 2) Fixe a bomba no suporte.

- 3) Prepare-se para o conjunto intravenoso e o frasco de infusão, pendure o frasco no bastão de infusão.
- 4) Injete líquido na câmara de gotejamento até o nível de um terço.
- 5) Ajuste o grampo do rolo para deixar o líquido fluir e descarregue todo o ar da tubulação.
- 6) Ajuste o grampo do rolo para interromper o fluxo livre.
- 7) Levante a trava da porta para abrir a porta da bomba.
- 8) Verifique se a câmara de gotejamento se localiza acima da bomba e se a direção da infusão é de entrada de líquido, não de direção de saída.
- 9) Pressione o conjunto de IV no detector de bolhas de ar e na ranhura da guia e prenda firmemente o conjunto de IV pelo grampo do conjunto de IV.
- 10) Feche a porta da bomba e trave-a.
- 11) Abra o grampo do rolo completamente e verifique se não há fluxo de líquido.
- 12) O fluxo de fluido será controlado pela bomba de infusão.

Atenção:

- Antes de iniciar a infusão, a quantidade total de infusão deve ser limpa para evitar o acúmulo de volume de infusão anterior e causar alarmes.
- Para reduzir o erro de infusão na extrusão prolongada da bomba peristáltica digital, a posição do tubo de infusão deve ser alterada a cada uma hora.
- A bomba é calibrada pelo conjunto de infusão descartável da bomba fabricado pela Shinva Ande Healthcare Apparatus Co., Ltd. Se forem utilizados outros tipos de conjuntos de infusão que atendem ao padrão nacional, consulte o manual do usuário para obter os parâmetros e a calibração de precisão antes de usar.
- Se a tubulação estiver equipada com um conector deslizante, isso resultará em uma conexão frouxa.
- A precisão da infusão pode ser influenciada pela viscosidade e proporção da solução.

Desmontagem do conjunto IV

Os passos são os seguintes:

- 1) Feche o grampo do rolo e abra a porta da bomba.
- 2) Retire o conjunto IV do grampo e feche a porta da bomba.
- 3) Desligue a bomba.

Capítulo 3 Operação da bomba

3.1 Seleção para o modo de energia

Dois modos de fonte de alimentação são suportados, o que é conveniente para uso:

Em geral, você pode usar o AC100 ~ 240 V, 50/60 Hz como fonte de alimentação. A bateria interna pode fornecer energia suficiente para uso emergencial a um curto período de tempo ou curta distância.

Quando a bomba está conectada a uma fonte de alimentação externa, a bateria de lítio interna pode ser carregada, independentemente de o dispositivo estar ligado ou não. Nós não fornecemos equipamentos de carregamento externo, a bateria de lítio só pode ser carregada dentro do dispositivo. Ao usar uma fonte de alimentação externa, em caso de falha repentina de energia, o sistema alterna automaticamente para a energia da bateria interna, para que a bomba possa funcionar sem interrupção.

Independentemente do modo escolhido, nosso produto pode fornecer uma infusão precisa.

Atenção:

- Quando a bomba trabalha com a bateria interna e a energia da bateria é menor que o seu terço (, não infundir com uma taxa superior a 300 mL / h. Como a bateria fraca pode causar uma taxa de infusão real mais baixa do que a configuração.
- A bateria interna é uma fonte de alimentação de emergência, a taxa de infusão na fonte de alimentação da bateria deve ser menor que 500 mL / h. Para garantir a precisão da infusão normal, use uma fonte de alimentação externa.
- Quando o dispositivo estiver conectado à rede elétrica, deve ser garantido o aterramento confiável do fio terra da rede elétrica ou do terminal terra do dispositivo. Em caso de dúvida, o dispositivo deve ser operado por uma fonte de energia interna.

3.2 Opere a bomba

Conecte a energia

Após conectar-se à fonte de alimentação CA, o indicador de energia acende em verde, o que significa que o dispositivo está no estado de fonte de alimentação CA. Pressione o botão ON / OFF para ligar a bomba e ela entra no menu principal, como mostra a Figura 3-1:

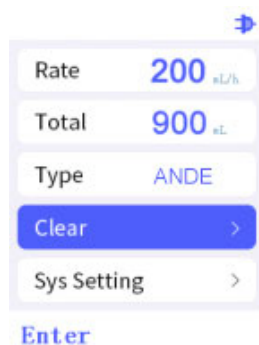


Figura 3-1 Menu principal

Defina a taxa de infusão e o volume total e comece a infundir:

No menu principal, quando a opção "Taxa" estiver selecionada, pressione  para entrar em sua interface de configuração, como mostra a Figura 3-2:

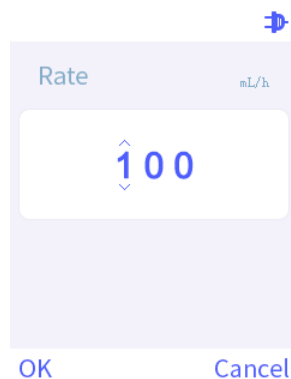


Figura 3-2 Interface de configuração de taxa

Pressione o botão ESQUERDO ou DIREITO para selecionar e use o botão ACIMA ou ABAIXO para alterar o valor.

Depois disso, pressione  para retornar ao menu principal ou pressione  para cancelar a configuração e retornar ao menu principal.

Pressione  para iniciar o processo de infusão, os três indicadores de estado de funcionamento acendem alternadamente. À medida que o volume da infusão aumenta, o tempo restante diminui. Pressione o botão INICIAR / PARAR novamente, a infusão é interrompida.

Como Figura 3-3:

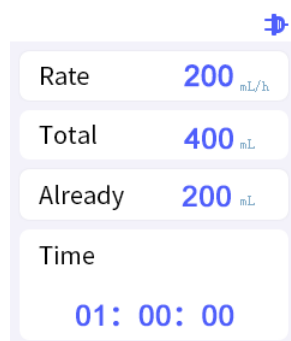


Figura 3-3 Interface de infusão

Função de memória

Se a bomba parar ou desligar durante a infusão, a taxa de infusão, o volume e o volume infundido serão memorizados; quando o dispositivo for reiniciado, ele poderá continuar funcionando.

3.3 “A infusão terminará!” e estado "KVO"

O estado KVO refere-se a isso, depois que a bomba termina a infusão de volume total (quando o volume infundido é igual ao volume total), para manter a veia aberta, a bomba ainda continua a infusão em uma taxa muito lenta.

Três minutos antes de terminar a infusão, a bomba dispara um alarme a cada 20 segundos, os indicadores de estado de funcionamento ficam acesos em verde e a mensagem "Infusão terminará!" aparece na tela.

Após a conclusão da infusão, a bomba passa para o estado KVO automaticamente e a mensagem "Entre no modo KVO" aparece na tela. A taxa de infusão nesse estado é a taxa KVO predefinida.

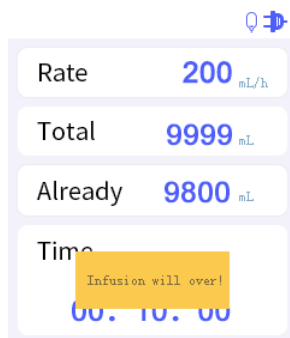


Figura 3-4 A infusão terminará

3.4 Alarme de bolhas de ar

- 1) Defina a taxa de infusão para 500 mL / h.
- 2) Pressione  para começar a infundir. Agite o conjunto IV para fazer bolhas de ar artificialmente e observe o dispositivo, os indicadores de estado de funcionamento devem ficar vermelhos e tremeluzem e a mensagem "Bolha de ar no tubo IV!" e  aparecem na tela, o dispositivo emite um alarme sonoro e para de infundir automaticamente.
- 3) Pressão longa  para eliminar o alarme e retornar ao menu principal.



Figura 3-5 Alarme de bolhas de ar

3.5 Alarme de pressão (oclusão)

- 1) Verifique se a câmara de gotejamento se localiza acima da bomba.
- 2) Defina a taxa de infusão para 500 mL / h. pressione  para começar a infundir.
- 3) Feche o grampo do conjunto IV (o grampo deve estar abaixo da bomba). Isso causará oclusão a jusante.
- 4) Após alguns segundos, os indicadores de estado de funcionamento ficam vermelhos e piscam e a mensagem "O tubo de infusão está bloqueado!" e  aparecer na tela, o dispositivo emite um alarme sonoro e para de infundir automaticamente.
- 5) Abra o grampo do rolo e pressione e segure  para eliminar o alarme e retornar ao menu principal.



Figura 3-6 Alarme de oclusão

Atenção:

- Quanto menor a taxa de infusão, mais tempo leva para a detecção de oclusão.

3.6 Alarme de porta aberta

- 1) Pressione  operar a bomba.
- 2) Abra a porta da bomba, os indicadores de estado de funcionamento ficam

vermelhos e piscam e a mensagem "A porta está aberta!" e  aparecer na tela, o dispositivo emite um alarme sonoro e para de infundir automaticamente.

- 3) Feche a porta da bomba, pressione e segure  para eliminar o alarme e retornar ao menu principal.

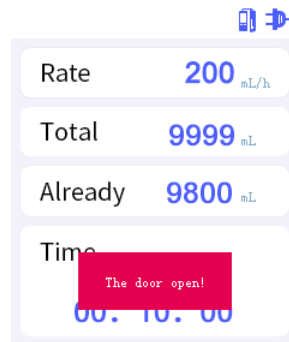


Figura 3-7 Alarme de porta aberta

3.7 Alternar para o modo de energia

- 1) Desconecte o cabo de alimentação da tomada CA.
- 2) O indicador de energia fica amarelo, o que indica que a bomba está funcionando com a bateria interna.
- 3) Insira o cabo de alimentação na tomada CA novamente.
- 4) O indicador de energia fica verde e o indicador de carga fica verde (carregando) ou não acende (a bateria está totalmente carregada).

Atenção:

- Duas condições para alarme de bateria:
 - 1) Ao trabalhar com a bateria interna, cerca de 30 minutos antes da bomba parar de infundir devido à bateria fraca, emite um alarme a cada 20 segundos e os indicadores de estado de funcionamento ficam amarelos e piscam, mensagem "Bateria fraca, por favor carregue!" aparece na tela com alarme sonoro.
 - 2) Ao trabalhar com a bateria interna, cerca de 3 minutos antes que a bateria se esgote, os indicadores de estado de funcionamento ficam vermelhos e piscam, mensagem "Bateria descarregada, desligue-a!" aparece na tela e a bomba emite um alarme sonoro e para de infundir automaticamente.

Capítulo 4 Iniciar e parar de infundir

4.1 Ligue a bomba

- 1) Conecte a bomba à fonte de alimentação CA.
- 2) Pressione ON / OFF para ligar a bomba e entre no menu principal.

4.2 Configuração para volume total

No menu principal, pressione o botão ACIMA ou ABAIXO para selecionar "Total", depois pressione  para entrar em sua interface de configuração, mostrada na Figura 4-1.

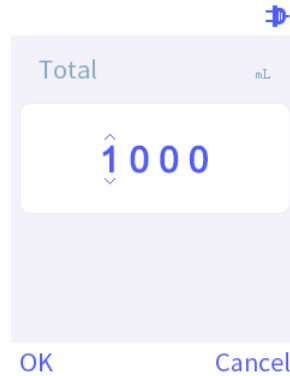


Figura 4-1 Configuração de volume total

Pressione o botão ESQUERDO ou DIREITO para selecionar e use o botão ACIMA ou ABAIXO para alterar o valor. O valor total do volume pode ser definido de 1 mL a 9999 mL.

4.3 Configuração para taxa de infusão

No menu principal, pressione o botão ACIMA ou ABAIXO para selecionar "Taxa" e, em seguida, pressione para entrar na interface de configuração, mostrada na Figura 4-2.

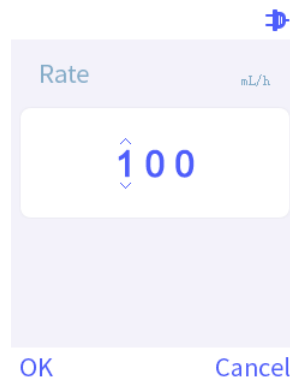


Figura 4-2 Configuração da taxa de infusão

Pressione o botão ESQUERDO ou DIREITO para selecionar e use o botão ACIMA ou ABAIXO para alterar o valor. O valor da taxa de infusão pode ser definido de 1 mL / ha 699 mL / h.

4.4 Tipo de conjunto IV

No menu principal, pressione o botão ACIMA ou ABAIXO para selecionar "Tipo", depois pressione  para entrar na interface para digitar a senha, mostrada na Figura 4-3.

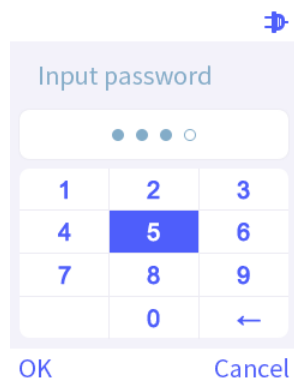


Figura 4-3 Interface de senha

Após inserir a senha "9999", o sistema entrará na interface para o tipo de configuração, mostrado na Figura 4-4.

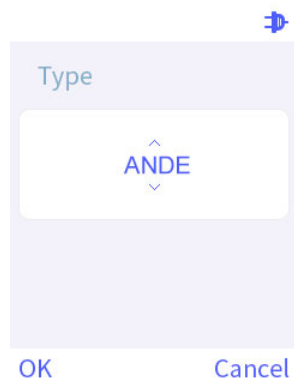


Figura 4-4 Interface de configuração de tipo

Pressione o botão UP ou DOWN para selecionar.

Atenção:

- A senha só pode ser acessada e mantida pela equipe médica.

4.5 INICIAR / PARAR a bomba

Após definir as opções "Taxa", "Total" e "Tipo", pressione  para iniciar o processo de

infusão. À medida que o volume da infusão aumenta, o tempo restante diminui. Pressione o botão INICIAR / PARAR novamente, a infusão é interrompida e o sistema retorna ao menu principal.

4.6 Eliminar alarme

Se ocorrer um alarme, a bomba emitirá um alarme sonoro e o motivo do alarme será exibido na tela. Pressão longa  eliminar o alarme; pressão curta  para pausar o alarme, após 2 minutos, o som do alarme continua.

O alarme da bomba inclui dois níveis: alta prioridade e baixa prioridade. O alarme de alta prioridade, que é o alarme mais sério, significa que o paciente está em perigo de vida ou ocorre um problema técnico crítico na bomba. Alarme de baixa prioridade significa aviso geral. O nível de todos os alarmes técnicos e alarmes gerais é o padrão do sistema, que não pode ser alterado pelo usuário. Antes do uso, o operador deve verificar se a configuração atual do alarme é adequada para todos os pacientes. Uma vez ativado, o alarme responderá imediatamente, sem demora. Dentro do alcance de 4m da bomba, a luz indicadora de alarme pode ser vista e o som do alarme pode ser ouvido.

Uma lista de alarmes é mostrada abaixo:

Nome	Nível	Tipo	Característica do som	Característica da luz
Alarme de bolhas de ar	Prioridade máxima	Alarme técnico	Som: “beep-beep-beep---beep-beep , beep-beep-beep---beep-beep”	A luz indicadora pisca em vermelho
Alarme de oclusão	Prioridade máxima	Alarme técnico	Som: “beep-beep-beep---beep-beep , beep-beep-beep---beep-beep”	A luz indicadora pisca em vermelho
Alarme de porta aberta	Prioridade máxima	Alarme técnico	Som: “beep-beep-beep---beep-beep , beep-beep-beep---beep-beep”	A luz indicadora pisca em vermelho
Alarme de falha do motor	Prioridade máxima	Alarme técnico	Som: “beep-beep-beep---beep-beep , beep-beep-beep---beep-beep”	A luz indicadora pisca em vermelho
Alarme anormal de pressão	Prioridade máxima	Alarme técnico	Som: “beep-beep-beep---beep-beep , beep-beep-beep---beep-beep”	A luz indicadora pisca em vermelho

			beep-beep-beep---beep-beep”	
Alarme anormal da porta	Prioridade máxima	Alarme técnico	Som: “beep-beep-beep---beep-beep , beep-beep-beep---beep-beep”	A luz indicadora pisca em vermelho
Alarme de fim de infusão	Prioridade máxima	Alarme geral	Som: “beep-beep-beep---beep-beep , beep-beep-beep---beep-beep”	A luz indicadora pisca em vermelho
Alarme de bateria esgotada	Prioridade máxima	Alarme geral	Som: “beep-beep-beep---beep-beep , beep-beep-beep---beep-beep”	A luz indicadora pisca em vermelho
Alarme KVO	Prioridade máxima	Alarme geral	Som: “beep-beep-beep---beep-beep , beep-beep-beep---beep-beep”	A luz indicadora pisca em vermelho
Alarme em espera	Baixa prioridade	Alarme geral	Som: “beep-beep-beep”	Luzes indicadoras em verde
Alarme de infusão próximo da extremidade	Baixa prioridade	Alarme geral	Som: “beep-beep-beep”	Luzes indicadoras em verde
Alarme de bateria fraca	Baixa prioridade	Alarme geral	Som: “beep-beep-beep”	Luzes indicadoras em verde

Atenção:

- Em qualquer área, o uso de diferentes predefinições de alarme para o mesmo dispositivo ou dispositivo similar é potencialmente perigoso.
- Se a bomba de infusão for reiniciada após a interrupção de energia, as configurações do sistema de alarme não serão alteradas.

4.7 “A infusão terminará! e estado "KVO"

O estado KVO refere-se a que, após a bomba terminar de infundir o volume total, para manter a veia aberta, a bomba ainda continua a infusão a uma taxa muito lenta.

1) Três minutos antes de terminar a infusão, a bomba dispara um alarme a cada 20 segundos, os indicadores de estado de funcionamento ficam acesos em verde e a mensagem "Infusão terminará!" aparece na tela.

2) Após a conclusão da infusão, a bomba passará para o estado KVO automaticamente e a mensagem "Entre no modo KVO" e  aparece na tela. Os indicadores de trabalho piscam em

vermelho e a bomba emite um alarme sonoro.

3) pressione  para terminar o estado KVO.

Capítulo 5 Função de infusão

5.1 Limpar volume infundido

Quando a bomba parar de funcionar, selecione "Limpar" no menu principal. Depois de pressionar  botão, a mensagem "O volume é XXXX.XX mL, limpa zero?" aparece na tela. pressione  para limpar o volume infundido, pressione  cancelar. Mostrado como Figura 5-1:

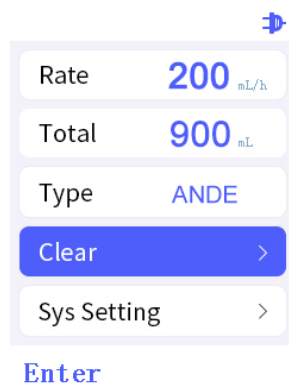


Figura 5-1 Limpar volume infundido

5.2 Acumulação de volume infundido

A bomba é capaz de acumular a quantidade que já foi infundida. Quando a bomba é usada em outros pacientes ou a solução do medicamento é alterada, ela acumula o volume anterior infundido no paciente e exibe o volume total a ser infundido no paciente atual. Se o volume infundido for diferente de 0, pressione  para iniciar a infusão e o sistema solicitará "O volume é XXXX.XX mL, limpe zero?", pressione  para limpar o volume infundido, pressione  cancelar; se o volume infundido for 0, a bomba começará a infundir normalmente.

5.3 Alterar "VOLUME TOTAL" durante a infusão

Pressione  para interromper a infusão, a bomba retorna ao menu principal, selecione "Total" para redefinir o volume total e pressione  para salvar a configuração. Após o sistema voltar ao menu principal, pressione "START / STOP" para continuar.

5.4 BOLUS

No estado sem infusão, pressão curta  pressione uma vez e mantenha pressionado para limpar o equipo.

 Aviso 

- Desconecte o conjunto IV do paciente ao limpar a tubulação.

No estado Bolus, o detector de bolhas de ar é desativado. (Não é recomendável usar esta função quando o conjunto IV estiver se conectando a um paciente.)

Atenção:

- Quando a bomba funciona com bateria interna, evite usar esta função no estado de bateria fraca.

5.5 Troque o frasco de infusão durante a infusão

Durante a infusão, pressione  para interromper a infusão, desconecte o conjunto intravenoso do frasco de infusão e insira-o em um novo. No menu principal, o volume de líquido no novo frasco de infusão é acumulado para o volume total, pressione  para confirmar o volume total atual e o sistema retorna ao menu principal. Verifique se a taxa de infusão está correta, pressione START / STOP para continuar a infusão.

Atenção:

- Para manter-se limpo, não toque no equipamento de punção com as mãos.
- Durante a substituição do frasco de infusão, o pessoal médico deve verificar se há bolhas de ar na tubulação. Se encontrado, remova todas as bolhas de ar antes da infusão.

5.6 Paciente em movimento

Se o paciente precisar se mover, a infusão pode ser garantida durante o movimento.

Desconecte o cabo de alimentação, a bomba funcionará continuamente com a bateria interna. Certifique-se de que a bomba, o cabo de alimentação e o conjunto de IV estejam firmemente fixados ao bastão de infusão e mova-o com o paciente.

Atenção:

- Não deixe a bomba girar excessivamente durante o movimento do paciente. Normalmente, a fonte de alimentação CA deve ser usada, a bateria interna é adequada apenas para movimentos de curta duração. Quando a bomba funcionar apenas com bateria interna e a bateria estiver fraca, evite usar infusão de alta velocidade ou de longa duração.

5.7 Ruído e Calor

O motor gera um leve ruído ao funcionar.

Quando a temperatura excede 30 °C, a superfície da bomba fica quente após um longo período de operação.

Capítulo 6 Configuração do sistema

No menu principal, pressione UP ou DOWN para selecionar "Sys Setting", pressione  para entrar na sua interface de configuração. Insira a senha em primeiro lugar, consulte a seção 4.3 para obter detalhes. As configurações do sistema incluem configurações de limite de pressão, calibração da taxa, idioma, som do botão e redefinição, mostradas na Figura 6-1:

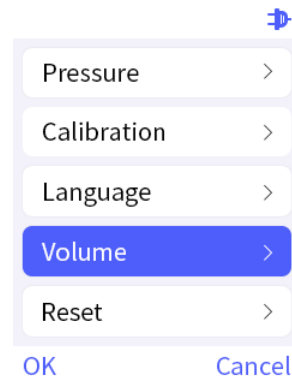


Figura 6-1 Interface de configuração do sistema

6.1 Limiar de pressão

O sensor de pressão é capaz de detectar a pressão do líquido na tubulação a jusante, e o limiar de pressão pode alterar a pressão máxima permitida da bomba. Durante o processo de infusão, se a tubulação a jusante estiver bloqueada e a pressão da bomba atingir o valor limite predefinido, a bomba dispara um alarme e para de infundir.

Para definir o limiar de pressão:

Na interface de configuração do sistema, pressione ACIMA ou ABAIXO para selecionar "Pressão", e pressione  para entrar na sua interface de configuração.

Pressione ACIMA ou ABAIXO para definir o valor da pressão. Existem 3 níveis (1 ~ 3) que podem ser ajustados, como mostra a Figura 6-2:



Figura 6-2 Interface de limiar de pressão

Atenção:

- A bomba foi ajustada no limite de pressão ideal antes de sair da fábrica; se não houver necessidade específica, não a altere. Para evitar causar lesões aos pacientes, verifique se o valor não é alterado antes da infusão.
- Devido ao efeito da temperatura no conjunto IV e na solução do medicamento, o valor real da pressão do alarme pode se tornar maior (menor) quando a temperatura cai (sobe). De acordo com as necessidades específicas e o grau de queda de temperatura (subindo), é apropriado diminuir (aumentar) o limiar de pressão do alarme.

6.2 Calibração de taxa

Na interface de configuração do sistema, pressione ACIMA ou ABAIXO para selecionar "Calibração" e pressione  para entrar em sua interface de configuração, como mostra a Figura 6-3:



The interface shows a list of flow rate ranges and their corresponding offsets. The first range, 1-50 mL/h, is highlighted in blue and shows an offset of ANDE. The other ranges show 0% offsets.

Flow Rate Range (mL/h)	Offset
1-50	ANDE
50-200	0 %
200-400	0 %
400-699	0 %

Buttons: OK, Cancel

Figura 6-3 Interface de configuração de deslocamento


Pressione ACIMA ou ABAIXO para selecionar itens diferentes e pressione ESQUERDA ou DIREITA para alterar o valor e pressione  para confirmar a configuração.

Atenção:

- O conjunto IV deve ser consistente com o tipo atual em uso. Método de cálculo da compensação de taxa, consulte o Capítulo 7.

6.3 Idioma

Na interface de configuração do sistema, pressione ACIMA ou ABAIXO para selecionar "Idioma" e pressione  para entrar em sua interface de configuração, como mostra a Figura 6-4:



The interface shows a list of languages. 'Chinese' is selected and highlighted in blue. The list is enclosed in a box with up and down arrow icons.

Language

Chinese

Buttons: OK, Cancel

Figura 6-4 Interface de seleção de idioma

Pressione ACIMA ou ABAIXO para selecionar o idioma e pressione  para confirmar a configuração.

6.4 Som do botão

Na interface de configuração do sistema, pressione ACIMA ou ABAIXO para selecionar "Volume". Em seguida, pressione ACIMA ou ABAIXO para ativar ou desativar o som e pressione  para confirmar a configuração, como mostra a Figura 6-5:

Atenção:

- O som do alarme é afetado pelo LIGADO ou DESLIGADO do som do botão, ele está sempre no estado "LIGADO".

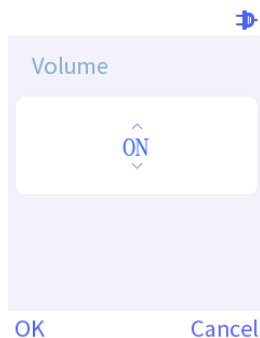


Figura 6-5 Configuração de som do botão

6.5 Redefinir

Na interface de configuração do sistema, pressione ACIMA ou ABAIXO para selecionar "Redefinir", depois de pressionar , o sistema solicitar "Resetar tudo?", pressione  para redefinir ou pressione  para cancelar, conforme mostrado na Figura 6-6:

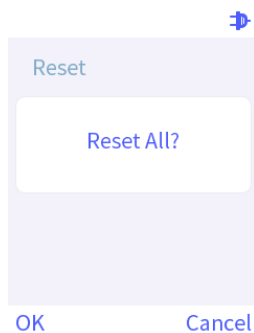


Figura 6-6 Interface de descanso

Capítulo 7 Calibração para o conjunto IV

A precisão depende em grande parte do conjunto IV. Os materiais e as especificações escolhidas por diferentes fabricantes são diferentes, portanto, para garantir a precisão, diferentes marcas do conjunto IV têm seu próprio parâmetro de infusão. Um novo conjunto de infusão de marca deve ser calibrado e não pode ser usado até que seja validada sua precisão dentro da faixa de erro permitida.

O trabalho acima será concluído pelo fornecedor ou revendedor.

Os fornecedores locais têm a obrigação de fornecer um banco de dados de marcas de conjuntos intravenosos comumente usados no local. Antes de comprar a bomba, os usuários devem informar aos fornecedores da marca do conjunto IV que pretendem usar.

7.1 Precisão de infusão

A precisão da infusão refere-se à porcentagem da diferença entre o volume real de infusão e o volume predefinido de infusão dividido pelo volume predefinido sob a condição da taxa de infusão predefinida; a fórmula é a seguinte:

$$\text{Precisão da infusão} = (\text{volume de infusão real} - \text{volume de infusão predefinido}) / \text{volume de infusão predefinido} \times 100\%$$

7.2 IV Definir Requisitos

Diâmetro externo: 3,5 mm ~ 4,3 mm.

O conjunto IV continha borracha de silicone: alta flexibilidade, relativamente estável com propriedades físicas e não muda com as mudanças na temperatura ambiente, a precisão da infusão pode ser alcançada em $\pm 5\%$ após a calibração.

PVC comum (cloreto de polivinil): baixa flexibilidade, incapaz de recuperar exatamente o estado original após a extrusão, seu diâmetro aumentará gradualmente com a frequência da extrusão e o tempo de infusão aumentando, a precisão é de cerca de $\pm (5 \sim 15)\%$ após a calibração.

PVC rígido (cloreto de polivinil): sem flexibilidade, quase incapaz de recuperar o estado original após a extrusão, não é recomendado o uso.

7.3 Seleção do conjunto IV

Cada bomba fornece um conjunto de IV especificado para uso e uma marca em branco para seleção. Após conectar à energia, pressione ON / OFF para ligar a bomba e, em seguida, as informações atuais do conjunto IV aparecem na tela. Se a marca exibida for a mesma que a atual, você não precisará redefinir. Caso contrário, consulte a seção 4.4 para redefinir o nome da marca.

Atenção:

- Existem vários conjuntos de infusão, e os modelos usados em diferentes hospitais não são os mesmos, os nomes dos conjuntos de infusão listados no "Tipo" são definidos com base na demanda do usuário antes de sair da fábrica. Antes de comprar a bomba, seria melhor informar o fornecedor ou o fabricante das marcas do conjunto IV que você usará, para inserir os parâmetros do conjunto IV no sistema da bomba com antecedência.
- O nome selecionado deve ser consistente com o tipo de uso atual ou a precisão pode ser

imprecisa.

- Se a marca do conjunto IV que você deseja calibrar não estiver nas seleções, você também pode calibrá-la diretamente no canal "A" sem informar o revendedor sobre sua marca.

7.4 Calibração para o conjunto IV

A bomba define a taxa de infusão com "mL / h", também conhecida como infusão "modo volumétrico", e sua calibração é chamada de calibração "taxa de infusão".

O método de calibrar uma taxa de infusão predefinida (mL / h) é chamado de calibração "taxa de infusão".

Etapas de calibração:

No menu principal, selecione o tipo de conjunto IV a ser calibrado. Após digitar a senha, entre na interface de configuração do sistema, selecione "Calibração" para entrar na interface de calibração de taxa, que mostra a marca do conjunto IV e seus desvios de taxa correspondentes.

Pressione ACIMA ou ABAIXO para selecionar itens diferentes e pressione ESQUERDA ou DIREITA para alterar o valor do deslocamento, a faixa de ajuste é de -20% a 20%.

Pressione  para confirmar a configuração e retornar à interface de configuração do sistema.

Princípios de ajuste de deslocamento:

O deslocamento da taxa de infusão (N%) pode ser calculado de acordo com medições e cálculos. A fórmula é a seguinte:

$$N\% = \frac{[(\text{volume de vazão teórico} - \text{volume de vazão medido}) \div \text{volume de vazão teórico}] \times 100\%}{\dots\dots\dots} \text{ Fórmula 1}$$

Calcule o valor de acordo com a Fórmula 1 e edite diretamente o valor do deslocamento da taxa na Interface de deslocamento.

Exemplo:

Suponha que a taxa de infusão de um conjunto de infusão seja de 50 mL / h, o tempo de medição da infusão seja de 60 minutos e o volume medido real seja de 56 mL. Vamos calcular o valor do deslocamento (N%) e concluir a operação de calibração.

O primeiro passo é calcular o valor de compensação: de acordo com as condições fornecidas acima, o "volume de fluxo teórico" durante 60 minutos é: volume de fluxo teórico = 50 mL / h × 1 h = 50 mL. Dado que o volume medido real é de 56 mL, portanto, de acordo com a Fórmula 1, valor de compensação (N%) = [(50 mL - 56 mL) ÷ 50 mL] % = -12%.

O segundo passo é inserir o valor de correção: de acordo com o valor de correção calculado acima, na interface de correção, pressione UP ou DOWN para selecionar a faixa de taxa e pressione LEFT ou RIGHT para definir o valor de correção para "-12%". Pressione  para confirmar, a calibração está concluída.

Capítulo 8 Manutenção

Por favor, use a bomba com cuidado, pois é um bom equipamento projetado. A manutenção adequada pode prolongar a vida útil do dispositivo.

8.1 Limpeza e Desinfecção

As peças de contato do paciente (como porta da bomba, gancho, etc.) devem ser limpas e desinfetadas todos os meses pela equipe médica, os métodos de limpeza e desinfecção são os seguintes:

Limpeza: Limpe a bomba com um pano macio umedecido em água e sabão e use um pano seco para limpar.

Desinfecção: Mergulhe um pano macio na solução desinfetante “84” (concentração: 25%), use-a para limpar a porta da bomba, o sensor de detecção de bolhas de ar e outras peças e depois seque com um pano seco.

8.2 Manutenção periódica

8.2.1 Inspeção da taxa de infusão

1) Quando a bomba for armazenada por 6 meses ou mais, antes de usar, use um cilindro graduado e um cronômetro para testar a taxa de infusão.

2) Para uma bomba usada normalmente, sua taxa de infusão deve ser inspecionada a cada seis meses usando um cilindro graduado e um cronômetro. Se sua precisão exceder o erro permitido, ele deverá ser calibrado.

8.2.2 Inspeção e manutenção de bateria embutida

Quando a bateria está totalmente carregada, a bomba pode funcionar por mais de 4 horas continuamente à taxa de infusão de 25 ml / h com a bateria interna. Quando a bomba é usada pela primeira vez ou após 3 meses sem uso, recomenda-se carregá-la por pelo menos 12 horas. É melhor manter a bateria na condição de carregamento quando a bomba não estiver funcionando. Se a bomba não for usada por um longo período, carregue-a a cada 3 meses até que o indicador de carga que indica que está totalmente carregado. Quando a bomba é armazenada por um longo período, ela deve ser conectada à fonte de alimentação CA por 5 minutos antes de ligar.

As pilhas pertencem a consumíveis. Eles devem ser substituídos ao atingir a vida útil. Se necessário, entre em contato com seu distribuidor ou fabricante para a substituição da bateria. Modelo: bateria de polímero de lítio (7,4 V, 5000 mAh).

Para garantir o desempenho da bateria e prolongar sua vida útil, todos os meses a equipe médica deve fazer um teste de bateria se esgotando até a bomba desligar automaticamente. Em seguida, para uso futuro, carregue a bomba até o indicador de carga indicar que está totalmente carregado.

Siga as etapas abaixo para verificar a bateria a cada 4 meses:

- 1) Conecte à CA, carregue a bateria com a carga completa;
- 2) Ligue a bomba e instale o conjunto de infusão;
- 3) Defina a taxa de infusão para 25 mL / h e inicie a infusão;
- 4) Mantenha a bomba em funcionamento até desligar com pouca bateria.
 - A bateria está em boas condições se a bomba demorar mais de 4 horas desde o

início da infusão até a bateria fraca (alarme); e leva mais de 30 minutos da bateria fraca (alarme) até a falta (alarme); e, mais de 3 minutos da bateria acabar (alarme) até o desligamento automático.

- Se um ou mais dos itens acima não atenderem ao requisito, a bateria estará próxima do fim de sua vida útil. Entre em contato com o revendedor ou fabricante para trocar a bateria.

5) Depois de verificar a bateria, recarregue-a para que esteja totalmente carregada para uso na próxima vez.

A duração da bateria depende do uso de frequência e tempo. A vida útil da bateria de lítio neste dispositivo é de 300 vezes. Se o número exceder 300 vezes, é recomendável substituir a bateria ou realizar a inspeção acima todos os meses. Se a manutenção e o armazenamento da bateria forem adequados, sua vida útil será de aproximadamente 3 anos. Embora se usado incorretamente, sua vida útil pode ser reduzida. Para a bateria ter sido usada por mais de 3 anos, recomendamos substituí-la ou realizar a inspeção acima todos os meses.

8.3 Tratamento sem poluição e reciclagem

A bomba tem vida útil normal por cinco anos, precisa ser descartada após atingir a vida útil.

Por favor, devolva a bateria usada ao revendedor ou fabricante ou descarte-a de acordo com os regulamentos aplicáveis. Não desmonte a bateria ou jogue-a no fogo, água ou curto-circuito, caso contrário, poderá causar queimaduras, explosão, vazamento ou riscos de ferimentos.

O revendedor ou nosso escritório reciclará a bomba usada.

Entre em contato com o fabricante ou revendedor para obter informações mais relevantes.

8.4 Eliminação e reciclagem do conjunto IV

O conjunto de IV usado com a bomba é o conjunto de infusão de bomba descartável fabricado pela Shinva Ande Healthcare Apparatus Co., Ltd. É descartável e não pode ser usado repetidamente. Descarte o conjunto de IV usado de acordo com as leis e regulamentos locais.

Capítulo 9 Características da infusão

9.1 Características de precisão

A curva de precisão da infusão indica a alteração da infusão em um determinado período após o início da infusão e o desempenho atinge um volume normal de infusão. A curva adota a marca do conjunto de infusão de bomba descartável fabricado pela Shinva Ande Healthcare Apparatus Co., Ltd. "para teste, que foi usado como um símbolo importante das características gerais. (Taxa média: 25 ml / h, adiante teste com taxa média).

Ambiente e condição de teste

Temperatura: +25 °C ~ +30 °C

Humidade relativa: 20% ~ 90%

Pressão atmosférica: 860 hPa ~ 1060 hPa

Iniciar curva

É desenhado de acordo com os dados do círculo de teste de duas horas.

Intervalo de amostra: Δt = volume de infusão de 0,5 minuto: $Q / (\text{ml} / \text{h})$ círculo de teste = 120 minutos

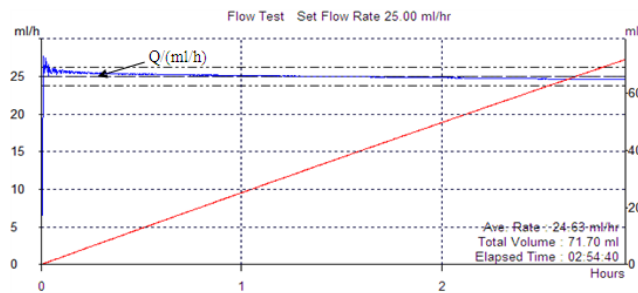


Figura 9-1 Curva de características de precisão

Curva em forma de chifre

Erro de volume de infusão a curto prazo: ($p\Delta t$) minutos

Intervalo de amostra: $\Delta t=0.5$

Duração da janela de observação: $p\Delta t=2, 5, 11, 19, 31$ minutos

A porcentagem média total do erro do volume de infusão medido: A (%)

O erro mínimo de teste da janela de observação dentro de um determinado período: EP min (%)

O erro máximo de teste da janela de observação dentro de um determinado período de tempo: EP max (%)

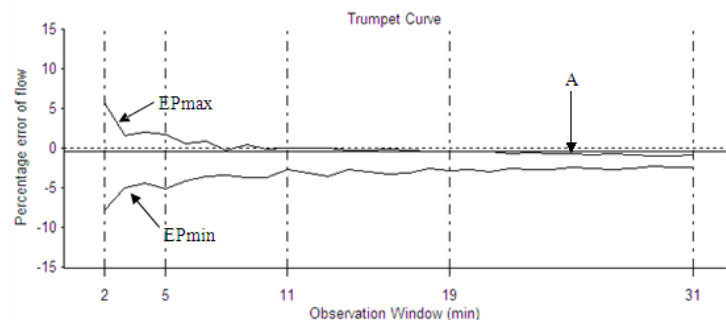


Figura 9-2 Curva em forma de chifre

Atenção:

- A precisão da infusão não reflete o padrão clínico, como idade, peso e outros medicamentos que o paciente utiliza.
- A precisão da infusão pode ser afetada pelas condições ambientais (pressão, temperatura, conjunto IV, etc.)

9.2 Características de resposta à oclusão

O bloqueio do tempo de alarme é uma diretriz importante da resposta de oclusão. A bomba adota a marca do conjunto de infusão descartável de bomba fabricado pela Shinva Ande Healthcare Apparatus Co., Ltd. "para testes, seus dados representam apenas a conclusão da medição atual. A bomba assume a função de liberação de pressão, o sistema de pressão da tubulação será liberado automaticamente quando o alarme de oclusão aparecer.

O tempo de alarme de oclusão foi influenciado pela taxa de infusão, marca do conjunto IV, especificação do conjunto IV, solução de infusão, comprimento da tubulação de infusão, pressão externa, etc. A bomba foi ajustada para a característica ideal antes de sair da fábrica, se não houver necessidade específica, por favor, não t ajuste o valor da pressão.

Taxa (ml / h)	1	25	100	250	500	699
Grau de alarme	——	——	——	——	——	——
Pressão de oclusão (kPa)	230	230	230	230	230	230
Hora do alarme de oclusão	31min	1min 01sec	16seg	7seg	5seg	3seg

Dose em bolus de oclusão

Produce uma dose de bolus de cerca de 1 ml sob a pressão atmosférica de 130 kPa e uma dose de bolus de 2 ml sob a pressão atmosférica de 270 kPa (o resultado é a média da medição muitas vezes usada para referência).

9.3 Conjunto IV recomendado e componente de infusão

A bomba é calibrada pelo conjunto de IV descartável do conjunto de infusão de bomba descartável fabricado pela Shinva Ande Healthcare Apparatus Co., Ltd . Se você usar outras marcas do conjunto de IV, consulte o manual do usuário para calibrar o parâmetro do conjunto de IV, ou informe a sua marca de IV para o revendedor, que pode ajudar a calibrá-lo.

Capítulo 10 Compatibilidade e interferência EMC

A bomba pode impedir interferência externa, incluindo radiação de radiofrequência de alta intensidade, magnética e eletrostática. No entanto, o usuário deve evitar o uso do celular a 0,5 metro do dispositivo.

Evite usar esta bomba com MRI (Imagem por Ressonância Magnética) ou equipamento médico análogo juntos; caso contrário, a interferência eletromagnética causará falha ou colapso do sistema.

Verifique se o ambiente em que a bomba é usada não está sujeito a fontes de forte campo eletromagnético, como telefones celulares, etc. Caso contrário, a interferência eletromagnética causará falha ou colapso do sistema.

Nota:

- O dispositivo é um equipamento de classe B de proteção contra interferência de rádio em conformidade com a EN55011.
- O dispositivo requer precauções especiais para compatibilidade eletromagnética (EMC) e requer pessoal qualificado para instalar e usar de acordo com as informações EMC fornecidas abaixo.
- Os campos eletromagnéticos podem afetar o desempenho do dispositivo; portanto, outros equipamentos usados próximos a ele devem atender aos requisitos EMC apropriados. Telefones celulares, raios X ou dispositivos de ressonância magnética são possíveis fontes de interferência, pois emitem radiação eletromagnética de alta intensidade.

Medidas de precaução contra ESD

Para evitar o acúmulo de carga eletrostática, recomenda-se armazenar, manter e usar o equipamento a uma umidade relativa de 30% ou mais. O piso deve ser coberto com tapetes dissipados com ESD ou materiais semelhantes. No uso dos componentes, roupas não sintéticas devem ser usadas. Para evitar descargas eletrostáticas nas partes sensíveis ao ESD do dispositivo, o pessoal deve entrar em contato com a estrutura metálica dos componentes ou com os grandes objetos metálicos próximos ao dispositivo. Ao usar o dispositivo, especialmente quando é possível entrar em contato com as partes sensíveis ao ESD, o operador deve usar uma pulseira aterrada projetada para dispositivos sensíveis ao ESD.

Procedimento de precaução contra ESD

- Todos os usuários em potencial são aconselhados a entender os símbolos de aviso de ESD e receber treinamento sobre as precauções contra ESD. O conteúdo mais básico do treinamento em procedimentos de precaução contra ESD deve incluir uma introdução à física da carga eletrostática, nível de tensão no caso convencional e danos aos componentes eletrônicos quando o operador com carga eletrostática os contatar. Além disso, os métodos para evitar o acúmulo eletrostático e a maneira e as razões para a liberação da eletricidade estática do corpo humano no solo ou na estrutura do equipamento ou no uso de uma pulseira para conectar o corpo humano ao equipamento ou ao solo antes de estabelecer a conexão deve ser descrito.
- O uso de ACESSÓRIOS, transdutores e cabos diferentes dos especificados, com

exceção dos transdutores e cabos vendidos pelo FABRICANTE do EQUIPAMENTO ME ou do SIS ME como peças de reposição para componentes internos, pode resultar em aumento de EMISSÕES ou diminuição da IMUNIDADE do EQUIPAMENTO ME ou ME SYSTEM.

- Dispositivos ou sistemas não devem ser usados quando estão próximos ou empilhados com outros equipamentos; se necessário, observe e verifique se eles podem operar normalmente nas configurações.
- Os dispositivos ou sistemas ainda podem sofrer interferências de outros equipamentos, mesmo que outros atendam aos requisitos da norma nacional correspondente.
- Os dispositivos médicos ativos estão sujeitos a precauções especiais da EMC e devem ser instalados e usados de acordo com estas diretrizes.
- Equipamentos de RF portáteis e móveis podem afetar o uso de equipamentos elétricos médicos.
- Descrição básica do desempenho: O status de trabalho não pode ser alterado, a taxa de infusão é definida em 300mL / h, o erro permitido é de $\pm 5\%$

Apêndice I Explicação dos alarmes do sistema

Alarme	Razões	Soluções
A infusão terminará!	O volume de infusão predefinido está concluído.	Pressione INICIAR / PARAR para interromper a infusão e o alarme é eliminado; no menu principal, limpe o volume infundido e pressione INICIAR / PARAR para reiniciar a infusão.
Bolha de ar	1. Há bolha de ar no conjunto IV. 2. Instalação incorreta do conjunto IV. 3. Falha no sensor.	1. Pressione e segure o botão confirmar para eliminar o alarme; remova manualmente a bolha de ar e pressione START / STOP para reiniciar a infusão. 2. Reinstale o conjunto IV. 3. Entre em contato com o atendimento ao cliente (fabricante ou fornecedor).
Bloqueio	1. O bloqueio ocorre. 2. O sistema de alarme é sensível devido ao limite de alarme de bloqueio estar muito pequeno. 3. Falha no sensor.	1. Pressione e segure o botão confirmar para eliminar o alarme; remova a obstrução e pressione START / STOP para reiniciar a infusão. 2. Consulte o manual do usuário para obter o limiar de pressão. 3. Entre em contato com o atendimento ao cliente.
Bateria Fraca	1. A bateria está fraca. 2. O envelhecimento da bateria ou o circuito de carregamento da bateria está danificado.	1. Conecte à fonte de alimentação CA para carregar a bateria. 2. Entre em contato com o atendimento ao cliente.
Bateria esgotada	1. Bateria está descarregada. 2. O envelhecimento da bateria ou o circuito de carregamento da bateria está danificado.	1. Conecte à fonte de alimentação CA para carregar a bateria. 2. Entre em contato com o atendimento ao cliente.
Motor anormal	1. Instalação incorreta do conjunto IV. 2. Falha no motor.	1. Pressione e segure o botão confirmar para eliminar o alarme; reinstale o conjunto IV e pressione START / STOP para reiniciar a infusão. 2. Entre em contato com o atendimento ao cliente.

Apêndice II Diretriz da EMC e declaração do fabricante

Os seguintes tipos de cabo devem ser usados para garantir que eles estejam em conformidade com os padrões de radiação de interferência e imunidade:

Nome	Comprimento do cabo (m)
Cabo de alimentação	1.8
Cabo de conexão do terminal de equalização de potencial	3.0

Tabela 1: Emissão eletromagnética

Orientação e declaração do fabricante - emissão eletromagnética		
O dispositivo foi projetado para uso no ambiente especificado abaixo. O comprador ou o operador deve garantir que seja usado em tal ambiente.		
Teste de emissão	Conformidade	Orientação eletromagnética do ambiente
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1	O dispositivo usa energia de RF apenas para sua função interna. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e provavelmente não causam interferências em equipamentos eletrônicos próximos.
Emissões de RF CISPR 11	Classe A	
Emissões harmônicas IEC 61000-3-2	Não aplicável	
Flutuações de tensão / emissão de cintilação IEC 61000-3-3	Não aplicável	

Tabela 2: Imunidade eletromagnética 1

Orientação e imunidade eletromagnética à declaração do fabricante			
O dispositivo foi projetado para uso no ambiente especificado abaixo. O comprador ou o operador deve garantir que seja usado em tal ambiente.			
Teste de imunidade	Nível de teste IEC60601	Nível de conformidade	Orientação eletromagnética do ambiente
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Contato $\pm 8\text{kV}$ $\pm 15\text{kV}$ ar	Contato $\pm 8\text{kV}$ $\pm 15\text{kV}$ ar	Os pisos devem ser de madeira, concreto ou telha cerâmica. Se o piso for coberto com material sintético, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%.
Transiente rápido elétrico / explosão IEC 61000-4-4	$\pm 2\text{kV}$ para linhas de alimentação $\pm 1\text{kV}$ para linha de E / S	$\pm 2\text{kV}$ para linhas de alimentação $\pm 1\text{kV}$ para linha de E / S	A qualidade da energia da rede deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico.

Surge IEC 61000-4-5	Linhas de ± 1 kV para terra Linhas de ± 2 kV para terra	Linhas de ± 1 kV para terra Linhas de ± 2 kV para terra	A qualidade da energia da rede deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão nas linhas de entrada da fonte de alimentação IEC 61000-4-11	<5% UT (> 95% de queda na UT) por 0,5 ciclo 40% UT (queda de 60% na UT) por 5 ciclos 70% UT (mergulho de 30% na UT) por 25 ciclos <5% UT (> 95% interrupção UT) por 5 segundos	<5% UT (> 95% de queda na UT) por 0,5 ciclo 40% UT (queda de 60% na UT) por 5 ciclos 70% UT (mergulho de 30% na UT) por 25 ciclos <5% UT (> 95% interrupção UT) por 5 segundos	A qualidade da energia da rede deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o usuário precisar de operação contínua durante interrupções na rede elétrica, é recomendável que o dispositivo seja alimentado por uma fonte de alimentação ininterrupta ou por uma bateria.
Campo magnético de frequência de potência (50 Hz) IEC 61000-4-8	400 A/m	400 A/m	Os campos magnéticos de frequência de potência devem estar em níveis característicos de um local típico em um ambiente comercial ou hospitalar típico.
NOTA: UT é o a.c. tensão de rede antes da aplicação do nível de teste.			

Tabela 3: Imunidade eletromagnética 2

Orientação e imunidade eletromagnética da declaração do fabricante			
O dispositivo foi projetado para uso no ambiente especificado abaixo. O comprador ou o operador deve garantir que seja usado em tal ambiente.			
Teste de imunidade	Nível de teste IEC60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - orientação
RF conduzido IEC61000-4-3	3 V (valor efetivo) 150kHz ~ 80MHz	3 V (valor efetivo)	Os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem ser usados nem perto de nenhuma parte do dispositivo, incluindo cabos, além da distância recomendada de separação calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{80 \text{ MHz}-800 \text{ MHz}}$ $d = 2,3 \sqrt{800 \text{ MHz}-2,5 \text{ GHz}}$ Onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m).
RF irradiado IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz~2.5 GHz	3 V/m	As intensidades de campo dos transmissores de RF fixos, conforme determinado por uma pesquisa eletromagnética no local, a devem ser menores que o nível de conformidade em cada faixa de frequência.b Pode ocorrer interferência nas proximidades de equipamentos marcados com o seguinte símbolo: 
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta. NOTA 2: Essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			
a) As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações base para telefones de rádio (celular / sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve-se considerar uma pesquisa eletromagnética no local. Se a intensidade do campo medido no local em que o dispositivo ou sistema for usado exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, o dispositivo deve ser observado para verificar a operação normal. Se um desempenho anormal for observado, medidas adicionais podem ser necessárias, como ajustar a direção ou a localização do dispositivo. b) Na faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades do campo devem ser menores que 3 V / m.			

Tabela 4: Distância de segurança recomendada

Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comunicação RF portátil e móvel e o dispositivo			
O dispositivo foi projetado para uso no ambiente eletromagnético no qual os distúrbios de RF irradiados são controlados. O cliente ou o usuário do dispositivo pode ajudar a evitar interferências eletromagnéticas, mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicação de RF portátil e móvel (transmissores) e o dispositivo, conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.			
Potência nominal do transmissor (W)	Distância de separação de acordo com a potência do transmissor (m)		
	150 k Hz – 80 MHz $d=1.2 \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d=1.2 \sqrt{P}$	800 MHz – 2.5 GHz $d=2.3 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
Para transmissores classificados com uma potência máxima de saída não listada acima, a separação recomendada distanciada em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. NOTA 1 Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais alta. NOTA 2 Essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			



Fabricado por: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD

Endereço: No.112 Qinhuang West Street, Economic & Technical Development Zone,

Qinhuangdao, Hebei Province, People's Republic of China.

Importado e distribuído por:

MARIMAX COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E
VETERINÁRIOS EIRELI

CNPJ: 20.339.865/0001-94 Tel. (11) 4133-6300

Av Cauaxi n 293 sala:1301 e 1302 - Alphaville.

CEP: 06454-020 – Barueri – SP

Resp. RICARDO FRANCO DE SANTANA CFT: 29265736852

ANVISA: 8.14.490-1



Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR / GO
PREGÃO ELETRONICO Nº 042/2026

A empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61**, com sede na AV HENRIQUE MANSANO, 1581 JD ALPES, CEP 86.079-450 LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. CESAR RAFAEL CARREGA, RG n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF n.º 055.015.959-23, **DECLARA QUE:**

a) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de Ouvidor, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos;

c) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

d) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º da referida lei.

e) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

f) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que não possui dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da administração municipal direta ou indireta promotora deste certame.

Londrina, 15 de JULHO de 2026.

57.498.660/0001-61
91099706-86
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1581
B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450
LONDRINA - PR

CESAR
RAFAEL
CARREGA:05
501595923

Assinado de
forma digital por
CESAR RAFAEL
CARREGA:05501
595923



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR / GO
PREGÃO ELETRONICO Nº 042/2026

A empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61**, com sede na AV HENRIQUE MANSANO, 1581 JD ALPES, CEP 86.079-450 LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. CESAR RAFAEL CARREGA, RG n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF n.º 055.015.959-23, **DECLARA QUE possui ciência do Sistema de Registro de Preços – SRP adotado pela Administração para o presente processo, entendendo que não há obrigação do Município de Ouvidor na aquisição de quantidades mínimas e/ou da totalidade do estimado e que, participamos do presente processo com a real intenção de fornecer os produtos conforme estabelecido no Edital e seus anexos, assumindo toda e qualquer responsabilidade administrativa, civil e penal pela prática de condutas que gerem atrasos nas entregas e transtornos à Administração.**
Pela segurança das informações inseridas na Plataforma, na documentação anexa e nos atos praticados durante o certame, tenho ciência da dispensa da assinatura (física ou eletrônica) da futura Ata de Registro de Preços oriunda do resultado deste certame – discricionariedade da Administração, ratificando a aplicação do princípio do formalismo moderado e colaborando com a agilidade dos atos administrativos, cientes das obrigações estipuladas no Termo de Referência e demais anexos ao Instrumento Convocatório, assim como dos futuros fornecimentos.

Londrina, 15 de JULHO de 2026.

57.498.660/0001-61
91099706-86
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1581
B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450
LONDRINA - PR

CESAR
RAFAEL
CARREGA:05501595923
Assinado de
forma digital
por CESAR
RAFAEL
CARREGA:05501595923



Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR - GO
PREGÃO ELETRONICO Nº 042/2026

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61**, com sede na AV HENRIQUE MANSANO, 1581 JD ALPES, CEP 86.079-450 LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. CESAR RAFAEL CARREGA, RG n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF n.º 055.015.959-23.

RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE DE CUMPRIMENTO DO EDITAL: Declaramos, sob as penas da lei, que o edital e seus anexos foram colocados à nossa disposição, e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade para execução do objeto da licitação, bem como, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

FATOS IMPEDITIVOS E IDONEIDADE: Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participação e habilitação de nossa empresa na presente licitação, ciente da obrigatoriedade de declarar, caso ocorram fatos posteriores que nos inabilite a participar de licitações. Declaramos ainda que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública.

ENQUADRAMENTO: Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido previsto neste edital e que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ciente que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

PROTEÇÃO AO TRABALHO MENOR: Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, **NÃO POSSUINDO, AINDA**, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO: Declaramos, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.



PROPOSTA: Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, são apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes ou fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do serviço objeto da presente licitação. Declaramos ainda que a participação na presente licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão aos termos deste Edital.

ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA: Declaramos em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar do referido Pregão foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar do referido Pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal, antes da abertura oficial das propostas.

Londrina, 15 de JULHO de 2026.

57.498.660/0001-61
91099706-86
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1581
B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450
LONDRINA - PR

CESAR
RAFAEL
CARREGA:05
501595923

Assinado de
forma digital por
CESAR RAFAEL
CARREGA:05501
595923

1

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/07/1992, portador da cédula de Identidade Civil RG sob n.º 12.640.687-8 SESP/PR e CPF sob n.º 084.265.219-16, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tereza Zanette Lopes, n.º 277 – Apartamento 1502 – Gleba Fazenda Palhano – CEP: 86.050-523. Único sócio da Empresa Limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situado na Praça de Londrina – Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41212886685 em data de 30/09/2024, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 57.498.660/0001-61, resolvem modificar o primitivo contrato pelo presente instrumento de alteração e consolidação contratual:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O sócio **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA** que possui 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) vende e transfere de maneira onerosa a totalidade de suas quotas a **CESAR RAFAEL CARREGA**, brasileiro, solteiro, nascido em 31/05/1985, empresário, portador do RG sob n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF sob n.º 055.015.959-23, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tupi, n.º 329 – Apartamento 804 – Centro – CEP: 86.020-350, o qual ingressa na sociedade através do presente ato.

CLÁUSULA SEGUNDA

O sócio **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA** dá ao adquirente **CESAR RAFAEL CARREGA** plena, geral, rasa e irrevogável quitação da cessão de cotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em decorrência da presente alteração, o capital social que era de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizados, permanece inalterado ficando assim distribuídos:

SOCIO	QUOTAS	R\$
CESAR RAFAEL CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUARTA

A administração da sociedade caberá a **CESAR RAFAEL CARREGA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos

2

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei nº 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.

CLÁUSULA QUINTA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA

A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

CESAR RAFAEL CARREGA, brasileiro, solteiro, nascido em 31/05/1985, empresário, portador do RG sob nº 9177472-0 SESP/PR e CPF sob nº 055.015.959-23, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tupi, nº 329 – Apartamento 804 – Centro – CEP: 86.020-350. Único sócio da Empresa Limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situado na Praça de Londrina - Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, nº 1581 – Santa

3

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

Mônica – CEP 86.079-450, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41212886685 em data de 30/09/2024, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 57.498.660/0001-61.

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** e gira na cidade de Londrina – Estado do Paraná na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450.

Parágrafo único: Nos termos da Instrução Normativa DREI n.º 112, de 20 de Janeiro de 2022, a sociedade permanecerá UNIPESSOAL.

2ª O objeto social da empresa é Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE 4664-8/00) e Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01).

3ª O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R\$
CESAR RAFAEL CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

4ª A sociedade iniciou suas atividades em 30 de Setembro de 2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá **CESAR RAFAEL CARREGA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

4

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

Parágrafo Primeiro: Faculta-se aos administradores, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei nº. 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª O sócio declara sob as penas da Lei que se enquadra na situação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

5

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

15º Fica eleito o foro de Londrina – Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de alteração contratual em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina - Paraná, 06 de Março de 2.026.

CESAR RAFAEL CARREGA

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA
08426521916	GUSTAVO HENRIQUE CARREGA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2026 09:39 SOB Nº 20261356062.
PROTOCOLO: 261356062 DE 09/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605173132. CNPJ DA SEDE: 57498660000161.
NIRE: 41212886685. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2026.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO					
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2 e 1 NOME E SOBRENOME CESAR RAFAEL CARREGA		1ª HABILITAÇÃO 01/09/2003			
		3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 31/05/1985, URUPES, SP			
4a DATA EMISSÃO 29/05/2025		4b VALIDADE 26/05/2035	ACC  D		
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 91774720 SESP PR					
4d CPE 055.015.959-23	5 Nº REGISTRO 03005477340		3 CAT HAB B		
NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)					
FILIAÇÃO JOSE MARCIO CARREGA					
ANTONIA MARIA MARTINS CARREGA					
 7 ASSINATURA DO PORTADOR					

9
10
11
12

ACC 			
A 			
A1 			
B 		26/05/2035	
B1 			
C 			
C1 			

9
10
11
12

D 			
DI 			
BE 			
CE 			
CIE 			
DE 			
DIE 			

12
13

LOCAL

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

13348045735

PR927453788

PARANÁ

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA030054773<409<<<<<<<<<<
8505316M3505263BRA<<<<<<<<<<8
CESAR<<RAFAEL<CARREGA<<<<<<<<

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Protocolo: PRC2602969444	
NIRE : 41212886685 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41212886685		CNPJ 57.498.660/0001-61		Data de Ato Constitutivo 30/09/2024	
Início de Atividade 30/09/2024					
Endereço Completo Avenida Henrique Mansano, Nº 1581, Santa Mônica - Londrina/PR - CEP 86079-450					
Objeto Social COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS E COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)				Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome CESAR RAFAEL CARREGA	CPF/CNPJ 055.015.959-23	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome CESAR RAFAEL CARREGA	CPF 055.015.959-23	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 14/03/2026	Número 20261356062	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2026, às 17:16:08 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **5JU2C3PD**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

SEBASTIÃO MOTA
Secretário-Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: PRC2602969576
NIRE 41212886685 CNPJ 57.498.660/0001-61				Situação ATIVA Status
Endereço Completo Avenida Henrique Mansano, Nº 1581, xxxxx, Santa Mônica - Londrina/PR - CEP 86079-450				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20261356062	14/03/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20261356062	14/03/2026	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20254931219	02/10/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20254931219	02/10/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
090	41212886685	30/09/2024	CONTRATO	NÃO
316	20246746203	30/09/2024	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2026, às 17:19:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **TKMG551J**.



PRC2602969576





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 57.498.660/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/09/2024	
NOME EMPRESARIAL STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV HENRIQUE MANSANO	NÚMERO 1581	COMPLEMENTO *****	
CEP 86.079-450	BAIRRO/DISTRITO SANTA MÔNICA	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO STARMEDICALHOSPITALAR@GMAIL.COM		TELEFONE (43) 8873-5559	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2024	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/07/2026 às 09:32:17 (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

57.498.660/0001-61

NOME EMPRESARIAL:

STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

CESAR RAFAEL CARREGA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **06/07/2026** às **09:32:30** (data e hora de Brasília).

**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
91099706-86	57.498.660/0001-61	09/2024

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	AV HENRIQUE MANSANO, 1581 - SANTA MONICA - CEP 86079-450 FONE: (43) 3771-6300
Município de Instalação	LONDRINA - PR, DESDE 09/2024 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 09/2024
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	055.015.959-23	CESAR RAFAEL CARREGA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 19/07/2026.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 91099706-86

Emitido Eletronicamente via Internet
19/06/2026 15:33:00



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 3582051

Nome Fantasia:

Razão Social: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 57.498.660/0001-61

Atividade Principal: 4664-8/00.00 - Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e pecas

Atividade(s) Secundária(s): 4645-1/01.00 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios

Município: Londrina **Endereço:** AVENIDA Henrique Mansano, 1581, Santa Mônica

CEP: 86079450

Local e data: Londrina, segunda, 30 de setembro de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Fazenda

Código de Autenticidade: **TJ19THLS**

"EMITIDO PELO SERVIDOR GERADO PELO SISTEMA"

Esse documento não autoriza o início de funcionamento da(s) atividade(s), indica apenas o cadastro da empresa para fins de tributação.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 57.498.660/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:13:41 do dia 24/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2026.

Código de controle da certidão: **6954.15CD.FA64.0C94**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39468074-39

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **57.498.660/0001-61**

Nome: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/09/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

**Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento**

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 7765262 / 2026

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 57.498.660/0001-61

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 15 de junho de 2026

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador

7Rp#jR3MX0YY

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.498.660/0001-61
Razão social: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA
Endereço: AV HENRIQUE MANSANO 1581 / SANTA MONICA / LONDRINA / PR / 86079-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/07/2026 a 02/08/2026

Certificação Número: 2026070402436411559206

Informação obtida em 06/07/2026 09:34:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 57.498.660/0001-61
Razão social: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/07/2026	04/07/2026 a 02/08/2026	2026070402436411559206
09/06/2026	09/06/2026 a 08/07/2026	2026060904296411559271
15/05/2026	15/05/2026 a 13/06/2026	2026051505116411559236
26/04/2026	26/04/2026 a 25/05/2026	2026042602476411559202
07/04/2026	07/04/2026 a 06/05/2026	2026040703436411559215
19/03/2026	19/03/2026 a 17/04/2026	2026031908116411559250
28/02/2026	28/02/2026 a 29/03/2026	2026022803476411559201
09/02/2026	09/02/2026 a 10/03/2026	2026020907406411559260
21/01/2026	21/01/2026 a 19/02/2026	2026012104506411559221
02/01/2026	02/01/2026 a 31/01/2026	2026010217536411559290
12/12/2025	12/12/2025 a 10/01/2026	2025121219536411559210
23/11/2025	23/11/2025 a 22/12/2025	2025112302196411559270
04/11/2025	04/11/2025 a 03/12/2025	2025110405186411559250
16/10/2025	16/10/2025 a 14/11/2025	2025101619276411559254
27/09/2025	27/09/2025 a 26/10/2025	2025092701556411559255
07/09/2025	07/09/2025 a 06/10/2025	2025090704396411559252
19/08/2025	19/08/2025 a 17/09/2025	2025081908566411559202
26/07/2025	26/07/2025 a 24/08/2025	2025072600556411559295
07/07/2025	07/07/2025 a 05/08/2025	2025070704596411559243
18/06/2025	18/06/2025 a 17/07/2025	2025061804306411559215
30/05/2025	30/05/2025 a 28/06/2025	2025053018386411559265
11/05/2025	11/05/2025 a 09/06/2025	2025051100576411559236
22/04/2025	22/04/2025 a 21/05/2025	2025042214116411559211

Resultado da consulta em 06/07/2026 09:35:06



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 57.498.660/0001-61

Certidão nº: 43053649/2026

Expedição: 20/04/2026, às 15:20:55

Validade: 17/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.498.660/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12503518701 em 26/02/2025, protocolo 251006255. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	41212886685
CNPJ:	57498660000161
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	30/09/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA	
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI	PR036115



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2025 09:16 SOB Nº 20251006255.
PROTOCOLO: 251006255 DE 25/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503518701. NIRE: 41212886685.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/02/2025
empresafacil.pr.gov.br

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 30/09/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1581

Complemento

Bairro: SANTA MONICA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 57.498.660/0001-61

Inscrição Estadual.....: 9109970686

Registro na junta.....: 41212886685 Data registro: 30/09/2024

Inscrição Municipal.....:

LONDRINA, 30/09/2024

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	150.000,00 + 0,00	300,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	150.000,00	300,00
	Passivo Circulante	500,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	150.000,00 - 0,00	300,00
	Passivo Circulante	500,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	150.000,00	300,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	150.000,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	500,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	149.500,00 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	0,00
	Ativo	150.000,00	

CESAR RAFAEL CARREGA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
 CONTADOR
 Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
 CPF: 640.713.679-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	150.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	150.000,00D
DISPONÍVEL	150.000,00D
CAIXA	150.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	150.000,00C
PASSIVO CIRCULANTE	500,00C
FORNECEDORES	500,00C
FORNECEDORES	500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.500,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	500,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	500,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(500,00)</u>	<u>(500,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(500,00)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(500,00)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(500,00)</u>

CESAR RAFAEL CARREGA SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 055.015.959-23	REGINALDO ANTONIO FIORI CONTADOR Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2 CPF: 640.713.679-20
--	---

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(500,00)
TOTAL	(500,00)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(500,00)

CESAR RAFAEL CARREGA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI

CONTADOR

Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2

CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ágio	150.000,00		150.000,00
Prejuízo Líquido		-500,00	-500,00
Saldo em 31/12/2024	150.000,00	-500,00	149.500,00

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	150.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	150.000,00
Aumento nas Disponibilidades	150.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	150.000,00

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Empresa: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** Folha: 11
CNPJ: 57.498.660/0001-61 Número livro: 0001
Insc. Junta Comercial: 41212886685 Data: 30/09/2024

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sociedade que gira na cidade de Londrina - Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE **41212886685** em data de 30/09/2024 e inscrita no CNPJ sob n.º 57.498.660/0001-61. Empresa com tributação optante pelo **SIMPLES NACIONAL**. Seu objeto social é Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

2 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em **31 de dezembro de 2024** aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Os administradores da empresa optaram **pela contratação de contabilidade terceirizada**, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativa do valor justa; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos.

3 - APRESENTAÇÃO DAS MOEDAS E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim o ativo, o passivo e o resultado apresentado nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moedas estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigente no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Ativo Circulante - A prática contábil adotada é pelo regime de Competência. A moeda funcional da empresa é o real, os direitos estão em conformidade com seus efetivos valores reais e vencíveis dentro do exercício;
- b) Passivo Circulante - Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos .

Empresa: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 57.498.660/0001-61
Insc. Junta Comercial: 41212886685 Data: 30/09/2024

Folha: 12
Número livro: 0001

5 - IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerados o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2.009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com suas contas delimitadas pelas taxas estabelecidas na legislação.

6 - PATRIMONIO LIQUIDO

O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R\$
CESAR RAFAEL CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

7 - PREVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE

A empresa está sujeita a contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a previsão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, quando necessário.

8 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em **31 de dezembro de 2024** estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

9 - RECEITAS E DESPESAS

As receitas da empresa são apuradas pelo valor justo recebido com base nas notas fiscais, e a despesa da empresa pelo valor justo incorrido através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e Fiscais.

10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em nenhum evento subsequente favorável ou desfavorável entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras apresentadas para aprovação.

11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12 - DAS INFORMAÇÕES

As informações relativas ao **período-base 31 de dezembro de 2024** fornecidas para escrituração

Empresa: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES** Folha: 13
LTDA
CNPJ: 57.498.660/0001-61 Número livro: 0001
Insc. Junta Comercial: 41212886685 Data: 30/09/2024

e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas, repassadas ao responsável técnico contábil pelo Administrador Sócio Responsável da empresa **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, sociedade que gira na cidade de Londrina - Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE **41212886685** em data de 30/09/2024 e inscrita no CNPJ sob n.º 57.498.660/0001-61.

13 - ESTOQUES

O estoque registrado em conta própria foi pelos Administradores e funcionários, levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em **31 de Dezembro de 2024**, e repassados ao responsável técnico para elaboração e transcrição ao Balanço Patrimonial.

14 - RESULTADO ABRANGENTE

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação do Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios. (Item 3.18 da resolução do CFC 1255/09)

15 - CONTINUIDADE

A empresa avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios. Não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

Socio Administrador

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CESAR RAFAEL CARREGA
Socio Administrador
C.P.F. 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
C.R.C. PR-036115/O-2
C.P.F. 640.713.679-20

Número: 1

Folha: 15

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 30/09/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1581

Complemento

Bairro: SANTA MONICA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 57.498.660/0001-61

Inscrição Estadual.....: 9109970686

Registro na junta.....: 41212886685 Data registro: 30/09/2024

Inscrição Municipal.....:

LONDRINA, 31/12/2024

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2025 09:16 SOB N° 20251006255.
PROTOCOLO: 251006255 DE 25/02/2025. NIRE: 41212886685.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/02/2025
empresafacil.pr.gov.br



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12608077932 em 30/04/2026, protocolo 262440180. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	41212886685
CNPJ:	57498660000161
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA	
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI	PR0361150



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2026 11:00 SOB Nº 20262440180.
PROTOCOLO: 262440180 DE 29/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608077932. NIRE: 41212886685.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/04/2026
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1581

Complemento

Bairro: SANTA MÔNICA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 57.498.660/0001-61

Inscrição Estadual.....: 9109970686

Registro na junta.....: 41212886685 Data registro: 30/09/2024

Inscrição Municipal.....:

LONDRINA, 01/01/2025

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
31/01/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180,00	
31/01/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		180,00
31/01/2025	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
31/01/2025	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS	700,00	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS		700,00
31/01/2025	3.3.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO	540,00	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO		540,00
31/01/2025	3.3.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS	300,00	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JUROS		300,00
			TOTAL DO DIA	12.720,00	12.720,00
			TOTAL DO MÊS	12.720,00	12.720,00
10/02/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	180,00	
10/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
28/02/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180,00	
28/02/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		180,00
28/02/2025	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS	700,00	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS		700,00
28/02/2025	3.3.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO	540,00	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO		540,00
			TOTAL DO DIA	5.420,00	5.420,00
			TOTAL DO MÊS	5.600,00	5.600,00
10/03/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	180,00	
10/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
31/03/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180,00	
31/03/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		180,00
31/03/2025	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS	700,00	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS		700,00
31/03/2025	3.3.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO	540,00	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO		540,00
31/03/2025	3.3.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS	300,00	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JUROS		300,00
			TOTAL DO DIA	5.720,00	5.720,00
			TOTAL DO MÊS	5.900,00	5.900,00
10/04/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	180,00	
10/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
30/04/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180,00	
30/04/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		180,00
30/04/2025	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS	700,00	
			TRANSPORTE	4.880,00	4.180,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.880,00	4.180,00
			PAGAMENTO DESPESAS GERAIS		700,00
30/04/2025	3.3.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO	540,00	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO		540,00
			TOTAL DO DIA	5.420,00	5.420,00
			TOTAL DO MÊS	5.600,00	5.600,00
10/05/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	180,00	
10/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
31/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
31/05/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180,00	
31/05/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		180,00
31/05/2025	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
31/05/2025	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS	700,00	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS		700,00
31/05/2025	3.3.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO	540,00	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO		540,00
31/05/2025	3.3.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS	300,00	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JUROS		300,00
			TOTAL DO DIA	8.720,00	8.720,00
			TOTAL DO MÊS	8.900,00	8.900,00
10/06/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	180,00	
10/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
30/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
30/06/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180,00	
30/06/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		180,00
30/06/2025	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS	700,00	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS		700,00
30/06/2025	3.3.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO	540,00	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO		540,00
			TOTAL DO DIA	5.420,00	5.420,00
			TOTAL DO MÊS	5.600,00	5.600,00
10/07/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	180,00	
10/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
31/07/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180,00	
31/07/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		180,00
31/07/2025	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS	700,00	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS		700,00
31/07/2025	3.3.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO	540,00	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO		540,00
31/07/2025	3.3.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS	300,00	
			TRANSPORTE	5.720,00	5.420,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.720,00	5.420,00
			JUROS		300,00
			TOTAL DO DIA	5.720,00	5.720,00
			TOTAL DO MÊS	5.900,00	5.900,00
10/08/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	180,00	
10/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
31/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
31/08/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180,00	
31/08/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		180,00
31/08/2025	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
31/08/2025	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS	700,00	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS		700,00
31/08/2025	3.3.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO	540,00	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO		540,00
			TOTAL DO DIA	11.920,00	11.920,00
			TOTAL DO MÊS	12.100,00	12.100,00
10/09/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	180,00	
10/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
30/09/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180,00	
30/09/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		180,00
30/09/2025	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS	700,00	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS		700,00
30/09/2025	3.3.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO	540,00	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO		540,00
30/09/2025	3.3.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS	300,00	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JUROS		300,00
			TOTAL DO DIA	5.720,00	5.720,00
			TOTAL DO MÊS	5.900,00	5.900,00
10/10/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	180,00	
10/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
31/10/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180,00	
31/10/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		180,00
31/10/2025	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS	700,00	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS		700,00
31/10/2025	3.3.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO	540,00	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO		540,00
			TOTAL DO DIA	5.420,00	5.420,00
			TOTAL DO MÊS	5.600,00	5.600,00
10/11/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	180,00	
TRANSPORTE				180,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	180,00	
			PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
30/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
30/11/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180,00	
30/11/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		180,00
30/11/2025	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS	700,00	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS		700,00
30/11/2025	3.3.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO	540,00	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO		540,00
30/11/2025	3.3.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS	300,00	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JUROS		300,00
			TOTAL DO DIA	5.720,00	5.720,00
			TOTAL DO MÊS	5.900,00	5.900,00
10/12/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	180,00	
10/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
31/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
31/12/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	270,00	
31/12/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		270,00
31/12/2025	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
31/12/2025	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS	800,00	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS		800,00
31/12/2025	3.3.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO	560,00	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO		560,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	6.500,00	
31/12/2025	3.3.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		6.500,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	1.800,00	
31/12/2025	3.3.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		1.800,00
31/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	50.000,00	
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		50.000,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	2.250,00	
31/12/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		2.250,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	17.500,00	
31/12/2025	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		17.500,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	8.500,00	
31/12/2025	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		8.500,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	13.450,00	
31/12/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		13.450,00
31/12/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	13.450,00	
31/12/2025	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		13.450,00
31/12/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	270,00	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		270,00
31/12/2025	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	TRANSF SALDO	500,00	
			TRANSPORTE	122.850,00	122.350,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.3.3.01.00002	(-) PREJUIZO ACUMULADOS	TRANSPORTE	122.850,00	122.350,00
			TRANSF SALDO		500,00
			TOTAL DO DIA	122.850,00	122.850,00
			TOTAL DO MÊS	123.030,00	123.030,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	150.000,00D	50.000,00	36.550,00	163.450,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	150.000,00D	50.000,00	36.550,00	163.450,00D
3	DISPONÍVEL	150.000,00D	50.000,00	36.550,00	163.450,00D
4	CAIXA	150.000,00D	50.000,00	36.550,00	163.450,00D
5	CAIXA GERAL	150.000,00D	50.000,00	36.550,00	163.450,00D
149	PASSIVO	150.000,00C	16.200,00	16.200,00	150.000,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	500,00C	2.250,00	2.250,00	500,00C
164	FORNECEDORES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
165	FORNECEDORES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.500,00C	13.950,00	13.950,00	149.500,00C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	500,00D	13.950,00	13.950,00	500,00D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	500,00D	13.950,00	13.950,00	500,00D
266	LUCRO ACUMULADOS	0,00	500,00	13.450,00	12.950,00C
267	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00D
402	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	36.550,00	50.000,00	13.450,00C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	0,00	2.250,00	50.000,00	47.750,00C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
269	CUSTSO DE PRODUCAO DIRETA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
1029	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
228	BOLSA-AUXÍLIO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
1064	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
CESAR RAFAEL CARREGA SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 055.015.959-23		REGINALDO ANTONIO FIORI CONTADOR Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2 CPF: 640.713.679-20			

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	163.450,00 + 0,00	326,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	163.450,00	326,90
	Passivo Circulante	500,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	163.450,00	326,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	0,00
	Ativo Total	163.450,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	500,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	162.950,00 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	0,00
	Ativo	163.450,00	

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	163.450,00D	150.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	163.450,00D	150.000,00D
DISPONÍVEL	163.450,00D	150.000,00D
CAIXA	163.450,00D	150.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	163.450,00C	150.000,00C
PASSIVO CIRCULANTE	500,00C	500,00C
FORNECEDORES	500,00C	500,00C
FORNECEDORES	500,00C	500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.950,00C	149.500,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.950,00C	500,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.950,00C	500,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 163.450,00 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta reais)

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	50.000,00	0,00
DEDUÇÕES	(2.250,00)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	47.750,00	0,00
CUSTOS	(17.500,00)	0,00
LUCRO BRUTO	30.250,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(15.000,00)	(500,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(6.500,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.500,00)	(500,00)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	15.250,00	(500,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.800,00)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	13.450,00	(500,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>13.450,00</u>	<u>(500,00)</u>

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2025	2024
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	13.450,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(500,00)	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(500,00)
TOTAL	12.950,00	(500,00)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.950,00	(500,00)

CESAR RAFAEL CARREGA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI

CONTADOR

Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2

CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ágio	150.000,00		150.000,00
Prejuízo Líquido	0,00	-500,00	-500,00
Saldo em 31/12/2024	150.000,00	-500,00	149.500,00
Lucro Líquido	0,00	13.450,00	13.450,00
Saldo em 31/12/2025	150.000,00	12.950,00	162.950,00

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	50.000,00	0,00
Valores pagos a fornecedores	(17.500,00)	0,00
Valores pagos a empregados	(6.500,00)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	26.000,00	0,00
Tributos pagos	(2.250,00)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	23.750,00	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(10.300,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.450,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	150.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	150.000,00
Aumento nas Disponibilidades	13.450,00	150.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	150.000,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	163.450,00	150.000,00

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Empresa: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** Folha: 15
CNPJ: 57.498.660/0001-61 Número livro: 0002
Insc. Junta Comercial: 41212886685 Data: 30/09/2024

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sociedade que gira na cidade de Londrina - Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE **41212886685** em data de 30/09/2024 e inscrita no CNPJ sob n.º 57.498.660/0001-61. Empresa com tributação optante pelo **SIMPLES NACIONAL**. Seu objeto social é Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

2 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em **31 de dezembro de 2025** aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Os administradores da empresa optaram **pela contratação de contabilidade terceirizada**, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativa do valor justa; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos.

3 - APRESENTAÇÃO DAS MOEDAS E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim o ativo, o passivo e o resultado apresentado nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moedas estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigente no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Ativo Circulante - A prática contábil adotada é pelo regime de Competência. A moeda funcional da empresa é o real, os direitos estão em conformidade com seus efetivos valores reais e vencíveis dentro do exercício;
- b) Passivo Circulante - Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos .

Empresa: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES** Folha: 16
LTDA
 CNPJ: 57.498.660/0001-61 Número livro: 0002
 Insc. Junta Comercial: 41212886685 Data: 30/09/2024

5 - IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerados o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2.009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com suas contas delimitadas pelas taxas estabelecidas na legislação.

6 - PATRIMONIO LIQUIDO

O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R\$
GUSTAVO HENRIQUE CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

7 - PREVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE

A empresa está sujeita a contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a previsão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, quando necessário.

8 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em **31 de dezembro de 2025** estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

9 - RECEITAS E DESPESAS

As receitas da empresa são apuradas pelo valor justo recebido com base nas notas fiscais, e a despesa da empresa pelo valor justo incorrido através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e Fiscais.

10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em nenhum evento subsequente favorável ou desfavorável entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras apresentadas para aprovação.

11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12 - DAS INFORMAÇÕES

As informações relativas ao **período-base 31 de dezembro de 2025** fornecidas para escrituração

Empresa: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES** Folha: 17
LTD A
CNPJ: 57.498.660/0001-61 Número livro: 0002
Insc. Junta Comercial: 41212886685 Data: 30/09/2024

e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas, repassadas ao responsável técnico contábil pelo Administrador Sócio Responsável da empresa **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, sociedade que gira na cidade de Londrina - Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE **41212886685** em data de 30/09/2024 e inscrita no CNPJ sob n.º 57.498.660/0001-61.

13 - ESTOQUES

O estoque registrado em conta própria foi pelos Administradores e funcionários, levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em **31 de Dezembro de 2025**, e repassados ao responsável técnico para elaboração e transcrição ao Balanço Patrimonial.

14 - RESULTADO ABRANGENTE

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação do Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios. (Item 3.18 da resolução do CFC 1255/09)

15 - CONTINUIDADE

A empresa avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios. Não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

Socio Administrador

RESPONSAVEL TECNICO

CESAR RAFAEL CARREGA
Socio Administrador
C.P.F. 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
C.R.C. PR-036115/O-2
C.P.F. 640.713.679-20

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	5
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADOS	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
269 S	3.2	CUSTSO DE PRODUCAO DIRETA	2
514 S	3.2.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.2.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	4
1029	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	5
295 S	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2
430 S	3.3.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367 S	3.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.3.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
329 S	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
228	3.3.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	5
353 S	3.3.3.04	DESPESAS GERAIS	4
1064	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Número: 2**Folha: 19**

Contém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1581

Complemento

Bairro: SANTA MÔNICA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 57.498.660/0001-61

Inscrição Estadual.....: 9109970686

Registro na junta.....: 41212886685 Data registro: 30/09/2024

Inscrição Municipal.....:

LONDRINA, 31/12/2025

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2026 11:00 SOB Nº 20262440180.
PROTOCOLO: 262440180 DE 29/04/2026. NIRE: 41212886685.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/04/2026
empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DO ESTADO DO PARANÁ



CATEGORIA

Nº DO REGISTRO

CONTADOR
NOME

PR-036115/O-2

REGINALDO ANTONIO FIORI

FILIAÇÃO

ANTONIO LEONILDO FIORI

ALZIRA DE PAULA FIORI

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO

NACIONALIDADE

NATURALIDADE

21/11/1970

BRASILEIRA

IBIPORA-PR

DIPLOMAÇÃO

CPF

RG

27/10/2008

640.713.679-20

46693523 SSP-PR

TÍTULO

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

INST ENSINO SUPERIOR DE LONDRINA - NESUL

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO

06/06/2014

Lucelia Lecheta
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : REGINALDO ANTONIO FIORI
REGISTRO..... : PR-036115/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.713.679-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 30/06/2026 as 11:05:13.

Válido até: 28/09/2026.

Código de Controle: 6230028.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARANÁ

Categoria
CONTADOR


Nº Registro
PR-036115/O-2

Nome
REGINALDO ANTONIO FIORI

Nascimento
21/11/1970

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
IBIPORA-PR


Assinatura do Profissional



Filiação
ANTONIO LEONILDO FIORI
ALZIRA DE PAULA FIORI

CPF
640.713.679-20

Documento de Identificação
46693523 SSP-PR

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
26/12/1994

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **B5320F**



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARANÁ



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/64071367920/codigo/B5320F>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023, às 10:22.**



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/12/2025 10:52:35 que o documento de hash (SHA-256)
834ec8ea62a6297c9f4ee3ab968c811367b108d726f4a8677a91ab60ae2fb511 foi validado em 08/12/2025 10:50:46 através da transação blockchain
0xc1b5fccae38fcf396bf432ec4c19ec13a45886dd36059234020fe74132a63d55 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 299063)





v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/12/2025 10:52:35 que o documento de hash (SHA-256)
834ec8ea62a6297c9f4ee3ab968c811367b108d726f4a8677a91ab60ae2fb511 foi validado em 08/12/2025 10:50:46 através da transação blockchain
0xc1b5fccae38fcf396bf432ec4c19ec13a45886dd36059234020fe74132a63d55 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 299063)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 08/03/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **834ec8ea62a6297c9f4ee3ab968c811367b108d726f4a8677a91ab60ae2fb511** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **299063** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**crc contador**", cujo assunto é descrito como "**crc contador**", faz prova de que em **08/12/2025 10:51:00**, o responsável **M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda (32.593.430/0001-50)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/12/2025 10:52:35** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc1b5fccae38fcf396bf432ec4c19ec13a45886dd36059234020fe74132a63d55**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP

A empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61**, com sede na AV HENRIQUE MANSANO, 1581 JD ALPES, CEP CEP 86.079-450, LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. CESAR RAFAEL CARREGA portador da Carteira de Identidade nº 9177472-0 SESP/PR e do CPF nº 055.015.959-23, DECLARA, para fins sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

☐ **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

☒ **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

REGINALDO
ANTONIO
FIORI:6407136792
0

Assinado de forma digital
por REGINALDO ANTONIO
FIORI:6407136792
Dados: 2026.05.06 13:02:30
-03'00'

Contador-CRC PR 036115/O-2
Reginaldo Antônio Fiori

CESAR RAFAEL
CARREGA:055
01595923

Assinado de forma
digital por CESAR
RAFAEL
CARREGA:055015959
23

Representante Legal
Cesar Rafael Carrega

Londrina, 06 de maio de 2026.



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Edenilson Donisete Macri

Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Victor Tristão Pascual

CERTIDÃO

"PARA FINS GERAIS"

Busca não contempla Execuções de Pena do Sistema SEEU

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos de distribuição CÍVEL (inclusive Interdição, Tutela, Curatela, Protesto contra Alienação de Bens, Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial ou Insolvência), FAZENDA PÚBLICA, EXECUÇÃO FISCAL (Estadual e Municipal), CRIMINAL, JUIZADO ESPECIAL (Cível, Fazenda Pública e Criminal), FAMÍLIA e SUCESSÕES do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído nesta Comarca feito algum contra:

Nome **STARMEDICAL IMPORTACAO E ESPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ **57.498.660/0001-61**

Local da sede **LONDRINA-PR**

CUSTAS: R\$ 48,00

Lei Estadual nº 22.956/2025 - Tabela VIII



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=1167D76C317BB32B04581F9BD4B58ED6>

Busca referente aos últimos 20 anos.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 19 de Junho de 2026.

Assinado eletronicamente por

IWERLEI BUENO MORAES

CPF : 727.061.809-78

Dados: 2026-06-22 16:58:56

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes

Empregado Juramentado



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná
Poder Judiciário

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 05/07/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que em cada uma das Comarcas abaixo listadas existe 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público.

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que em cada uma das sedes nas Comarcas abaixo listadas existe a quantidade indicada de Serventias Extrajudiciais com competência em Protesto de Títulos.

Comarca	Serventias Extrajudiciais com competência em Protesto de Títulos	Comarca	Serventias Extrajudiciais com competência em Protesto de Títulos
Almirante Tamandaré - Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Mandaguari - Foro Regional de Mandaguari da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Altônia	1 (uma)	Mandirituba	1 (uma)
Alto Paraná	1 (uma)	Mangueirinha	1 (uma)
Alto Piquiri	1 (uma)	Manoel Ribas	1 (uma)
Ampére	1 (uma)	Marechal Cândido Rondon	1 (uma)
Andirá	1 (uma)	Marialva - Foro Regional de Marialva da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Antonina	1 (uma)	Marilândia do Sul	1 (uma)
Apucarana	1 (uma)	Maringá - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	2 (duas)
Arapongas	1 (uma)	Marmeleiro	1 (uma)
Arapoti	1 (uma)	Matelândia	1 (uma)
Araucária - Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Matinhos	1 (uma)
Assaí	1 (uma)	Medianeira	1 (uma)
Assis Chateaubriand	1 (uma)	Morretes	1 (uma)
Astorga	1 (uma)	Nova Aurora	1 (uma)

Bandeirantes	1 (uma)	Nova Esperança - Foro Regional de Nova Esperança da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Barbosa Ferraz	1 (uma)	Nova Fátima	1 (uma)
Barracão	1 (uma)	Nova Londrina	1 (uma)
Bela Vista do Paraíso	1 (uma)	Ortigueira	1 (uma)
Bocaiúva do Sul	1 (uma)	Palmas	1 (uma)
Cambará	1 (uma)	Palmeira	1 (uma)
Cambé - Foro Regional de Cambé da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	2 (duas)	Palmital	1 (uma)
Campina da Lagoa	1 (uma)	Palotina	1 (uma)
Campina Grande do Sul - Foro Regional de Campina Grande do Sul da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Paraíso do Norte	1 (uma)
Campo Largo - Foro Regional de Campo Largo Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Paranacity	1 (uma)
Campo Mourão	2 (duas)	Paranaguá	2 (duas)
Cândido de Abreu	1 (uma)	Paranavaí	1 (uma)
Cantagalo	1 (uma)	Pato Branco	1 (uma)
Capanema	1 (uma)	Peabiru	1 (uma)
Capitão Leônidas Marques	1 (uma)	Pérola	1 (uma)
Carlópolis	1 (uma)	Pinhais - Foro Regional de Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)
Cascavel	2 (duas)	Pinhão	1 (uma)
Castro	1 (uma)	Piraí do Sul	1 (uma)
Catanduvas	1 (uma)	Piraquara	1 (uma)
Centenário do Sul	1 (uma)	Pitanga	1 (uma)
Cerro Azul	1 (uma)	Ponta Grossa	2 (duas)
Chopinzinho	1 (uma)	Pontal do Paraná	1 (uma)
Cianorte	1 (uma)	Porecatu	1 (uma)
Cidade Gaúcha	1 (uma)	Primeiro de Maio	1 (uma)
Civelândia	1 (uma)	Prudentópolis	1 (uma)
Colombo - Foro Regional de Colombo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Quatro Barras - Foro Regional de Quatro Barras da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)
Colorado	1 (uma)	Quedas do Iguaçu	1 (uma)
Congonhinhas	1 (uma)	Realeza	1 (uma)
Corbélia	1 (uma)	Rebouças	1 (uma)
Cornélio Procopio	1 (uma)	Reserva	1 (uma)
Coronel Vivida	1 (uma)	Ribeirão Claro	1 (uma)
Cruzeiro do Oeste	1 (uma)	Ribeirão do Pinhal	1 (uma)

Curiúva	1 (uma)	Rio Branco do Sul	1 (uma)
Dois Vizinhos	1 (uma)	Rio Negro	1 (uma)
Engenheiro Beltrão	1 (uma)	Rolândia - Foro Regional de Rolândia da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	1 (uma)
Faxinal	1 (uma)	Salto do Lontra	1 (uma)
Fazenda Rio Grande - Foro Regional de Fazenda Rio Grande da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Santa Fé	1 (uma)
Formosa do Oeste	1 (uma)	Santa Helena	1 (uma)
Foz do Iguaçu	1 (uma)	Santa Izabel do Ivaí	1 (uma)
Francisco Beltrão	1 (uma)	Santa Mariana	1 (uma)
Goioerê	1 (uma)	Santo Antônio da Platina	1 (uma)
Grandes Rios	1 (uma)	Santo Antônio do Sudoeste	1 (uma)
Guaira	1 (uma)	São Jerônimo da Serra	1 (uma)
Guaraniaçu	1 (uma)	São João	1 (uma)
Guarapuava	2 (duas)	São João do Ivaí	1 (uma)
Guaratuba	1 (uma)	São João do Triunfo	1 (uma)
Ibaiti	1 (uma)	São José dos Pinhais - Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	2 (duas)
Ibiporã - Foro Regional de Ibiporã da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	1 (uma)	São Mateus do Sul	1 (uma)
Icaraíma	1 (uma)	São Miguel do Iguaçu	1 (uma)
Imbituva	1 (uma)	Sarandí - Foro Regional de Sarandí da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Ipiranga	1 (uma)	Sengés	1 (uma)
Iporã	1 (uma)	Sertanópolis	1 (uma)
Irati	1 (uma)	Siqueira Campos	1 (uma)
Iretama	1 (uma)	Teixeira Soares	1 (uma)
Ivaiporã	1 (uma)	Telêmaco Borba	1 (uma)
Jacarezinho	1 (uma)	Terra Boa	1 (uma)
Jaguapitã	1 (uma)	Terra Rica	1 (uma)
Jaguariaíva	1 (uma)	Terra Roxa	1 (uma)
Jandaia do Sul	1 (uma)	Tibagi	1 (uma)
Joaquim Távora	1 (uma)	Toledo	1 (uma)
Lapa	1 (uma)	Tomazina	1 (uma)
Laranjeiras do Sul	1 (uma)	Ubiratã	1 (uma)
Loanda	1 (uma)	Umuarama	2 (duas)
Londrina - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	3 (três)	União da Vitória	1 (uma)

Mallet	1 (uma)	Uraí	1 (uma)
Mamborê	1 (uma)	Wenceslau Braz	1 (uma)
Mandaguaçu - Foro Regional de Mandaguaçu da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)	Xambrê	1 (uma)

15 de abril de 2026.

Mônica Miranda Gama Monteiro
Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça
(Art. 46, §1º, da Resolução nº 511- OE de 1º de setembro de 2025)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 19.875.046/0001-82

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO, inscrito no CNPJ sob o nº 19.875.046/0001-82, sediado na Praça Luís Ensich, 64 - Centro, Cel. Fabriciano - MG, 35170-002, ATESTA, para composição de seu acervo técnico, que a empresa **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, inscrita CNPJ: 57.498.660/0001-61, realizou a entrega integralmente, em conformidade com as especificações técnicas, prazos e demais condições estabelecidas no processo, tendo sido concluídas todas as obrigações contratuais assumidas, decorrentes do Processo de Compra: 32/2026, sendo este: **01 Aparelho de anestesia com ventilador pulmonar integrado para o Hospital Dr. José Maria de Moraes, no valor de R\$ 73.451,66 (setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos)**, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Documento assinado digitalmente
gov.br GISELLY DE OLIVEIRA BARBOSA
Data: 13/07/2026 09:55:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GISELLY DE OLIVEIRA BARBOSA
MATRÍCULA: 173547
GERENTE ADMINISTRATIVA



Rua Platina, nº 288, Centro Administrativo Mariano Pires Pontes;
Bairro Bom Jesus – Coronel Fabriciano | Tel.: (31) 3406-7410
Endereço eletrônico: www.fabriciano.mg.gov.br



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 13/07/2026 11:21:43 que o documento de hash (SHA-256)
9e19bf203d9527cc5178462476f5c25748840a542d5fa1bc9082fbaeed4e0214 foi validado em 13/07/2026 11:20:38 através da transação blockchain
0x0d308966df3e6404eda0640efeb0f1cc2eff9598081086c4b2d032a3f5572cf e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 324318)



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  STARMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES Avenida Henrique Mansano, 1581 Santa Mônica Londrina – PR CEP 86079-450 FONE: (43) 3334-3142 / 9 8874-3853		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.155 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4126 0657 4986 6000 0161 5500 1000 0001 5519 4179 6005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260210731290 01/06/2026 11:34:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 910.99706-86		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 57.498.660/0001-61	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 19.875.046/0001-82	
ENDEREÇO PC LOUIS ENSCH, 64 - PREF MUNICIPAL				DATA DE EMISSÃO 01/06/2026	
MUNICÍPIO CORONEL FABRICIANO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/06/2026	
FONE/FAX (31)3846-7013				UF MG	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 11:33:51	
FATURA/DUPLICATA					
001 01/07/2026 R\$ 73.451,66					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73.451,66	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 73.451,66	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRETEBRAS		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		CNPJ/CPF	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO PRODUTO 531	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO APARELHO DE ANESTESIA	NCM/SH 90189099	CSOSN 0400	CFOP 6108	UNID. UN
		QUANT. 1	VALOR UNITÁRIO 73.451,66	VALOR TOTAL 73.451,66	BC ICMS 0,00
					VALOR ICMS 0,00
					ALIQ. ICMS 0

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE À ORDEM DE COMPRA 2799 - PREGAO 12 - EMPENHO 7694 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL DR.JOSE MARIA MORAIS - RUA ARGEMIRO JOSE RIBEIRO, Nº 39 - BAIRRO SANTA HELENA - CORONEL FABRICIANO/MG - CEP 35170-005 - HORARIO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H00 AS 16H00 VEND. BRUNA - 04/05/2026 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 isencao icms conforme convenio lcms n. 087 de 28 de junho de 2002. DADOS BANCARIOS STARMEDICAL BANCO DO BRASIL AG: 1582-2 CC: 42.441-2						RESERVADO AO FISCO			
Recebemos de STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/06/2026,Valor Total: R\$73.451,66. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO PC LOUIS ENSCH, 64 - PREF MUNICIPAL - CENTRO - CORONEL FABRICIANO/MG						NF-e Nº 000.000.155 SÉRIE: 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							
Kralen Sistemas (44) 3024-5011									



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 13/07/2026 11:21:43 que o documento de hash (SHA-256)
9e19bf203d9527cc5178462476f5c25748840a542d5fa1bc9082fbaeed4e0214 foi validado em 13/07/2026 11:20:38 através da transação blockchain
0x0d308966df3e6404eda0640efeb0f1cc2efff9598081086c4b2d032a3f5572cf e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 324318)





SANTA CASA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 86.787.603/0001-09
Email: licitasantacasa@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SANTA CASA MUNICIPAL DE SAÚDE E PIMENTA-MG, inscrita no CNPJ sob o nº **86.787.603/0001-09**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **LIGIA BERALDO DE OLIVEIRA**, ATESTA, para os devidos fins, que, a empresa **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **57.498.660/0001-61**, com sede na **Av. Henrique Mansano, 1581, Jardim Alpes, CEP 86079-450, Londrina/PR**, forneceu à nossa instituição os materiais/produtos abaixo descritos:

OBJETO: Monitor Multiparametros

QUANTIDADE: 01

VALOR: 5.099,00

SOB O EMPENHO: 152

OBJETO: Cardioversor

QUANTIDADE: 01

VALOR: 13.869,00

SOB O EMPENHO: 152

Declaramos ainda que os produtos foram entregues **dentro do prazo estabelecido**, em conformidade com as especificações solicitadas, apresentando **qualidade satisfatória e perfeito desempenho**, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone sua capacidade técnica, comercial e operacional.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais necessários.

Pimenta, 15 de abril de 2026.

LIGIA BERALDO
DE
OLIVEIRA:0367604
4690

Assinado de forma digital
por LIGIA BERALDO DE
OLIVEIRA:03676044690
Dados: 2026.04.15
12:18:33 -03'00'

Ligia Beraldo de Oliveira
Diretora Administrativa



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  STARMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES Avenida Henrique Mansano, 1581 Santa Mônica Londrina – PR CEP 86079-450 FONE: (43) 3334-3142 / 9 8874-3853		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4126 0357 4986 6000 0161 5500 1000 0000 0711 3772 6083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260118870944 27/03/2026 16:00:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 910.99706-86		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 57.498.660/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 86.787.603/0001-09		DATA DE EMISSÃO 27/03/2026	
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 35585-000	
ENDEREÇO RUA TOTONHO COSTA, 230				MUNICÍPIO PIMENTA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/03/2026	
FONE/FAX (37)3734-2178				UF MG		HORA DE SAÍDA 15:59:58	

FATURA/DUPLICATA			
001 26/04/2026 R\$ 18.968,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.968,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 18.968,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
191	CARDIOVERSOR	90181980	040	6108	UN	1	13.869,00	13.869,00	0,00	0,00	0
667	MONITOR MULTIPARAMETRICO	90181980	040	6108	UN	1	5.099,00	5.099,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A NAF 105 - PREGAO 01/2026 LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA - MG VEND. BEATRIZ - 20/02/2026 isencao icms conforme convenio lcms n. 087 de 28 de junho de 2002. DADOS BANCARIOS STARMEDICAL BANCO DO BRASIL AG: 1582-2 CC: 42.441-2	
RESERVADO AO FISCO	

Recebemos de STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/03/2026, Valor Total: R\$18.968,00, Destinatário: SANTA CASA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA RUA TOTONHO COSTA, 230 - CENTRO - PIMENTA/MG		NF-e Nº 000.000.007 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kralen Sistemas (44) 3024-5011



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 13/07/2026 11:21:43 que o documento de hash (SHA-256)
9e19bf203d9527cc5178462476f5c25748840a542d5fa1bc9082fbaeed4e0214 foi validado em 13/07/2026 11:20:38 através da transação blockchain
0x0d308966df3e6404eda0640efeb0f1cc2efff9598081086c4b2d032a3f5572cf e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 324318)





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **57.498.660/0001-61**, com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Av. Henrique Mansano nº 1581 – JD SANTA MÔNICA, CEP 86079-450, faz parte do quadro fornecedores de nossa empresa, sendo que esta empresa fornece equipamentos diversos, material de consumo, instrumentais, moveis hospitalares, acessórios, parte e peças destinados a nossa área medico hospitalar conforme segue abaixo:

Correlatos em Geral

Atadura de Crepe / Gessada / Ortopédica; Avental (manga longa/curta); Campo Cirúrgico; Cateter Intravenoso; Cateter Venoso; Clamp Umbilical; Coletor de Urina; Coletor Perfuro-cortante; Compressa de Gaze Estéril; Compressa de Gaze Não Estéril; Curativo; DIU; Dreno de Aspiração; Dreno de Kher / Penrose / Sucção / Tórax; Eletrodo Adulto / Infantil; Equipos; Escova Ginecológica; Esparadrapo; Espátula de Ayres; Espéculos; Extensão para Aspirador; Extensão para Gases; Fita Adesiva Hospitalar / Autoclave / Estufa; Frasco para Alimentação Enteral; Fraldas Geriátricas / Infantil; Gaze Tipo Queijo; Gel ECG / Ultrassom; Gorro Descartável; Propes; Haste Flexível; Histerometro; Lamina de Bisturi; Lençol Descartável; Luva Cirúrgica / Procedimento; Mascaras Descartável; Mascara N95; Óculos de proteção individual; Saco para cadáver; Papel Toalha; Instrumentais; Preservativo; Sondas; Tubo de Látex / Silicone Uripen; Aço Inox: Bacia / Baldes / Bandejas / Cubas / Lixeiras.

Produtos Ortopédicos para Reabilitação em geral

Cadeira de Rodas / Cadeiras de Banho / Andadores / Barras de apoio / Bengalas / Muletas e outros.

Equipamentos Médicos-Fisioterapêuticos e Odontológicos em geral

Diagnósticos: Aparelho de Pressão / Balanças / Estetoscópio / Laringoscópio / Termômetros / Otoscopios / Lanterna / Detector Fetal / Oftalmoscópio / Ultrassom / Multicorrentes / Bicicleta Ergométricas / Esteira Ergométricas e outros.

Equipamentos: Aspiradores / Autoclaves / Bisturi / Eletrocardiógrafo / Focos Cirúrgicos / Monitores / Oxímetros / Desfibriladores / Profilaxia / Caneta de Alta Rotação / Acessórios e outros.

Moveis: Carros de emergência / Carro padiola com e sem elevação / Carro Maca / Mesa auxiliar / Mesa de exame / Poltronas e outros.

Tendo Cumprido satisfatoriamente com todos seus compromissos contratuais em qualidade e quantidades solicitadas. Apresentando ainda pontualidade na entrega e eficiência no controle de qualidade, não tendo nada que desabone a conduta do bom conceito técnico da referida empresa. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Londrina, 15 de Abril de 2026.

GUILHERME THOMAZ
GUIMARAES
RIBEIRO:00974810924
Assinado de forma digital
por GUILHERME THOMAZ
GUIMARAES
RIBEIRO:00974810924
Dados: 2026.04.15 10:58:22
-03'00'

Guilherme Thomaz Guimarães Ribeiro
Sócio/Diretor
CPF: 009.748.109-24



(43) 3336-9222



pedidos@gtmedhospitalar.com.br
comercial@gtmedhospitalar.com.br
financeiro@gtmedhospitalar.com.br



Rua Antonio Sabino, 210,
Setor A - Parque Industrial -
Ibiporã - PR
CEP: 86200-000



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 13/07/2026 11:21:43 que o documento de hash (SHA-256)
9e19bf203d9527cc5178462476f5c25748840a542d5fa1bc9082fbaeed4e0214 foi validado em 13/07/2026 11:20:38 através da transação blockchain
0x0d308966df3e6404eda0640efeb0f1cc2efff9598081086c4b2d032a3f5572cf e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 324318)



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  STARMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES Avenida Henrique Mansano, 1581 Santa Mônica Londrina – PR CEP 86079-450 FONE: (43) 3334-3142 / 9 8874-3853		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4126 0457 4986 6000 0161 5500 1000 0000 2115 1107 3996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260144127303 15/04/2026 10:27:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 910.99706-86		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 57.498.660/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				39.707.683/0001-57		15/04/2026	
ENDEREÇO RUA ANTONIO SABINO, 210 - SETOR A				BAIRRO/DISTRITO SETOR 3		CEP 86206-261	
MUNICÍPIO IBIPORA				FONE/FAX (43)3336-9222		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.68485-00		HORA DE SAÍDA 10:27:39	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	43.600,00
VALOR TOTAL DA NOTA	
43.600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Rem (CIF)									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
	VOLUME										

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
334	BOMBA DE INFUSAO	90189010	0102	5102	UN	1	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0	
92	CADEIRA DE RODAS ADULTO	87131000	0102	5102	UN	5	620,00	3.100,00	0,00	0,00	0	
93	CADEIRA DE RODAS OBESO	87131000	0102	5102	UN	5	990,00	4.950,00	0,00	0,00	0	
676	CARDIOTOCOGRFO	90181980	0102	5102	UN	1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0	
191	CARDIOVERSOR	90181980	0102	5102	UN	1	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0	
721	CPAP	90192090	0102	5102	UN	1	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0	
215	DESFIBRILADOR	90189096	0102	5102	UN	1	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0	
512	ELETROCARDIOGRAFO	90181100	0102	5102	UN	1	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0	
165	KIT LARINGOSCOPIO	90189099	0102	5102	UN	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0	
537	OXIMETRO DE PULSO	90181980	0102	5102	UN	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	
		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Artigo 28, inciso I, do Anexo VIII do RICMS/PR (aliquota 18, resultado e 12%) DADOS BANCARIOS STARMEDICAL BANCO DO BRASIL AG: 1582-2 CC: 42.441-2			

Recebemos de STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/04/2026, Valor Total: R\$43.600,00, Destinatário: GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA RUA ANTONIO SABINO, 210 - SETOR A - SETOR 3 - IBIPORA/PR		NF-e Nº 000.000.021 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Kralen Sistemas (44) 3024-5011



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 13/07/2026 11:21:43 que o documento de hash (SHA-256)
9e19bf203d9527cc5178462476f5c25748840a542d5fa1bc9082fbaeed4e0214 foi validado em 13/07/2026 11:20:38 através da transação blockchain
0x0d308966df3e6404eda0640efeb0f1cc2efff9598081086c4b2d032a3f5572cf e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 324318)



Prova de Autenticidade válida até 11/10/2026

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 11/10/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **9e19bf203d9527cc5178462476f5c25748840a542d5fa1bc9082fbaeed4e0214** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **324318** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO**", faz prova de que em **13/07/2026 11:20:48**, o responsável **Starmedical Importacao e Exportacao De Produtos Hospitalares Ltda (57.498.660/0001-61)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Starmedical Importacao e Exportacao De Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/07/2026 11:21:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x0d308966df3e6404eda0640efeb0f1cc2efff9598081086c4b2d032a3f5572cf**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Empresa ► Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Processo Nº. PRB2400971455

Inscrição Municipal: 3582051

S.F.A. 256084

Razão Social: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ: 57.498.660/0001-61

Atividades (CNAE): **4664-8/00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, **4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Município: Londrina **Endereço:** AVENIDA Henrique Mansano, 1581, , Santa Mônica

CEP: 86079450

Área do Estabelecimento: 390.00

Local e data: Londrina, segunda, 30 de setembro de 2024

Validade: terça, 29 de setembro de 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Observação

Alvará Provisório (médio risco) - válido por 24 (vinte e quatro) meses, até o dia 29/09/2026 para apresentar os documentos exigidos pelas atividades desenvolvidas pela empresa (verificar consulta prévia atualizada) conforme decreto vigente. A área utilizada excedente à do lote será aceita nos casos em que houver mais de 1 (um) pavimento ou quando informada na Consulta Prévia a utilização de lote(s) contíguo(s), ficando sujeito a anulação do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento para os casos diversos destes mencionados.

Código de Autenticidade: **X3CWOFLP**

"DISPENSADO CARIMBO E ASSINATURA, CONFORME ART. 33 DO DECRETO 1062/2024."

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



ESTADO DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

3BBM 1CIA LONDRINA



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB

3.9.01.25.0001724629-33

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Nome Fantasia: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 57.498.660/0001-61

Código da Atividade Econômica (CNAE):

4645/1-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

4664/8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR

Logradouro: AVENIDA HENRIQUE MANSANO Número: 1581

Bairro: SANTA MONICA Município: LONDRINA-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 390,00 m²

Área Vistoriada: 390,00 m²

Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M²)

Capacidade de Público: 20 PESSOAS

Uso de GLP:

Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.

Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 7 de Outubro de 2026



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deverá ser confirmada [clikando aqui](#) ou no endereço: www.bombeiros.pr.gov.br



0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica de Energia Eletrica
COPEL DISTRIBUICAO S A
RUA R JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
CEP 81200240 - CURITIBA/PR
CNPJ 04368898000106 - I.E 3023307393

Responsavel pela Iluminacao Publica: Municipio 166

Classificacao:
RESIDE/RESIDENCIAL

Tipo de Fornecimento:
TRIFASICO / 50A

JOSE MARCIO CARREGA

R TUPI, 329 - AP 1603 AND16

CEP: 86020350
Cidade: LONDRINA - PR
CPF: ***.***.98-32

UNIDADE CONSUMIDORA

94760950

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



PAGUE COM PIX

AS [1.6.39.22] RW420

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

05/2026

09/06/2026

R\$ 331,13



NOTA FISCAL No 233012288 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 18/06/2026

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de acesso:
41260604368898000106660032330122882098256470
Protocolo de Autorizacao: - as -03:00
EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

PAGO

DATAS
DE LEITURAS

Leitura Anterior
17/04/2026

Leitura Atual
18/05/2026

N. Dias
31

Proxima Leitura
17/06/2026

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / CCFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	331	0,369516	122,31	7,80	23,24	0,275750
(02) USO SISTEMA	kWh	331	0,491329	162,63	10,37	30,90	0,366670
(03) B.AMARELA	kWh			4,85	0,31	0,92	
(04) CONT ILUMIN				41,34			
TOTAL				331,13			

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **57.498.660/0001-61**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/09/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

A **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **57.498.660/0001-61**, com sede na Avenida Henrique Mansano, nº 1581, Jardim Alpes, CEP 86079-450, Londrina/PR, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **Cesar Rafael Carrega**, portador do RG nº 9.177.472-0 SESP/PR e CPF nº 055.015.959-23, DECLARA, para os devidos fins e especialmente para participação em processos licitatórios, pregões eletrônicos e demais certames públicos, que a empresa abaixo identificada é sua **ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA**, estando devidamente habilitada a prestar serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, assistência pós-venda e demais serviços correlatos relacionados aos produtos comercializados por esta empresa:

Razão Social: MEDICAL CENTER LTDA

CNPJ: 06.233.460/0001-46

CREA: 000082775

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 2869, Centro, CEP 76963-851, Cacoal/RO

Telefone: (69) 3441-4721

E-mail: medical@medicalcenter.net.br

Responsável Técnico: Rodrigo Botelho de Lima

CREA do Responsável Técnico: 00078857

A presente declaração é emitida para comprovar a existência de assistência técnica autorizada e qualificada para atendimento na região de atuação da empresa acima indicada, garantindo suporte técnico adequado aos equipamentos fornecidos pela STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

Londrina, 24 de junho de 2026.

57.498.660/0001-61
91099706-86
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1581
B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450
LONDRINA - PR

CESAR
RAFAEL
CARREGA:055
01595923

Assinado de
forma digital por
CESAR RAFAEL
CARREGA:055015
95923



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - CREA-RO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - Crea-RO, certifica que o profissional abaixo identificado encontra-se regularmente registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, encontrando habilitado a exercer suas atividades profissionais.

1. PROFISSIONAL

Nome: RODRIGO BOTELHO DE LIMA

CPF: 007.136.046-89

CERTIDÃO Nº: NET-00078857

Carteira: 103567D MG

Validade: 31/03/2027

Endereço: AV CARLOS GOMES -

Bairro: PRINCESA ISABEL

Cidade: CACOAL

Estado: RO

2. CURSOS ANOTADOS

Curso: ENGENHARIA CLÍNICA

Título: PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA

Data: 08/05/2024

Instituição: CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE CURITIBA

Atribuição:

Curso: GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Título: PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Data: 06/11/2010

Instituição: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

Atribuição:

Curso: MESTRADO EM ENGENHARIA DE SISTEMAS E AUTOMAÇÃO

Título: MESTRADO EM ENGENHARIA DE SISTEMAS E AUTOMAÇÃO

Data: 20/09/2018

Instituição: ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (MG)

Atribuição:

2.1 TÍTULO E ATRIBUIÇÃO

Código Título: 1211101

Título Profissional: ENGENHEIRO INDUSTRIAL - ELETRICA

Atribuição do profissional: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

Restrição da Atribuição: NÃO CONSTA

3. CERTIDÃO

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-RO (<http://www.crearo.org.br>) ou QR code.



WWW.CREARO.ORG.BR

Emitida em 29/04/2026

RUA ELIAS GORAYEB, 2596 - LIBERDADE - CEP: 76.803-903 - PORTO VELHO - RO

(069) 99399-3871 - atendimento@crearo.org.br

Autenticidade: 35B74-67C59-94D9E-7C336-87EF9



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - CREA-RO
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - Crea-RO, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado de Rondônia, circunscrita às atribuições dos(as) responsáveis técnicos(as).

1. EMPRESA:

Razão social: MEDICAL CENTER METROLOGIA LTDA

Número de Registro: 3231EMRO

Data do Registro: 07/08/2007

CNPJ: 06.233.460/0001-46

CERTIDÃO Nº: 000082775**Validade Certidão: 31/03/2027****Endereço do contrato:**

Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2869

Cidade: CACOAL

Bairro: CENTRO

Estado: RO

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**Registro: 103567D MG**

Nome: RODRIGO BOTELHO DE LIMA

Título Profissional: ENGENHEIRO INDUSTRIAL - ELETRICA

Atribuição do profissional: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

Registro: 24595D RO

Nome: RODRIGO DIETRICH CAVALCANTE

Título Profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição do profissional: atribuições PROVISÓRIAS definidas ATÉ QUE O CADASTRO DO CURSO SEJA CONCLUÍDO, por: Artigo 7º da Lei nº 5.194/66, concernente ao campo de atuação da engenharia mecânica; Artigo 12 da Resolução do Confea nº 218/73.

3. CONTRATO SOCIAL

Última Atualização Cadastral: 16/06/2026

Última Alteração do Contrato: 30/09/2019

Capital social atual: 600.000,00

Número da alteração contratual: 4ª ALTERAÇÃO CONSOLIDADA

Objetivo Social:

33.12-1/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE;

71.20-1/00-TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS;

33.12-1/03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERTAPÉUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO;

33.14-7/10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PARA USO GERAL (BALANÇAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS);

33.14-7/04 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES;

33.14-7/07 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL;

33.21-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS;

95.11-8/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;

81.21-4/00-LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS;

46.14-1/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES;

46.19-2/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO;

46.18-4/02 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE

INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES; 77.19-5/99 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO;

77.39-0/99 ALUGUEL DE REGULADORES, MÁQUINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO E AR

WWW.CREARO.ORG.BR

Emitida em 16/06/2026

Rua: Abunã, nº 2280 - São João Bosco, RO 76803-763

(069) 99399-3871 - atendimento@crearo.org.br

Autenticidade: ABE90-108C5-1857A-4852F-42D22



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - CREA-RO
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

MEDICINAL, COMPRESSORES DE AR, SECADORES, FILTROS E PEÇAS PARA USO EM SISTEMAS DE GERAÇÃO DE GASES DO AR E CILINDROS;
77.33-1/00-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS;
77.39-0/02 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR;
43.22-3/01-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
43.22-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
82.92-0/00 - ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO;
47.53-9/00-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
47.51-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
47.89-0/05 COMÉRCIO DOMISSANITÁRIOS; VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
47.72-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;
96.01-7/03-TOALHEIROS;
46.45-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA
USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS;
46.64-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS;
46.45-1/03-COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS;
46.69-9/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES
E PEÇAS;
46.84-2/99-COMÉRCIO ATACADISTA DE GASES DO AR PARA USO MEDICINAL E INDUSTRIAL;
46.69-9/99-COMÉRCIO ATACADISTA DE COPIADORAS;
46.46-0/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA;
46.46-0/02-COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; 82.11-3/00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;
95.21-5/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; EQUIPAMENTOS
85.99-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Restrição de atividade: Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos (as).

4. CERTIDÃO

Certificamos, mas, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos(as) responsáveis técnicos(as) acima citados(as), dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-RO (<http://www.crearo.org.br>) ou QR code.

PORTO VELHO-RO, 16 de Junho de 2026.



DECLARAÇÃO CONTÁBIL BALANÇO

A empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61**, com sede na AV HENRIQUE MANSANO, 1581 JD ALPES, CEP 86.079-450 LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. CESAR RAFAEL CARREGA, RG n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF n.º 055.015.959-23, por intermédio de seu profissional habilitado da área contábil, DECLARA, para fins de habilitação em processo licitatório, que os índices econômico-financeiros da empresa, extraídos do Balanço Patrimonial do último exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2025**, são os seguintes:

1. Liquidez Geral (LG)

Fórmula:

$LG = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) \div (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

$LG = (R\$ 163.450,00 + R\$ 0,00) \div (R\$ 500,00 + R\$ 0,00)$

LG = 326,90

2. Solvência Geral (SG)

Fórmula:

$SG = \text{Ativo Total} \div (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

$SG = R\$ 163.450,00 \div (R\$ 500,00 + R\$ 0,00)$

SG = 326,90

3. Liquidez Corrente (LC)

Fórmula:

$LC = \text{Ativo Circulante} \div \text{Passivo Circulante}$

$LC = R\$ 163.450,00 \div R\$ 500,00$

LC = 326,90

Desta forma, certifico que a empresa apresenta os seguintes índices:

Índice	Resultado	Exigência do Edital
Liquidez Geral (LG)	326,90	> 1,00
Solvência Geral (SG)	326,90	> 1,00
Liquidez Corrente (LC)	326,90	> 1,00

Assim, a empresa atende plenamente aos requisitos de qualificação econômico-financeira exigidos no edital.



REGINALDO
ANTONIO

FIORI:64071367920

Assinado de forma digital
por REGINALDO ANTONIO
FIORI:64071367920
Dados: 2026.07.02
09:03:12 -03'00'

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador – CRC/PR nº 036115/O-2

CESAR RAFAEL
CARREGA:055
01595923

Assinado de forma
digital por CESAR
RAFAEL
CARREGA:0550159592
3

CESAR RAFAEL CARREGA
Sócio-Proprietário

57.498.660/0001-61
91099706-86
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1581
B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450
LONDRINA - PR



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/07/2026 07:56:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **57.498.660/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 03/07/2026 07:57:49

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 57.498.660/0001-61

Cadastro: CEAF CEIS CEPIM CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 57.498.660/0001-61

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA INICIAL DE VIGÊNCIA	DATA FINAL DE VIGÊNCIA	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 03/07/2026 07:57:49

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEAF CEIS CEPIM CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 05501595923

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA INICIAL DE VIGÊNCIA	DATA FINAL DE VIGÊNCIA	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado											



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 03/07/2026, que **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ: **57.498.660/0001-61**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **02/08/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código LXCQ20260703080136

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 03/07/2026, que **CESAR RAFAEL CARREGA**, CPF: **055.015.959-23**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **02/08/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código BZPM20260703080156

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 03/07/2026, que **CESAR RAFAEL CARREGA**, CPF: **055.015.959-23**, NÃO CONSTA no **cadastro de pessoas inabilitadas** para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **02/08/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código TUHZ20260703080224

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

O Tribunal de Contas da União certifica, em 03/07/2026, que **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ: **57.498.660/0001-61**, NÃO CONSTA no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg)**.



Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.



O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal

Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos



Certidão válida até **02/08/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código LQIK20260703080350

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

O Tribunal de Contas da União certifica, em 03/07/2026, que **CESAR RAFAEL CARREGA**, CPF: **055.015.959-23**, NÃO CONSTA no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg)**.



Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.



O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal

Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos



Certidão válida até **02/08/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código BQYU20260703080410

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ: **57.498.660/0001-61**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.498.660/0001-61, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 08h14min14 do dia 03/07/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **T142.UWQT.3LCU.PAAW**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **CESAR RAFAEL CARREGA**

CPF: **055.015.959-23**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **CESAR RAFAEL CARREGA**, CPF 055.015.959-23, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 08h12min43 do dia 03/07/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **XGYZ.TCDW.3NSX.6VLD**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 57498660000161)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/07/2026 08:15 (#Válida por 30 dias#)

Data da última atualização do banco de dados: 03/07/2026 08:15

Selo digital de segurança: 8F8D7CA2DA9B8B9988D0053D92EB5432



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra CESAR RAFAEL CARREGA (CPF nº 05501595923)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/07/2026 08:15 (#Válida por 30 dias#)

Data da última atualização do banco de dados: 03/07/2026 08:15

Selo digital de segurança: B5729E3D98C09027396CC426844E5D52



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 57.498.660/0001-61

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/07/2026, às 08:16:07, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: RPYQPUTDBS

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 055.015.959-23

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/07/2026, às 08:16:30, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: QCVJZJ3BTJ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

Código de verificação: 77.467.551.727**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 57.498.660**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar nominada (Caulnom), caução (Caução), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de incompetência (Exclnc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), incidente de falsidade (IncFal), interdito proibitório (Interdito), justificação (Justif), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), procedimento conciliatório (PCon), produção antecipada da prova (PAP), recurso de julgamento parcial (RJParc), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), restauração de autos (ResAutCrim), seqüestro (Seques), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), carta precatória cível (CartPrecCiv), cautelar nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), correção parcial ou reclamação correicional (CorPar), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de impedimento (Exclmpedi), exceção de suspeição (ExcSusp), exceção de suspeição (ExcSuspei), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de assunção de competência (IAC), incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), mandado de segurança cível (MSCiv), outros procedimentos (OutPro), pedido de mediação pré-processual (PMPP), pedido de providências (PP), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), petição cível (PetCiv), processo administrativo (PA), processo administrativo disciplinar em face de magistrado (PADMag), processo cautelar (ProcCau), processo de conhecimento (ProcCon), processo de execução (ProcExe), protesto (Protes), reclamação (Rcl), reclamação disciplinar (RD), recurso administrativo (RecAdm), recursos (Rec), recursos (Rec), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar e de sentença (SLS),

suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)

5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.

6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt9.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 03/07/2026 às 08:18

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

Código de verificação: 77.467.628.456**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 055.015.959-23**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar nominada (CauInom), caução (Caução), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de incompetência (Exclnc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), incidente de falsidade (IncFal), interdito proibitório (Interdito), justificação (Justif), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), procedimento conciliatório (PCon), produção antecipada da prova (PAP), recurso de julgamento parcial (RJParc), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), restauração de autos (ResAutCrim), seqüestro (Seques), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), carta precatória cível (CartPrecCiv), cautelar nominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), correção parcial ou reclamação correicional (CorPar), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de impedimento (Exclmpedi), exceção de suspeição (ExcSusp), exceção de suspeição (ExcSuspei), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de assunção de competência (IAC), incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), mandado de segurança cível (MSCiv), outros procedimentos (OutPro), pedido de mediação pré-processual (PMPP), pedido de providências (PP), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), petição cível (PetCiv), processo administrativo (PA), processo administrativo disciplinar em face de magistrado (PADMag), processo cautelar (ProcCau), processo de conhecimento (ProcCon), processo de execução (ProcExe), protesto (Protes), reclamação (Rcl), reclamação disciplinar (RD), recurso administrativo (RecAdm), recursos (Rec), recursos (Rec), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar e de sentença (SLS),

suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)

5. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.

6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt9.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 03/07/2026 às 08:19



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CNPJ: 57498660000161

Requerente: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná **CERTIFICA**, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;**
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.**

Certidão emitida em 03/07/2026 13:09:25, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 139245587

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CPF: 055.015.959-23

Requerente: CESAR RAFAEL CARREGA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná **CERTIFICA**, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;**
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.**

Certidão emitida em 03/07/2026 08:21:17, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 785197720

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/07/2026 às 08:24) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 055.015.959-23.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A47.9BEF.4530.B871 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/07/2026 às 08:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 57.498.660/0001-61.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A47.9C2A.790D.F930 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 57.498.660/0001-61

CERTIDÃO EMITIDA em 03/07/2026, às 08:27:15

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 29/06/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **UWIIqccx3QyymFr**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 29/06/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 29/06/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas,

falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 03/07/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 57.498.660/0001-61

CERTIDÃO EMITIDA em 03/07/2026, às 08:29:51

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 29/06/2026, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **YHc0zaHwALxBLGv**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 29/06/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 29/06/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 03/07/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **57.498.660/0001-61**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:30:28 do dia 03/07/2026 , com validade até o dia 02/08/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: NarKgLFmXO9IFTYvLHXC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CESAR RAFAEL CARREGA**

CPF/CNPJ: **055.015.959-23**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:30:52 do dia 03/07/2026 , com validade até o dia 02/08/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 9YoYxQaZPSUIFzsEno2F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39876977-35

Certidão fornecida para o CPF/MF: **055.015.959-23**

Nome: **CESAR RAFAEL CARREGA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/11/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

**Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento**

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 7783419 / 2026

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

CESAR RAFAEL CARREGA
CPF/CNPJ: 055.015.959-23

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 13 de julho de 2026

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
9RB#cz3eG0YZ

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CESAR RAFAEL CARREGA
CPF: 055.015.959-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:39:16 do dia 17/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2026.

Código de controle da certidão: **40A3.9088.6464.7124**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CESAR RAFAEL CARREGA Portador do CPF 055.015.959-23 Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Protocolo: PRC2602970655
Nome Empresarial: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 41208967625			CNPJ 32.593.430/0001-50
Endereço Completo AVENIDA Henrique Mansano, Nº 1595, xxxxx, Alpes - Londrina/PR - CEP 86075-000			
Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Situação ATIVA
Data de Entrada na Sociedade 13/12/2018	Data de Saída na Sociedade 10/09/2024	Condição Sócio	Status SEM STATUS
Data de Entrada na Sociedade 13/12/2018	Data de Saída na Sociedade 10/09/2024	Condição Administrador	
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20261358243	12/03/2026	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20261358243	12/03/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
092	20256398291	20/01/2026	DECISÃO DO(S) SÓCIO(S)
002	20254932835	02/10/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20254932835	02/10/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20252030060	26/04/2025	BALANCO
002	20246745665	11/09/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20246745665	11/09/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20243179839	06/05/2024	BALANCO
307	20231773102	14/03/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20195722698	15/10/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20195722698	15/10/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
090	20187461848	29/01/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	41208967625	29/01/2019	CONTRATO
Nome Empresarial: LIFENOX SOLUCOES EM METAIS LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 41211841335			CNPJ 51.574.726/0001-79
Endereço Completo AVENIDA Henrique Mansano, Nº 1550, xxxxx, Santa Mônica - Londrina/PR - CEP 86079-450			

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CESAR RAFAEL CARREGA Portador do CPF 055.015.959-23 Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Protocolo: PRC2602970655	
Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Data de Entrada na Sociedade 26/07/2023	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição Sócio		
Data de Entrada na Sociedade 26/07/2023	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição Administrador		
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	
316	20234815744	26/07/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
090	41211841335	26/07/2023	CONTRATO	
Nome Empresarial: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 41212886685			CNPJ 57.498.660/0001-61	
Endereço Completo AVENIDA Henrique Mansano, Nº 1581, xxxxx, Santa Mônica - Londrina/PR - CEP 86079-450				
Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Data de Entrada na Sociedade 06/03/2026	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição Sócio		
Data de Entrada na Sociedade 30/09/2024	Data de Saída na Sociedade 02/10/2025	Condição Sócio		
Data de Entrada na Sociedade 06/03/2026	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição Administrador		
Data de Entrada na Sociedade 30/09/2024	Data de Saída na Sociedade 02/10/2025	Condição Administrador		
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	
002	20261356062	14/03/2026	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	
002	20261356062	14/03/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20254931219	02/10/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	
002	20254931219	02/10/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
316	20246746203	30/09/2024	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
090	41212886685	30/09/2024	CONTRATO	



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CESAR RAFAEL CARREGA

Portador do CPF 055.015.959-23

Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :

Protocolo: PRC2602970655

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2026, às 17:16:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **V3V3NFAP**.



PRC2602970655
SEBASTIÃO MOTA
Secretário Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CESAR RAFAEL CARREGA

CPF: 055.015.959-23

Certidão nº: 16815947/2026

Expedição: 17/03/2026, às 14:40:46

Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CESAR RAFAEL CARREGA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **055.015.959-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Edenilson Donisete Macri

Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Victor Tristão Pascual

CERTIDÃO

"PARA FINS GERAIS"

Busca não contempla Execuções de Pena do Sistema SEEU

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos de distribuição CÍVEL (inclusive Interdição, Tutela, Curatela, Protesto contra Alienação de Bens, Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial ou Insolvência), FAZENDA PÚBLICA, EXECUÇÃO FISCAL (Estadual e Municipal), CRIMINAL, JUIZADO ESPECIAL (Cível, Fazenda Pública e Criminal), FAMÍLIA e SUCESSÕES do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído nesta Comarca feito algum contra:

Nome **CESAR RAFAEL CARREGA**
CPF/CNPJ **055.015.959-23**

CUSTAS: R\$ 48,00

Lei Estadual nº 22.956/2025 - Tabela VIII



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=A642D767ED40922D5F9488945406B4CD>

Busca referente aos últimos 20 anos.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 19 de Junho de 2026.

Assinado eletronicamente por

IWERLEI BUENO MORAES

CPF : 727.061.809-78

Dados: 2026-06-22 16:57:05

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes

Empregado Juramentado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
1º Tabelionato de Protesto de Títulos
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO
CPF: 000.105.901-70
Tabelião

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE PROTESTO**

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros de registro de protestos, neles verifiquei NADA constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa física

Nome: CESAR RAFAEL CARREGA

CPF: 055.015.959-23

Londrina-PR, 14 de julho de 2026.
Em testemunho da verdade.

SANDRA CRISTINA ROCKENBACH RODRIGUES SILVA
Escrevente Substituta

Emolumentos

Certidão R\$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS (25%) R\$ 4,85, ISS R\$ 0,39, FUNDEP R\$ 0,97, Selo de Fiscalização Pago R\$ 1,00. Total R\$ 26,60.

Selo digital nº: SFTP1aqvjoCH95CNKAAA1365p
Digitado por: PATRICIA BRUGNARO OLIVEIRA

FUNARPEN - TJPR

Selo Digital de Fiscalização

**SFTP1aqvjoCH95C
NKaAA1365p**

Consulte os dados do ato em:
consulta.funarpen.com.br/selo



Se impresso, para a conferência, acesse o site <https://www.cenprotnacional.org.br> e digite o código: 41137004232599701260713.

Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
BEATRIZ XAVIER ROCHA
CPF: 610.892.149-87
Tabeliã

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE PROTESTO**

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros de registro de protestos, neles verifiquei NADA constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa física

Nome: CESAR RAFAEL CARREGA

CPF: 055.015.959-23

Londrina-PR, 13 de julho de 2026.
Em testemunho da verdade.

BEATRIZ

XAVIER

ROCHA:61

089214987

Assinado de forma
digital por BEATRIZ
XAVIER

ROCHA:610892149
87

Dados: 2026.07.13
16:15:54 -03'00'

BEATRIZ XAVIER ROCHA
Tabeliã

Emolumentos

Certidão R\$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS(25%) R\$ 4,85, ISS R\$ 0,39, FUNDEP R\$ 0,97, Selo de Fiscalização Pago R\$ 1,00. Total R\$ 26,60.

Selo digital n°: SFTP1fqsmoCO9ck5ADAnF693p

Digitado por: DANILO RAIA

FUNARPEN - TJPR

Selo Digital de Fiscalização

**SFTP1fqsmoCO9ck
5ADAnF693p**



Consulte os dados do ato em:
consulta.funarpen.com.br/selo

Se impresso, para a conferência, acesse o site <https://www.cenprotnacional.org.br> e digite o código: 41137004232600802260713.

Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
JOÃO NORBERTO FRANÇA GOMES
CPF: 519.921.249-49
Tabelião

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE PROTESTO**

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros de registro de protestos, neles verifiquei NADA constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa física

Nome: CESAR RAFAEL CARREGA

CPF: 055.015.959-23

Londrina-PR, 13 de julho de 2026.

Em testemunho da verdade.

**DIOGO DA
CUNHA**

**SANTOS:032
83705925**

Assinado de forma
digital por DIOGO DA
CUNHA
SANTOS:03283705925
Dados: 2026.07.13
16:43:35 -03'00'

DIOGO DA CUNHA SANTOS
Escrevente Substituto

Emolumentos

Certidão R\$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS (25%) R\$ 4,85, ISS R\$ 0,39, FUNDEP R\$ 0,97, Selo de Fiscalização Pago R\$ 1,00. Total R\$ 26,60.

Selo digital nº: SFTP1tqZmoRO9cvdApAnF698p

Digitado por: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA

FUNARPEN - TJPR

Selo Digital de Fiscalização

**SFTP1tqZmoRO9cv
dApAnF698p**

Consulte os dados do ato em:
consulta.funarpen.com.br/selo



Se impresso, para a conferência, acesse o site <https://www.cenprotnacional.org.br> e digite o código: 41137004232602503260713.

Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.



Prefeitura do Município de Londrina

Estado do Paraná

Edital de Publicações Eletrônicas em
10/04/2025

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA SANITÁRIA

CNPJ/CPF: 57.498.660/0001-61	Processo nº: 60.033052/2024-33
Razão Social: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Endereço: AV HENRIQUE MANSANO, nº 1581 LONDRINA /PR	
Código CNAE/CBO: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	
Licenciado até 10/04/2027	
OBSERVAÇÃO: Licenciada para atividade de comércio atacadista de produtos para saúde. AFE 8.31409-9	
Esta licença sanitária deverá ficar exposta no estabelecimento. O representante legal deve solicitar renovação 60 dias antes do vencimento. Em caso de mudança de endereço, alteração de ramo de atividade e de razão social, deverá ser solicitada tais alterações via sistema SEI/PML.	
Londrina, datado e assinado eletronicamente.	



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Aparecida Segre, Promotor(a) de Saúde Pública - Serviço de Enfermagem em Vigilância Sanitária**, em 10/04/2025, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **15366670** e
o código CRC **9AB5353F**.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social	CNPJ
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.498.660/0001-61
Nome Fantasia	
Endereço na Internet	SAC
Endereço Completo	Cidade/UF
AVENIDA HENRIQUE MANSANO, n.º 1581 - SANTA MÔNICA CEP: 86.079-450	LONDRINA/PR
Responsável Técnico	Responsável Legal
MIRIAM PIZZI GOMES	CESAR RAFAEL CARREGA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização	Data da Autorização	Situação
8.31409-9 (W44343371X15)	01/04/2025	Ativa
Nº do Processo	Autorização	
<u>25351.042071/2025-97</u>	Produtos para Saúde (Correlatos)	

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 01/04/2025 | Edição: 62 | Seção: 1 | Página: 108

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.248, DE 31 DE MARÇO DE 2025

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

NEIVA ROBERTA RIBEIRO DA SILVA LTDA / 59.008.005/0001-03

25351.046469/2025-01 / 5173089

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0426001257

DROGA LOPES LTDA / 58.542.802/0001-03

25351.045539/2025-03 / 5173261

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0417497253

TRANSPORTES GRAL LTDA / 83.303.404/0001-81

25351.042947/2025-03 / 2106817

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0393839257

TRANSPORTADORA RODO IMPORT LTDA / 02.200.717/0001-02



DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0425124258

M.H.L DROGARIA S.A / 09.396.401/0053-08

25351.046414/2025-92 / 5173027

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0425528251

M & A MEDICAMENTOS LTDA / 23.357.572/0004-70

25351.046502/2025-94 / 5173149

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)



DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0426308255

STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 57.498.660/0001-61

25351.042071/2025-97 / 8314099

ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0384854257

VM DISTRIBUIDORA LTDA / 57.737.790/0001-00

25351.042882/2025-98 / 1356755

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0393134253



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO

RUA PADRE GERMANO MAYER 2272 - CEP 80.040-170 - Curitiba / PR - Fone 0800-645-2009

CERTIDÃO DE CADASTRO DE ATIVIDADES DISTINTAS (CADI) No: 6c30bd82-ceaa-4b31-972a-162182ec29e2

Jurisdição: PR

Razão social: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

CNPJ / CPF: 57.498.660/0001-61

Registro no CREFITO:
CA002536

Endereço: AV HENRIQUE MANSANO

Bairro: Santa Mônica

CEP: 86079-450

Cidade: Londrina

UF: PR

Horário de funcionamento: SEGaSEX/08:00-17:00

*** CORPO CLÍNICO ***

Responsável técnico: MIRIAM PIZZI GOMES

236323-F

OBSERVAÇÕES

- 1 - A presente certidão possui validade até a mudança do responsável técnico, no máximo até **01/07/2029**.
- 2 - A declaração restringe-se à regularidade da responsabilidade técnica do profissional nos termos da Legislação pertinente.
- 3 - A regularidade de registro da empresa e do profissional devem ser objeto de requisição ao CREFITO, conforme legislação vigente.
- 4 - Documento para uso exclusivo da fiscalização do CREFITO.
- 5 - O presente documento atesta que a pessoa jurídica não possui por atividade básica a Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional, porém realizando atividades concernentes a tais áreas profissionais.

IMPORTANTE

Apresentação Obrigatória a Fiscalização.
Esta Declaração deverá ser fixada no Setor de Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional em local Visível.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://crefito-pr.implanta.net.br/servicosonline/Publico/ValidarDocumentos/>, informando o número de controle: **6c30bd82-ceaa-4b31-972a-162182ec29e2**



CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E DE TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO

FISIOTERAPEUTA

INSCRIÇÃO CREFITO - 236323-F

NOME DRA. MIRIAM PIZZI GOMES

FILIAÇÃO DIRCEU GOMES

MARIA DE LOURDES PIZZI

CAMPO MOURÃO/PR

LOCAL DO NASCIMENTO (CIDADE - ESTADO OU PAÍS)

CURITIBA-PR

LOCAL DA EMISSÃO

LEI Nº 6.206 - 07.05.75

LEI Nº 6.316 - 17.12.75

21/07/1985

DATA DO NASCIMENTO

03/04/2017

DATA DE EMISSÃO

Dr. Abdo Augusto Zetehbi
PRESIDENTE

IDENTIDADE CIVIL

9.222.285-3

NÚMERO
IDENTIDADE ELEITORAL

30/01/2001

DATA DE EMISSÃO

SSP/PR

ÓRGÃO EMITENTE
IDENTIDADE DO CONTRIBUINTE

087296910680

NÚMERO
OUTRA QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
(Nas áreas de Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional)

181º/PR

CIRCUNSCRIÇÃO/ZONA

04414979935

INSCRIÇÃO NO CIC DO MF

CONTROLE

Miriam Pizzi Gomes

ASSINATURA DO PORTADOR



POLEGAR DIREITO



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - Tel.: (83) 3244-6404 - Fax: (83) 3244-6404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 42871704191526100329-1; Data: 17/04/2019 15:29:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIL02578-N3DD;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 57.498.660/0001-61, COM SEDE EM LONDRINA, AVENIDA HENRIQUE MANSANO Nº 1581, SANTA MONICA, NO ESTADO DO PARANÁ, NESTE ATÓ REPRESENTADO PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL CESAR RAFAEL CARREGA, BRASILEIRO SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RG Nº 9.177.472-0 CPF:055.015.959-23 RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA TUPI Nº 329 APT.804 CENTRO LONDRINA NO ESTADO DO PARANÁ.

CONTRATADO: MIRIAM PIZZI GOMES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, FISIOTERAPEUTA, RG Nº 9.222.285-3, CPF:044.149.799-35 E CREFITO Nº 236323-F, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA LINS Nº 215, JARDIM SÃO PAULO, CEP: 86.191.610 CAMBÉ NO ESTADO DO PARANÁ.

As partes acima identificadas têm, entre si, junto e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços que se regerão pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª: O presente contrato tem como **OBJETO**, à prestação, pelo **CONTRATADO**, dos serviços de assistência técnica, pertencentes à **CONTRATANTE**.

DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª: O serviço de Assistência Técnica se dará de segunda-feira á sexta-feira 08:00 as 17:00.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 3ª: Pela realização dos serviços contratados, a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** um salário mínimo, na quantia de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) por mês sempre no quinto dia útil.

DA RECISÃO

Cláusula 4ª: O presente Instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo, devendo, porém, a outra parte ser avisada com 60 (trinta) dias de antecedência sem multas para ambas as partes.

DO PRAZO

Cláusula 5ª: O contrato será de prazo indeterminado, passando a ter vigência a partir da assinatura pelas partes.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª: O presente contrato não implicará em vínculo trabalhista ficando dispensado o registro em carteira de trabalho.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 1 testemunha.

Londrina, 30 de abril de 2025.

Cesar Rafael Carrega

Responsável legal

RG:9.177.472-0 CPF: 055.015.959-23



Miriam Pizzi Gomes

Fisioterapeuta Responsável

CREFITO: 236323-F

RG: 9.222.285-3 / CPF: 044.149.799-35



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Protocolo: PRC2602969680
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 41212886685	CNPJ: 57498660000161	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento Número: Data: 14/03/2026
Arquivamentos solicitado:		
Número:	Data:	Ato:
20261356062	14/03/2026	ALTERAÇÃO
20254931219	02/10/2025	ALTERAÇÃO
41212886685	30/09/2024	CONTRATO
20246746203	30/09/2024	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 22/06/2026, às 08:18:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **5PEFX3DL**.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

1

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/07/1992, portador da cédula de Identidade Civil RG sob n.º 12.640.687-8 SESP/PR e CPF sob n.º 084.265.219-16, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tereza Zanette Lopes, n.º 277 – Apartamento 1502 – Gleba Fazenda Palhano – CEP: 86.050-523. Único sócio da Empresa Limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situado na Praça de Londrina – Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41212886685 em data de 30/09/2024, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 57.498.660/0001-61, resolvem modificar o primitivo contrato pelo presente instrumento de alteração e consolidação contratual:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O sócio **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA** que possui 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) vende e transfere de maneira onerosa a totalidade de suas quotas a **CESAR RAFAEL CARREGA**, brasileiro, solteiro, nascido em 31/05/1985, empresário, portador do RG sob n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF sob n.º 055.015.959-23, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tupi, n.º 329 – Apartamento 804 – Centro – CEP: 86.020-350, o qual ingressa na sociedade através do presente ato.

CLÁUSULA SEGUNDA

O sócio **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA** dá ao adquirente **CESAR RAFAEL CARREGA** plena, geral, rasa e irrevogável quitação da cessão de cotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em decorrência da presente alteração, o capital social que era de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizados, permanece inalterado ficando assim distribuídos:

SOCIO	QUOTAS	R\$
CESAR RAFAEL CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUARTA

A administração da sociedade caberá a **CESAR RAFAEL CARREGA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos

2

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei nº 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.

CLÁUSULA QUINTA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA

A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

CESAR RAFAEL CARREGA, brasileiro, solteiro, nascido em 31/05/1985, empresário, portador do RG sob nº 9177472-0 SESP/PR e CPF sob nº 055.015.959-23, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tupi, nº 329 – Apartamento 804 – Centro – CEP: 86.020-350. Único sócio da Empresa Limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situado na Praça de Londrina - Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, nº 1581 – Santa

3

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

Mônica – CEP 86.079-450, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41212886685 em data de 30/09/2024, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 57.498.660/0001-61.

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** e gira na cidade de Londrina – Estado do Paraná na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450.

Parágrafo único: Nos termos da Instrução Normativa DREI n.º 112, de 20 de Janeiro de 2022, a sociedade permanecerá UNIPESSOAL.

2ª O objeto social da empresa é Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE 4664-8/00) e Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01).

3ª O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R\$
CESAR RAFAEL CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

4ª A sociedade iniciou suas atividades em 30 de Setembro de 2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá **CESAR RAFAEL CARREGA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

4

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

Parágrafo Primeiro: Faculta-se aos administradores, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei nº. 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª O sócio declara sob as penas da Lei que se enquadra na situação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

5

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

15º Fica eleito o foro de Londrina – Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de alteração contratual em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina - Paraná, 06 de Março de 2.026.

CESAR RAFAEL CARREGA

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA
08426521916	GUSTAVO HENRIQUE CARREGA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2026 09:39 SOB N° 20261356062.
PROTOCOLO: 261356062 DE 09/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605173132. CNPJ DA SEDE: 57498660000161.
NIRE: 41212886685. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2026.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

CESAR RAFAEL CARREGA, brasileiro, solteiro, nascido em 31/05/1985, empresário, portador do RG sob n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF sob n.º 055.015.959-23, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tupi, n.º 329 – Apartamento 804 – Centro – CEP: 86.020-350. Único sócio da Empresa Limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situado na Praça de Londrina – Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41212886685 em data de 30/09/2024, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 57.498.660/0001-61, resolvem modificar o primitivo contrato pelo presente instrumento de alteração e consolidação contratual:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O sócio **CESAR RAFAEL CARREGA** que possui 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) vende e transfere de maneira onerosa a totalidade de suas quotas a **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/07/1992, portador da cédula de Identidade Civil RG sob n.º 12.640.687-8 SESP/PR e CPF sob n.º 084.265.219-16, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tereza Zanette Lopes, n.º 277 – Apartamento 1502 – Gleba Fazenda Palhano – CEP: 86.050-523, o qual ingressa na sociedade através do presente ato.

CLÁUSULA SEGUNDA

O sócio **CESAR RAFAEL CARREGA** dá ao adquirente **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA** plena, geral, rasa e irrevogável quitação da cessão de cotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em decorrência da presente alteração, o capital social que era de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizados, permanece inalterado ficando assim distribuídos:

SOCIO	QUOTAS	R\$
GUSTAVO HENRIQUE CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUARTA

A administração da sociedade caberá a **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos

2

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei nº 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.

CLÁUSULA QUINTA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA

A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/07/1992, portador da cédula de Identidade Civil RG sob nº 12.640.687-8 SESP/PR e CPF sob nº 084.265.219-16, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tereza Zanette Lopes, nº 277 – Apartamento 1502 – Gleba Fazenda Palhano – CEP: 86.050-523. Único sócio da Empresa Limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situado na Praça de

3

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

Londrina - Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41212886685 em data de 30/09/2024, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 57.498.660/0001-61.

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** e gira na cidade de Londrina – Estado do Paraná na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450.

Parágrafo único: Nos termos da Instrução Normativa DREI n.º 112, de 20 de Janeiro de 2022, a sociedade permanecerá UNIPESSOAL.

2ª O objeto social da empresa é Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE 4664-8/00) e Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01).

3ª O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R\$
GUSTAVO HENRIQUE CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

4ª A sociedade iniciou suas atividades em 30 de Setembro de 2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

4

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

Parágrafo Primeiro: Faculta-se aos administradores, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei nº. 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª O sócio declara sob as penas da Lei que se enquadra na situação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

5

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61**

15º Fica eleito o foro de Londrina – Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de alteração contratual em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina - Paraná, 02 de Outubro de 2.025.

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA

CESAR RAFAEL CARREGA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA
08426521916	GUSTAVO HENRIQUE CARREGA



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2025 10:52 SOB N° 20254931219.
PROTOCOLO: 254931219 DE 02/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12515780015. CNPJ DA SEDE: 57498660000161.
NIRE: 41212886685. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/10/2025.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE**

CESAR RAFAEL CARREGA, brasileiro, solteiro, nascido em 31/05/1985, empresário, portador do RG sob n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF sob n.º 055.015.959-23, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tupi, n.º 329 – Apartamento 804 – Centro – CEP: 86.020-350. Constitui uma Empresa Limitada Unipessoal, regida em consonância com o que determina a Lei n.º 10.406/2002, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, na cidade de Londrina – Estado do Paraná.

Parágrafo único: Nos termos da Instrução Normativa DREI n.º 81/2020, a sociedade será UNIPESSOAL.

2ª O objeto social será Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE 4664-8/00) e Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01).

3ª O capital social será de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R\$
CESAR RAFAEL CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

4ª A sociedade iniciará suas atividades em 30 de Setembro de 2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Único: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alterações contratuais, poderão ser tomadas pelos sócios que representem a unanimidade do capital social.

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE**

7ª A administração da sociedade caberá aos sócios **CESAR RAFAEL CARREGA**, com poderes e atribuição de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bem imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: *Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.*

Parágrafo Segundo: *Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei n.º 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.*

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: *O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.*

13ª O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE**

14ª Fica eleito o foro de **Londrina – Paraná** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento particular de constituição de Sociedade Empresária Limitada, em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina – Paraná, 30 de Setembro de 2024.

CESAR RAFAEL CARREGA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2024 18:53 SOB N° 41212886685.
PROTOCOLO: 247289248 DE 30/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413966251. CNPJ DA SEDE: 57498660000161.
NIRE: 41212886685. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2024.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Sociedade **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, estabelecido(a) na AVENIDA Henrique Mansano, 1581, Santa Mônica, Londrina - PR, CEP: 86079-450, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Londrina - PR, 30/09/2024

CESAR RAFAEL CARREGA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2024 18:53 SOB N° 20246746203.
PROTOCOLO: 246746203 DE 30/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413966243. CNPJ DA SEDE: 57498660000161.
NIRE: 41212886685. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2024.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br



DADOS CADASTRAIS	
RAZAO SOCIAL	STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	57.498.660/0001-61
ENDEREÇO	Avenida Henrique Mansano, 1581 – Santa Monica – CEP 86.079-450
TELEFONE/FAX	(43) 3339-1320
E-MAIL	starmedical.licita@gmail.com
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE VAI ASSINAR O CONTRATO	CESAR RAFAEL CARREGA
Nº DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA	91774720 SESP PR
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL	055.015.959-23
TELEFONE WHATSAPP	(43) 98806-9641
ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL	Rua Tupi, 329 - Centro
BANCO E CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO	BANCO DO BRASIL AG: 1582-2 – C/C: 42.441-2

Londrina, 16 de março de 2026.

57.498.660/0001-61
91099706-86
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1581
B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450
LONDRINA - PR

CESAR RAFAEL
CARREGA:0550
1595923

Assinado de forma digital por CESAR RAFAEL
CARREGA:05501595923

STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE PRODUTOS H:57498660000161

Assinado de forma digital por STARMEDICAL
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
H:57498660000161



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
1º Tabelionato de Protesto de Títulos
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO
CPF: 000.105.901-70
Tabelião

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros de registro de protestos, neles verifiquei NADA constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa jurídica

Nome: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 57.498.660/0001-61

Londrina-PR, 10 de julho de 2026.
Em testemunho da verdade.

BRUNO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO
Tabelião

Emolumentos

Certidão R\$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS (25%) R\$ 4,85, ISS R\$ 0,39, FUNDEP R\$ 0,97, Selo de Fiscalização Pago R\$ 1,00. Total R\$ 26,60.

Selo digital nº: SFTP1aqjjoCH95CeKZAA1365p
Digitado por: PATRICIA BRUGNARO OLIVEIRA

FUNARPEN - TJPR

Selo Digital de Fiscalização

**SFTP1aqjjoCH95C
eKZAA1365p**

Consulte os dados do ato em:
consulta.funarpen.com.br/selo



Se impresso, para a conferência, acesse o site <https://www.cenprotnacional.org.br> e digite o código: 41137004225522101260710.

Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
BEATRIZ XAVIER ROCHA
CPF: 610.892.149-87
Tabeliã

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros de registro de protestos, neles verifiquei NADA constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa jurídica

Nome: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 57.498.660/0001-61

Londrina-PR, 10 de julho de 2026.

Em testemunho da verdade.

BEATRIZ

XAVIER

ROCHA:61

089214987

Assinado de forma

digital por

BEATRIZ XAVIER

ROCHA:61089214

987

Dados: 2026.07.10

11:40:23 -03'00'

BEATRIZ XAVIER ROCHA

Tabeliã

Emolumentos

Certidão R\$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS(25%) R\$ 4,85, ISS R\$ 0,39, FUNDEP R\$ 0,97, Selo de Fiscalização Pago R\$ 1,00. Total R\$ 26,60.

Selo digital n°: SFTP1tqmQo3G9NAcF2AhF693p

Digitado por: DANILO RAIÁ

FUNARPEN - TJPR

Selo Digital de Fiscalização

SFTP1tqmQo3G9NA
cF2AhF693p



Consulte os dados do ato em:

consulta.funarpen.com.br/selo

Se impresso, para a conferência, acesse o site <https://www.cenprotnacional.org.br> e digite o código: 41137004225523402260710.

Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
JOÃO NORBERTO FRANÇA GOMES
CPF: 519.921.249-49
Tabelião

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros de registro de protestos, neles verifiquei NADA constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa jurídica

Nome: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 57.498.660/0001-61

Londrina-PR, 10 de julho de 2026.

Em testemunho da verdade.

**DIOGO DA
CUNHA**

**SANTOS:032
83705925**

Assinado de forma
digital por DIOGO DA
CUNHA
SANTOS:03283705925
Dados: 2026.07.10
10:35:25 -03'00'

DIOGO DA CUNHA SANTOS
Escrevente Substituto

Emolumentos

Certidão R\$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS (25%) R\$ 4,85, ISS R\$ 0,39, FUNDEP R\$ 0,97, Selo de Fiscalização Pago R\$ 1,00. Total R\$ 26,60.

Selo digital nº: SFTP1tqKmoRO9cv8AwAnF698p
Digitado por: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA

FUNARPEN - TJPR

Selo Digital de Fiscalização

**SFTP1tqKmoRO9cv
8AwAnF698p**

Consulte os dados do ato em:
consulta.funarpen.com.br/selo



Se impresso, para a conferência, acesse o site <https://www.cenprotnacional.org.br> e digite o código: 41137004225524803260710.

Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

	EPB LONDRINA – COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CNPJ:22.540.455/0001-32 32Rua: Henrique Mansano nº 1030– JD Alpes Tel.: 43 3367-4555. / Cel.: 43 8442-4555Londrina -PR E-mail: manulonhospitalar@gmail.com
---	---

DECLARAÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa **EPB Londrina Comercio de Equipamento Médicos e Hospitalar – Eireli**, CNPJ nº **22.540.455/0001-32**, com sede na Rua. Henrique Mansano nº1030 Jd Alpes CEP: 86075-000, Londrina-PR, Declara para devidos fins que efetuamos a manutenção preventiva e corretiva na parte de assistência técnica, além de serviços relacionados a treinamento quando necessário para a empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61**.

E P B Londrina - Comércio de equipamentos médico hospitalar - Eireli – ME

CNPJ: 22.540.455/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90696446-59

Endereço: Av Henrique Mansano, nº 1030 – Jd Alpes - Londrina/PR86030-030

Fone:(43) 3367-4555

Responsável Legal pela Empresa: Emanuel Pereira Barduzzi

E-mail: manulonhospitalar@gmail.com

Número de Registro: CREA/PR Nº 61169

Responsável Técnico: MAURO FRANCISCO DE GASPERI

Carteira: PR-134972/D - Data de Expedição: 31/10/2013.

Validade declaração 06 meses

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Londrina, 01 de abril de 2026

Assinado de forma digital por E
P B LONDRINA COMERCIO E
IMPORTACAO DE
EQUIPAMEN:22540455000132
Dados: 2026.04.01 10:59:04
-03'00'

E P B LONDRINA COMERCIO E
IMPORTACAO DE
EQUIPAMEN:22540455000132



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 57.498.660/0001-61
Razão Social: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/04/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	02/08/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/10/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/09/2026
Receita Municipal	Validade:	12/10/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/07/2026 17:17

CPF: 055.XXX.XXX-23 Nome: CESAR RAFAEL CARREGA

Ass: _____